



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**МИКРОМАНОМЕТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ  
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ  
С МИКРОМЕТРИЧЕСКИМ ВИНТОМ  
ТИПА МКВ-250**

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

ГОСТ 8.302—78

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Государственная система обеспечения единства измерений

МИКРОМАНОМЕТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ  
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ С МИКРОМЕТРИЧЕСКИМ  
ВИНТОМ ТИПА МКВ-250

Методы и средства поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements. Compensated fluid micromanometers with micrometric screw, type 250 MKB.  
Methods and means of verification

ГОСТ  
8.302-78\*

Взамен  
ГОСТ 14936-69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 мая 1978 г. № 1413 срок введения установлен

с 01.07 1979 г.

Настоящий стандарт распространяется на жидкостные компенсационные микроманометры с микрометрическим винтом типа МКВ-250 (далее — микроманометры) с верхним пределом измерений 2500 Па (250 кгс/см<sup>2</sup>) класса точности 0,02 по ГОСТ 11161-71, а также выпущенные до введения ГОСТ 11161-71 и импортные и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

### 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

- внешний осмотр (п. 3.1);
- опробование (п. 3.2);
- определение погрешности микроманометра (п. 3.3).

1.2. При проведении поверки следует использовать средства поверки, перечисленные ниже:

- образцовый компенсационный микроманометр 1-го разряда типа МКМ с диапазоном измерений 100-4000 Па (10-400 кгс/м<sup>2</sup>);
- термометр с ценой деления 0,1°C для диапазона температур 10-30°C по ГОСТ 2045-71;
- психрометр аспирационный по ГОСТ 6353-52 или гигрометр с верхним пределом измерений относительной влажности 100%;
- сильфонный пресс с кранами и верхним пределом создаваемого давления не менее 2500 Па (250 кгс/м<sup>2</sup>).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1982 г. (ИУС № 9 1982 г.).

© Издательство стандартов, 1983

1.3. Образцовые средства измерений, применяемые при поверке, должны быть поверены в органах государственной метрологической службы, остальные средства — в органах государственной или органах ведомственных метрологических служб.

## 2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

температура воздуха в помещении при поверке микроанометров должна быть  $20 \pm 5^\circ\text{C}$  при скорости изменения ее не более  $0,3^\circ\text{C}/\text{ч}$ ;

измерение температуры воздуха в помещении должно производиться на расстоянии не более 0,5 м от поверхности стола, на котором установлены микроанометры;

относительная влажность окружающего воздуха должна быть от 30 до 80 %;

стол поверяемого и образцового микроанометров должен иметь основание, исключающее влияние тряски и вибрации на работу микроанометров, и обеспечивать установку микроанометров по уровням в рабочее положение.

2.2. Перед проведением поверки должны быть проведены следующие подготовительные работы.

Сосуды поверяемого микроанометра должны быть промыты водопроводной проточной водой, а затем дистиллированной водой по ГОСТ 6709—72.

Промытый микроанометр должен быть заполнен дистиллированной водой. Температура дистиллированной воды при заполнении не должна отличаться от окружающего воздуха более чем на  $1^\circ\text{C}$ .

Микроанометр перед заполнением его дистиллированной водой необходимо установить по уровням, совместить указатели с нулевыми отметками вертикальной и круговой шкал и установить неподвижный сосуд в среднее положение вращением регулировочной гайки.

Дистиллированную воду заливают через штуцер неподвижного сосуда до уровня, при котором наблюдаемый в зеркальце зазор между конусом-указателем и его отражением должен быть не более 1 мм.

Поверяемый и образцовый микроанометры должны быть установлены на столе так, чтобы уровни воды в неподвижных сосудах приборов были в одной горизонтальной плоскости.

Поверяемый и образцовый микроанометры для выравнивания температур должны находиться на рабочем месте до начала поверки приборов не менее 4 ч.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

#### 3.1. Внешний осмотр

3.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемого микроманометра следующим требованиям:

корпус микроманометра и литые детали, защищенные лакокрасочными покрытиями, не должны иметь дефектов, ухудшающих внешний вид микроманометра и препятствующих их применению в эксплуатации;

все нелитые металлические части прибора, кроме резьбы микрометрического винта с гайкой, должны иметь антикоррозионные покрытия;

жидкость ампулы уровня должна быть прозрачной и без заметных на глаз включений;

на зеркальце не допускаются царапины, пятна и другие дефекты, ухудшающие отражательные свойства зеркальца;

внутренняя поверхность сосудов должна быть чистой;

конус-указатель должен быть обезжирен и не должен иметь на поверхности темных пятен;

на металлической табличке, прикрепленной к корпусу микроманометра, должна быть нанесена следующая маркировка:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование и тип прибора;

порядковый номер микроманометра по системе нумерации предприятия-изготовителя;

год выпуска.

Примечание. У микроманометров, выпущенных до введения ГОСТ 11161—71, допускается маркировка, отличная от указанной.

#### 3.2. Опробование

3.2.1. При опробовании должно быть установлено соответствие микроманометра следующим требованиям:

установочные винты должны легко вращаться и обеспечивать установку микроманометра по шаровому уровню;

при перемещении подвижного сосуда резиновая соединительная трубка должна оставаться свободной и не зажиматься между микрометрическим винтом и корпусом прибора;

перемещение всех подвижных частей прибора должно быть плавным, без рывков и заеданий;

нулевые отметки на вертикальной и круговой шкалах должны совпадать с соответствующими указателями;

регулирующая гайка должна обеспечивать перемещение неподвижного сосуда до получения изображения при соприкосновении конуса-указателя и его отражения;

микроманометр должен быть герметичным.

3.2.2. Проверку герметичности микроанометра проводят при избыточном давлении 2500 Па (250 кгс/м<sup>2</sup>) в указанной ниже последовательности:

при помощи резиновой трубки соединяют сильфонный пресс со штуцером неподвижного сосуда;

устанавливают неподвижный сосуд в крайнее верхнее положение;

сильфонным прессом повышают давление до получения в зеркальце изображения конуса-указателя и его отражения с едва видимым просветом между ними;

выдерживают микроанометр под этим давлением 3 мин.

Если ширина просвета между конусом-указателем и его изображением не изменилась, то микроанометр считают герметичным.

3.3. Определение погрешности микроанометра

3.3.1. Погрешности микроанометра определяют методом непосредственного сличения с образцовым микроанометром. Перед сличением поверяемый и образцовый микроанометры соединяют по схеме, указанной на чертеже.

3.3.2. Проверку постоянства «нуля» микроанометров проводят в следующем порядке.

Соединяют неподвижные сосуды 2, 6 образцового и поверяемого микроанометров при помощи резиновых трубок 3 через тройник 4 и трехходовой пробковый кран 5 и присоединяют сильфонный пресс 9 к тройнику 4.


Поверяемый и образцовый микроанометры устанавливают при помощи установочных винтов в рабочее положение, при котором пузырьки в ампулах находятся в центре ампул. Кран 5 открывают на атмосферу.

Устанавливают нулевое показание микроанометра. При нулевом показании указателя вертикальной и круговой шкал должны совпадать с нулевыми отметками этих шкал, на изображении в зеркальце между конусом-указателем и его отражением должен наблюдаться едва видимый просвет (приблизительно 0,1 мм).

Закрывают кран 10, краном 5 отключают сообщение неподвижных сосудов с атмосферой и два раза поднимают и опускают подвижные сосуды микроанометров. Открывают кран 5 на атмосферу и проверяют нулевое показание микроанометров. Изменение нулевого показания поверяемого микроанометра не должно превышать 0,01 мм.

В случае, когда изменение превышает 0,01 мм, повторно устанавливают нулевое показание микроанометра и проверяют его постоянство. Указанные действия следует повторить столько раз, сколько необходимо для получения устойчивого показания «нуля».

Постоянство «нуля» образцового микроанометра контролируют по ГОСТ 8.096—73, разд. 4.

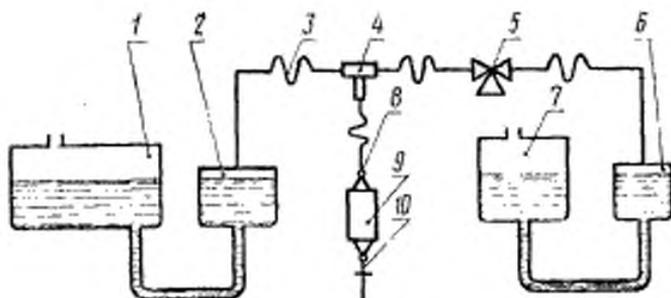

1, 2—подвижный и неподвижный сосуды образцового микроманометра; 3—резиновые трубки; 4—тройники; 5—трехходовый пробковый кран; 6, 7—неподвижный и подвижный сосуды поверяемого микроманометра; 9—сифонный пресс с кранами 8, 10

3.3.3. Сличение показаний образцового и поверяемого микроманометров на одной числовой отметке шкалы проводят в следующем порядке.

Закрывают кран 10, устанавливают кран 5 в положение, перекрывающее сообщение сосудов между собой и с атмосферой, и поднимают неподвижные сосуды образцового и поверяемого микроманометров на высоту отметки, на которой проводят сличение. После этого краном 5 сообщают неподвижные сосуды между собой, при этом сообщение с атмосферой должно быть закрыто.

При помощи сифонного преса 9 плавной подачей устанавливают по образцовому микроманометру давление, соответствующее отметке шкалы, и визуально контролируют соответствие изображения соприкосновения конуса-указателя и его отражения нулевому. Если наблюдаемое в зеркальце изображение отличается от нулевого, необходимо повернуть круговую шкалу на одно или несколько делений и повторно по образцовому микроманометру установить заданное давление и проконтролировать изображение в зеркальце.

Эту операцию повторяют до получения в зеркальце точно такого же изображения, как при нулевом показании. После этого отсчитывают показания поверяемого прибора.

#### Примечания:

1. Подводить уровень жидкости в неподвижном сосуде к нулевому показанию следует только снизу вверх для исключения влияния зазора между микрометрическим винтом и гайкой.

2. В процессе сличения необходимо периодически осуществлять контроль установки микроманометров по уровням.

3.3.4. Сличение показаний микроманометра производят на 25 числовых отметках шкалы через каждые 10 мм шкалы от нуля до верхнего предела измерений.

При сличении поверяемого и образцового микроманометров выполняют не менее двух серий наблюдений и в каждой серии при прямом и обратном ходах подвижного сосуда (при возрастании и уменьшении давления).

3.3.5. Установку нулевого показания поверяемого и образцового приборов производят в начале каждой серии наблюдений, а его проверку — в конце каждой серии.

3.3.6. Изменение нулевого показания микроманометра не должно превышать  $0,2 \text{ Па}$  ( $0,02 \text{ кгс/м}^2$  — двух делений круговой шкалы).

3.3.7. Погрешность отсчитывания показаний микроманометра и записи среднего значения не должна превышать  $0,05 \text{ Па}$  ( $0,005 \text{ кгс/м}^2$  —  $0,5$  делений круговой шкалы).

3.3.8. Наибольшая разность между результатами наблюдения на одних и тех же отметках шкалы (размах показаний) не должна превышать  $0,3 \text{ Па}$  ( $0,03 \text{ кгс/м}^2$ ).

3.3.9. Результаты наблюдений при сличении заносят в протокол, форма которого приведена в обязательном приложении 1.

3.3.10. Для каждой отметки вычисляют среднее арифметическое из результатов наблюдения двух серий.

3.3.11. Наибольшая разность между средним арифметическим результатов наблюдения и показанием образцового микроманометра при первичной проверке вновь изготовленных микроманометров не должна превышать  $0,5 \text{ Па}$  ( $0,05 \text{ кгс/м}^2$  — пять делений круговой шкалы).

При периодической проверке микроманометров допускается увеличение разности между средним арифметическим и показанием образцового микроманометра до  $1,2 \text{ Па}$  ( $0,12 \text{ кгс/м}^2$  —  $12$  делений круговой шкалы); при этом микроманометрам присваивают класс точности  $0,05$ . Для приборов класса точности  $0,05$  допускается увеличение разности между результатами наблюдений на одних и тех же отметках шкалы до  $0,6 \text{ Па}$  ( $0,06 \text{ кгс/м}^2$  — шесть делений круговой шкалы).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3.12. При несоответствии микроманометра хотя бы одному из требований разд. 3 прибор признают непригодным к применению и его дальнейшую проверку не производят.

#### 4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Микроманометры, прошедшие проверку с положительными результатами, признают годными и на них выдают свидетельство о государственной проверке.

В свидетельстве указывают класс точности 0,02 или 0,05 в соответствии с результатами поверки. В свидетельствах, выданных на микроманометры, предназначенные для применения их в качестве образцовых 2-го разряда, должно быть нанесено слово «образцовый».

На оборотной стороне свидетельства записывают результаты поверки в соответствии с обязательным приложением 2.

4.2. Микроманометры, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску и применению не допускают.

---

ПРОТОКОЛ  
РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ

Протокол № \_\_\_\_\_

Сличение показаний микроманометра типа МКВ-250 № \_\_\_\_\_

изготовленного \_\_\_\_\_, принадлежащего \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, с микроманометром типа МКМ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Показания микроманометра типа МКМ №  Н	Показания микроманометра типа МКВ № _____				Средние значения показаний $H_{\text{ср}}$	Размах показаний	Н- $H_{\text{ср}}$
	Серия наблюдений						
	1-я		2-я				
	Прямой ход	Обратный ход	Прямой ход	Обратный ход			

Температура окружающего воздуха:

в начале поверки \_\_\_\_\_

в конце поверки \_\_\_\_\_

Прибор признан годным для применения в качестве \_\_\_\_\_

по классу \_\_\_\_\_ разряду \_\_\_\_\_

Поверку проводил:

Дата \_\_\_\_\_

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СВИДЕТЕЛЬСТВА  
Результаты государственной поверки

Показания микроманометра типа МКМ _____ № _____	Средние значения показаний микроманометра типа МКВ _____ № _____
--	---

Измеряемую разность давления  $\Delta p$ , Па (кгс/м<sup>2</sup>), вычисляют по формуле

$$\Delta p = H \cdot g_m (\rho_1 - \rho_2) \cdot 10^{-3}$$

или

$$\Delta p = H \frac{g_m}{9,80665} (\rho_1 - \rho_2) \cdot 10^{-3},$$

где  $H$  — показания микроманометра, мм;

$g_m$  — значение местного ускорения свободного падения, м/с<sup>2</sup>;

$\rho_1$  и  $\rho_2$  — плотность дистиллированной воды и воздуха при температуре измерения, кг/м<sup>3</sup>, соответственно.

Поверку проводил:

Дата \_\_\_\_\_

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *С. Г. Вилькина*  
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*  
Корректор *Л. А. Царева*

Сдано в наб. 05.02.83 Подп. в печ. 09.03.83 0,76 п. л. 0,54 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Сдана «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д. 557, Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 944