
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
ИСО 11073-91064—
2017

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ
Стандартный протокол коммуникаций
Часть 91064
Компьютерная электрокардиография
(ISO 11073-91064:2009, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ЦНИИОИЗ Минздрава) и Обществом с ограниченной ответственностью «Корпоративные электронные системы» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 468 «Информатизация здоровья» при ЦНИИОИЗ Минздрава – постоянным представителем ISO TC 215

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. № 1236-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 11073-91064:2009 «Информатизация здоровья. Стандартный протокол коммуникаций. Часть 91064. Компьютерная электрокардиография» (ISO 11073-91064:2009 «Health Informatics. Standard communication protocol. Part 91064. Computer-assisted electrocardiography», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Сокращения	2
5 Определение содержания и формата данных	3
5.1 Общие соображения	3
5.2 Спецификации структуры данных	4
5.3 Раздел указателей. Раздел 0	7
5.4 Информация заголовка. Данные пациента/данные снятия электрокардиограммы. Раздел 1	8
5.5 Таблицы Хаффмана. Раздел 2	18
5.6 Определения отведений ЭКГ. Раздел 3	19
5.7 Местоположения QRS-комплексов, зоны вычитания эталонного цикла и защищенные области. Раздел 4	27
5.8 Закодированные данные эталонного цикла типа 0. Раздел 5	28
5.9 Данные ритма. Раздел 6	30
5.10 Глобальные измерения. Раздел 7	31
5.11 Хранение полного текста интерпретирующих утверждений. Раздел 8	35
5.12 Хранение интерпретирующих утверждений, специфичных для производителя, и данных, относящихся к цепочке расшифровок. Раздел 9	36
5.13 Блок измерения отведений. Раздел 10	36
5.14 Хранение универсальных кодов интерпретирующих утверждений. Раздел 11	38
6 Минимальные требования к кодированию и сжатию данных сигнала электрокардиограммы	40
6.1 Область применения	40
6.2 Введение	40
6.3 Методология сжатия электрокардиограммы	41
6.4 Основные результаты исследований по сжатию данных электрокардиограммы в проекте SCP-ECG	42
6.5 Минимальные требования к сжатию данных электрокардиограммы	43
Приложение А (обязательное) Кодирование алфавитно-цифровых данных электрокардиограммы в многоязычной среде	44
Приложение В (обязательное) Определение соответствия стандарту SCP-ECG	55
Приложение С (обязательное) Общий подход и проверка соответствия рекомендуемого метода сжатия сигнала электрокардиограммы	61
Приложение D (справочное) Определение минимального набора управляющих сообщений и запросов для обмена данными электрокардиограммы	85
Приложение E (справочное) Стандартный протокол низкого уровня для взаимодействия устройства картирования электрокардиограммы с сервером	97
Приложение F (справочное) Универсальные коды интерпретирующих описаний электрокардиограммы	106
Приложение G (справочное) Словарь	119
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных документов национальным стандартам	121
Библиография	122

Введение

Электрокардиограмма (ЭКГ) — это запись изменений напряжения, передаваемых на поверхность тела электрических явлений в сердечной мышце, предоставляя непосредственные данные о частоте сердечных сокращений и сердечной проводимости, а также косвенные свидетельства определенных аспектов миокардиальной анатомии, кровоснабжения и функции. Во время распространения по поверхности тела внесердечные ткани могут вмешиваться в процесс и влиять на ЭКГ.

Электрокардиография уже много лет используется как ключевой, неинвазивный метод для диагностики и раннего обнаружения заболеваний сердечно-сосудистой системы, являющихся главной причиной смертности в западных странах. В 1993 г. было установлено, что ежегодно в Европейском сообществе записывается более 100 миллионов стандартных ЭКГ, предназначенных для стандартной диагностики и массового обследования населения, на что затрачивается приблизительно 1,2 биллиона евро в год.

Сегодня почти все новые электрокардиографы используют цифровые методы записи, интерпретации и коммуникаций. Такие независимые устройства, работающие на микрокомпьютерах, могут быть соединены друг с другом, а также с большими серверами, основанными на микрокомпьютерах, в целях долгосрочного хранения и последовательного сравнения. Для таких целей различные производители используют различные методики.

Население заинтересовано в том, чтобы пользователи при выборе различных систем не были ограничены их несовместимыми техническими характеристиками и предоставляемыми услугами. Обработка ЭКГ все чаще интегрируется совместно с другими различными способами обработки данных в здравоохранении. Такая эволюция должна оказать значительное влияние на хранение и обмен данными ЭКГ. Существует множество конечных пользователей, которые по различным причинам (поддержка обслуживания пациента, управление, исследование и образование) хотят получить копию данных сигнала, отчет с интерпретацией и/или результаты измерений. Будучи одной из первых систем для поддержки медицинских решений, компьютеризированная интерпретация ЭКГ используется как в кардиологических отделениях в больницах, так и врачами широкого профиля в центрах первичной медико-санитарной помощи и в лечебных центрах. В случае угрозы жизни, связанной с острым инфарктом миокарда, средний медперсонал применяет ЭКГ в машинах скорой помощи для поддержки процесса применения тромботических средств с использованием удаленного мониторинга, когда это возможно.

В соответствии с настоящим стандартом для обеспечения обмена информацией между различными системами было чрезвычайно важно утвердить стандартный протокол передачи данных, предназначенный для компьютерной электрокардиографии (SCP-EKG). Основной целью настоящего стандарта является утверждение формата данных для передачи отчетов ЭКГ и данных от компьютеризированного устройства записи ЭКГ любого поставщика любой центральной системе управления ЭКГ другого поставщика. Настоящий стандарт должен позволить осуществлять стандартизованную передачу оцифрованных данных ЭКГ и результатов между различными компьютерными системами.

Следуя стандартному протоколу передачи данных (SCP), не ожидается, что содержание и формат данных сигнала ЭКГ и измерений, полученных от устройств ЭКГ различных производителей, будет идентичным. В результате определение того, подходит ли устройство и/или система для какого-либо конкретного приложения, возлагается на пользователя/того, кто приобретает устройство или систему. Следующие применения записей ЭКГ требуют особого внимания:

- последовательное сравнение ЭКГ и интерпретаций;
- форматы графического изображения ЭКГ;
- поддержка контрольного журнала редактирования;
- двунаправленные коммуникации и удаленный запрос.

Пользователю следует удостовериться, что содержание и формат данных сигнала, измерений и описания интерпретаций соответствуют его или ее конкретным потребностям. Если взаимосвязаны более одного типа устройства и/или системы ЭКГ, то пользователю также рекомендуется верифицировать (уточнив у производителей) совместимость данных от различных систем между собой и соответствие этих данных потребностям пользователя.

Чтобы понимать настоящий стандарт, читателю необходимо иметь базовые знания по электрокардиологии, электрокардиографии и обработке сигналов.

Настоящий стандарт связан с традиционной записью электрокардиограмм, т. е. так называемых стандартных электрокардиограмм в 12 отведениях, а также векторных кардиограмм (ВКГ). Вначале

электрические соединения, применяемые для записи ЭКГ, использовались только на конечностях. Эти соединения с правой рукой (RA), левой рукой (LA), левой ногой (LL) и правой ногой (RL) были введены Эйнтхофеном. Изменения электрического сигнала, обнаруживаемые этими отведениями, алгебраически объединялись, чтобы сформировать биполярные отведения I, II и III. Отведение I, например, записывает разницу между напряжениями электродов, размещенных на левой и правой руках. Однополюсные кардиографические отведения (aVR, aVL, aVF и прекардиальные отведения V1—V6) были введены гораздо позднее, начиная с 1933 г. В этих отведениях потенциалы записываются в одном месте относительно уровня, электрическая активность которого изменяется незначительно при сердечных сокращениях. «Усиленные» потенциалы отведений на конечностях записываются относительно среднего потенциала (L + F), (R + F) и (L + R) соответственно. Однополюсные грудные отведения записываются относительно среднего потенциала, равного $\frac{(RA + RL + LL)}{3}$, который называется центральной терминалью Вилсона (ЦТ). В векторкардиографии выполняются записи трех взаимно перпендикулярных отведений, проходящих параллельно осям системы прямолинейных координат, связанной с телом. Это ось X, идущая слева направо, ось Y, идущая сверху вниз, и ось Z, идущая спереди назад.

В некоторых исследовательских центрах так называемые карты поверхности тела получаются за счет размещения (от 24 до 124 или более) электродов, размещенных близко друг к другу вокруг туловища. Настоящий стандарт не рассматривает работу с подобными записями, но в будущем могут быть написаны расширения, охватывающие и их. Настоящий стандарт также не был предназначен для рассмотрения обмена специализированными записями интракардиальных потенциалов или так называемых холтеровских или других долговременных записей ЭКГ, выполняемых для мониторинга частоты сердечного ритма. Настоящий стандарт также не рассматривает записи нагрузочных ЭКГ-проб.

Компьютерная обработка ЭКГ может быть сокращена до трех основных стадий:

- 1) Сбор данных, кодирование, передача и хранение.
- 2) Распознавание характерных участков ЭКГ и выделение признаков, т. е. измерения ЭКГ.
- 3) Диагностическая классификация.

В каждой из этих стадий имеются важные потребности в стандартизации и контроле качества. Область применения настоящего стандарта ограничена первым из этих трех этапов.

Различные разделы данных, которые должны передаваться при помощи стандартного протокола передачи данных ЭКГ, определены в разделе 5. Минимальные требования для кодирования и сжатия данных определены в разделе 6.

Категории соответствия, определенные в приложении В, предоставляют пользователям и производителям устройств и/или систем ЭКГ относительно простое кодирование связанных с SCP-ECG характеристик и содержательную информацию, которые могут быть предоставлены с конкретным устройством. Основываясь на содержании информации, были определены две категории формата данных, представленные в таблице 1.

Таблица 1 — Категории формата данных для спецификаций соответствия

Категория	Требующийся раздел данных	Описание содержания
I	0, 1, [2], 3, 6, (7), (8), (10)	Демографические данные и данные ритма ЭКГ (несжатые или со сжатием без потери информации)
II	0, 1, [2], 3, 4, 5, 6, (7), (8), (10)	Демографические данные, данные ритма ЭКГ (несжатые, со сжатием без потери информации или с высоким сжатием) и эталонные циклы
<p>Примечания</p> <p>1 Квадратные скобки [] указывают на необходимость раздела данных 2, если используется кодирование Хаффмана.</p> <p>2 Круглые скобки () указывают на то, что эти разделы данных не обязательны для экспорта.</p>		

В будущих версиях может быть добавлена дополнительная категория, чтобы выполнить определенные требования устройств ЭКГ, используемых в других областях (например, в телемедицине или лечении на дому).

Все устройства, для которых объявлена категория формата данных SCP-ECG, должны импортировать как минимум разделы данных 0, 1, 3, 6, 7 и 8. Все категории могут иметь дополнительные

разделы (например, 9, 10, 11). Данные, специфичные для конкретного производителя, должны необязательно включаться только в поля, байты и блоки, специфичные для производителя, которые были определены в документе. Резервированные, не специфицированные и не определенные поля, байты или блоки данных не должны использоваться для данных, специфичных для производителя.

Для конкретного устройства заявление о соответствии SCP-ECG перечисляет категории экспортируемых данных (т. е. снимаемых и доступных записей SCP-ECG) и импортируемых (т. е. принимаемых и доступных пользователю записей SCP-ECG). Устройство может также объявить свою способность передачи (т. е. возможности сделать доступной запись SCP-ECG без смены формата данных, например, экспортировать записи, которые были импортированы до этого). (В целях настоящего стандарта эти термины точно определены в приложении В.)

Выборка и определение синтаксиса высокого уровня, ориентированного на ЭКГ и предназначенного для передачи сообщений и данных между серверами, например EDIFACT или ASN.1, не входит в область применения настоящего стандарта.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ

Стандартный протокол коммуникаций

Часть 91064

Компьютерная электрокардиография

Health Informatics. Standard communication protocol. Part 91064. Computer-assisted electrocardiography

Дата введения — 2019—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет общие соглашения, требующиеся для обмена конкретными данными пациента (демографическая информация, записи и т. д.), данными сигнала ЭКГ, измерениями ЭКГ и результатами интерпретации ЭКГ как между устройством картирования и сервером, так и между устройствами картирования.

Настоящий стандарт устанавливает содержание и структуру информации, которой будут обмениваться цифровые устройства картирования ЭКГ и компьютерные системы управления ЭКГ, а также другие компьютерные системы, в которых хранятся данные ЭКГ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO/IEC 646 Information technology — ISO 7-bit coded character set for information interchange (Информационные технологии. 7-битный набор кодированных символов ИСО для обмена информацией)

ISO/IEC 2022:1994, Information technology — Character code structure and extension techniques (Информационные технологии. Структура кода символов и методы расширения)

ISO/IEC 4873, Information technology — ISO 8-bit code for information interchange — Structure and rules for implementation (Информационные технологии. 8-битный набор кодированных символов ИСО для обмена информацией)

ISO/IEC 8859-1, Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 1: Latin alphabet No. 1 (Информационные технологии. 8-битовые однобайтовые наборы кодированных графических знаков. Часть 1. Латинский алфавит № 1)

JIS X 0201-1976, Code for Information Interchange (Код для обмена информацией)

JIS X 0208-1997, Code of the Japanese Graphic Character Set for Information Interchange (Код японского набора графических символов для обмена информацией)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **кардиограф, снимающий показания** (acquiring cardiograph): Кардиограф, записывающий исходный сигнал ЭКГ.

3.2 бимодальное сжатие (bimodal compression): Использование низкочастотного фильтра и прореживания считываний за пределами защищенной зоны, содержащей комплекс QRS, без прореживания или фильтрации внутри защищенной зоны. На это указывает байт 6 из 5.9.3.

3.3 подтверждение (confirming): Процесс, в ходе которого обученный и опытный кардиолог проверяет сгенерированную компьютером интерпретацию ЭКГ (или расшифровку), чтобы подтвердить сгенерированную компьютером интерпретацию (или расшифровку) либо внести окончательные изменения в текст интерпретации.

Примечание — Подтвержденная ЭКГ является окончательной клинически приемлемой версией для диагностики и лечения.

3.4 Проект CSE (CSE Project): Проект, поддерживаемый генеральным директором XII Европейской комиссии, нацеленный на разработку общих стандартов для (количественной) электрокардиографии.

3.5 коэффициент снижения частоты/коэффициент прореживания (downsampling factor/decimation factor): Коэффициент, задающий сокращение считываний в разделах данных, где частота считываний снижена относительно исходной частоты считываний.

Примечание — Это применимо к бимодальному сжатию данных.

Пример — Исходная частота считываний 500 отсчетов в секунду (равносна интервалу между считываниями 2 мс) сокращена до 125 считываний в секунду (равносна интервалу между считываниями 8 мс). Коэффициент снижения частоты в таком случае составляет 4.

3.6 интерпретирующее устройство (interpretive device): Устройство (картирующее устройство, компьютер), анализирующее сигнал ЭКГ.

3.7 сообщение (message): Текстовое тело информации.

3.8 расшифровка (overreading): Процесс, в ходе которого кардиолог или ассистент проверяет интерпретацию ЭКГ, сгенерированную компьютером, чтобы проверить точность интерпретации или внести изменения в ее текст.

Примечание — Расшифровка ЭКГ, как правило, не является окончательной клинически приемлемой версией для диагностики и лечения. Как правило, процесс расшифровки предшествует процессу подтверждения.

3.9 запись (record): Весь файл данных, который необходимо передать, включая данные ЭКГ и связанную с ними информацию, например, идентификацию пациента, демографические и другие клинические данные.

3.10 эталонный цикл (reference beat): Эталонный/типичный цикл ЭКГ, вычисленный с помощью любого (но не указанного) алгоритма, охватывающий зубцы P, QRS и ST-T.

3.11 остаточные данные (residual data): Данные исходной ЭКГ, остающиеся после «надлежащего» вычитания эталонного цикла, где «надлежащий» означает точное совмещение циклов.

3.12 данные ритма (rhythm data): Полные данные исходной ЭКГ или разархивированные и восстановленные данные ЭКГ с уменьшенным разрешением.

Примечание — Длина ритма, как правило, равна 10 с.

3.13 раздел (section): Совокупность элементов данных, связанная с одним аспектом записи, измерения или интерпретации электрокардиографии.

3.14 универсальные коды интерпретации (universal statement codes): Коды интерпретации ЭКГ (см. приложение F).

Примечание — Другие технические термины, связанные с настоящим стандартом, см. в приложении G.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

AAMI	— Американская ассоциация содействия развитию медицинской техники;
AC	— переменный ток;
ANA	— Американская ассоциация изучения сердечных заболеваний;
AIM	— продвинутое информационные технологии для медицинских программ генерального директората Европейской комиссии XIII;

ANSI	— Американский государственный институт стандартизации;
ASCII	— американский стандартный код для обмена информацией;
ASN.1	— язык OSI для описания абстрактного синтаксиса;
AVM	— множитель величины амплитуды (см. 5.8.3);
BS	— клавиша «обратный ход» (управляющий символ);
CCITT	— Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии;
CEN	— Европейская комиссия по стандартизации;
CR	— возврат каретки (управляющий символ);
CRC	— циклическая проверка избыточности;
CSE	— общепринятые стандарты для количественной электрокардиографии;
DG	— генеральный директорат (Европейской комиссии);
EC	— Европейское сообщество;
ЭКГ	— электрокардиограмма;
ECU	— европейская валютная единица (€);
ЭДИФАКТ	— стандарт электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте;
EN	— Europäische Norm (европейский стандарт);
ENV	— Europäische Norm Vorausgabe (европейский предварительный стандарт);
ESC	— клавиша «Escape» (управляющий символ);
FF	— смена страницы (управляющий символ);
HT	— клавиша горизонтальной табуляции (управляющий символ);
ICD	— международная классификация болезней;
ID	— идентификация;
МЭК	— Международная электротехническая комиссия;
ИИЭЭ	— Институт инженеров по электротехнике и электронике;
IMIA	— Международная ассоциация медицинской информатики;
ИСО	— Международная организация по стандартизации;
JIS	— японский промышленный стандарт;
LF	— символ новой строки (управляющий символ);
LSB	— младший двоичный разряд;
MSB	— старший двоичный разряд;
RMS	— среднее квадратичное;
SCP	— стандартный коммуникационный протокол;
SCP-ECG	— стандартный коммуникационный протокол для компьютерной электрокардиографии;
TC	— технический комитет;
VCG	— векторная электрокардиография;
VT	— вертикальная табуляция (управляющий символ).

5 Определение содержания и формата данных

5.1 Общие соображения

5.1.1 Запись данных, которая предполагается для обмена, должна быть разделена на разные разделы. Содержание и формат каждого из этих разделов определяются в настоящем стандарте.

5.1.2 Все текстовые данные (строки символов) должны удовлетворять ограниченному требованию для соответствия ИСО/МЭК 2022, которые описаны в приложении А. Latin-1 (ИСО/МЭК 8859-1) должен быть набором символов по умолчанию.

5.1.3 Все строки символов должны завершаться байтом NULL (не является частью ИСО/МЭК 2022).

5.1.4 Для всех двоичных значений со знаком должен использоваться дополнительный код.

5.1.5 Все двоичные значения, состоящие из одного или нескольких байтов, считаются целочисленными без знака, если не указано иное.

5.1.6 Двоичные значения, состоящие из нескольких байтов, должны передаваться в порядке возрастания значимости (наименьший значащий байт передается первым, а наибольший — последним).

5.1.7 Последовательные байты нумеруются слева направо (начиная с первого). Биты байта нумеруются справа налево (0 — LSB, 7 — MSB).

5.1.8 Первый байт записи (т. е. первый байт контрольной суммы) определен как Байт 1.

5.1.9 Считывания ЭКГ индексируются и нумеруются, начиная со считывания номер 1. Номер считывания 0 не используется в настоящем стандарте. Номер считывания является 16-битным индексом. Первое считывание происходит в момент времени 0. Второе считывание, в случае частоты 500 считываний в секунду, происходит в $0 + 2$ мс.

5.1.10 Разделы нумеруются, начиная с 0 (указатель раздела) по 32 767.

5.1.11 Термин «эталонный цикл» используется в настоящем стандарте по отношению к комплексу ЭКГ, выбранному в качестве представителя класса таких комплексов. Данный термин не предполагает никакого конкретного статистического смысла; например, это может быть усредненный цикл, «средний цикл», выбранный или какой-либо другой единичный цикл, взятый из общей записи ЭКГ. «Эталонный цикл» включает в себя P-зубцы, если они присутствуют (не в случае предсердной фибрилляции), сегмент ST-T и T-зубец данного цикла.

ЭКГ может обладать множеством эталонных циклов. Термин «тип цикла», используемый в настоящем стандарте, означает один цикл из упорядоченного списка эталонных циклов, начиная с типа эталонного цикла 0 (ноль). Эталонный цикл типа 0 по определению является эталонным циклом, применяемым для классификации ЭКГ и для вычитания, если при сжатии используется вычитание эталонного цикла. Упорядочивание списка эталонных циклов не предполагает наличия их последовательности во времени в данных ритма.

Термин «данные ритма» применяется для описания данных ЭКГ, полученных на протяжении всего времени записи, как правило, 10 сек. в большинстве записывающих устройств. Описание этих терминов и рекомендованной методологии сжатия данных, включая цифровые примеры и методы испытания сжатия данных и искажения сигнала на соответствие минимальным требованиям, даны в разделе 6, приложениях В и С.

В 5.8 данные эталонного цикла типа 0 предназначены для использования в целях отображения, (повторного) анализа, и если для сжатия данных было использовано вычитание эталонного цикла, то для реконструкции данных ритма.

5.1.12 Все индексы или указатели определены в байтах и начинаются с единицы, если не указано обратное.

5.1.13 1 Кбайт = 1024 байтам.

5.2 Спецификации структуры данных

5.2.1 Все разделы должны начинаться с нечетного индекса (четное смещение). Это предполагает, что все разделы должны содержать четное число байтов. В конец любого раздела, содержащего нечетное число байтов, должен быть добавлен заполняющий байт. Заполняющие байты должны всегда иметь значение NULL. Блоки данных в разделе могут содержать либо нечетное, либо четное число байтов. Заполнение происходит только в конце раздела, если оно необходимо.

5.2.2 Всем разделам присваиваются идентификационные номера. Номера разделов с 0 по 11 на данный момент определены в протоколе SCP-ECG, номера с 12 по 127, а также номера, превышающие 1023, зарезервированы для будущего использования. Номера с 128 по 1023 назначаются разделам, специфичным для конкретного производителя. Сочетания кода производителя (см. 5.4.3.1, тег 14) и номера раздела с 128 по 1023 уникально определяют содержание разделов, специфичных для конкретного производителя. Не существует никаких конкретных правил для раскладки и формата этих разделов. Тем не менее рекомендуется использование структуры, определенной в 5.2.7.

5.2.3 Включение разделов 2, 4, 5, 7—11 (см. 5.2.7 и 5.2.8) является необязательным. Любая запись данных SCP-ECG должна содержать раздел 0 (указатели), раздел 1 (заголовок), раздел 3 (определение отведения ЭКГ) и раздел 6 (данные ритма). Не предполагается никаких иных проверок целостности других присутствующих разделов. В частности, если присутствует какой-либо из разделов 8, 9 или 11, то не предполагается, что должны быть в наличии все три.

5.2.4 Запись ЭКГ начинается с 6-байтового заголовка, состоящего из 2-байтовой контрольной суммы, за которым следует 4-байтовая длина записи. Они определяются следующим образом:

1) 2-байтовый циклический избыточный код (CRC) вычисляется по алгоритму CRC-CCITT, описанному в Е.5.5. CRC вычисляется для всей записи, начиная с первого байта, следующего за CRC, и заканчивая последним байтом в записи;

2) 4-байтовая длина записи обозначает число байтов во всей записи, включая 6 байтов заголовка данной записи.

5.2.5 Обзор записи:

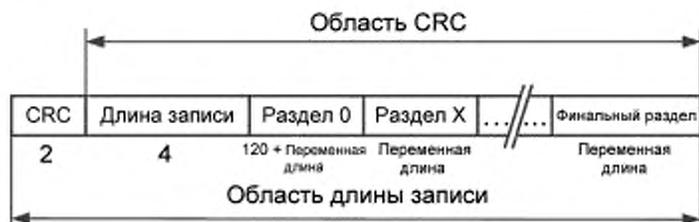


Рисунок 1 — Обзор записи

5.2.6 Порядок последовательности разделов записи является свободным, за исключением раздела 0 (ноль), который должен следовать непосредственно за ее заголовком. Однако в записи данных SCP-ECG разрешен максимально один экземпляр любого раздела.

5.2.7 Каждый раздел состоит из:

- 1) идентификации заголовка раздела (ID заголовка раздела);
- 2) части данных раздела.

Любой раздел должен начинаться с «ID заголовка раздела» (16 байтов), определенного ниже:

Байты	Содержание
1—2	16-битовая контрольная сумма CRC-CCITT для всего раздела, за исключением этих двух байтов.
3—4	Идентифицирующий номер раздела в соответствии с 5.2.2 (см. также 5.3.3.1).
5—8	Длина раздела в байтах, включая «ID заголовка раздела» (5.3.3.2).
9	Номер версии раздела.
10	Номер версии протокола (см. 5.4.3.1, тег 14, байт 15).
11—16	Зарезервировано (для раздела данных 0, см. 5.3.1).

Каждый раздел должен иметь номер версии протокола раздела (см. байты 9 и 10), который может использоваться для указания различных уровней совместимости со стандартом, когда этот стандарт будет обновлен в будущем (см. приложение В). Для разделов с 1 по 11 номера версий разделов (байт 9) должны быть версией протокола, для которой был одобрен данный раздел. Для разделов данных с 12 по 1023 версия раздела должна обозначать версию производителя для данного раздела, не зависящую от версии протокола.

5.2.8 Зарезервированные поля должны всегда иметь значение NULL (ноль).

5.2.9 Обзор организации раздела:



Рисунок 2 — Обзор организации раздела

5.2.10 Числа, указанные курсивом, в обзорах организации раздела (в 5.2.5, 5.2.9), указывают длину соответствующего поля в байтах или обозначенный блок (var — переменная длина).

5.2.11 Общий обзор структуры данных SCP-ECG приведен в таблице 2.

Таблица 2 — Структура данных SCP-ECG

Статус обязательности	Содержание
Обязателен	2 байта — контрольная сумма — CRC-CCITT для всей записи (за исключением этого слова)

Окончание таблицы 2

Статус обязательности	Содержание
Обязателен	4 байта — (без знака) размер всей записи ЭКГ (в байтах)
Обязателен	(Раздел 0) Указатели на области данных в записи
Обязателен	(Раздел 1) Информация заголовка — данные пациента/данные о снятии ЭКГ
Условно обязателен	(Раздел 2) Таблицы Хаффмана, используемые в кодировании данных ЭКГ (если используются)
Обязателен	(Раздел 3) Определение отведений ЭКГ
Необязателен	(Раздел 4) Местоположения QRS (если эталонные циклы закодированы)
Необязателен	(Раздел 5) Закодированные данные эталонных циклов, если осуществляется их хранение
Обязателен	(Раздел 6) «Остаточный сигнал», если выполняются вычитание эталонного цикла и его хранение, в противном случае закодированные данные ритма
Необязателен	(Раздел 7) Глобальные измерения
Необязателен	(Раздел 8) Текст диагноза от «интерпретирующего» устройства
Необязателен	(Раздел 9) Диагностика, специфичная для производителя, и расшифровка данных от «интерпретирующего» устройства
Необязателен	(Раздел 10) Результаты измерений отведений
Необязателен	(Раздел 11) Универсальные коды утверждений, вытекающие из интерпретации

5.2.12 Приведенные ниже замечания применимы к областям данных, определенным выше.

- 0 Данный раздел содержит указатели на начало каждого из следующих разделов. Этот раздел обязателен.
- 1 Данный раздел содержит общую информацию, относящуюся к пациенту (например, фамилию и имя пациента, идентификатор пациента, возраст и т. п.), а также к ЭКГ (дату снятия, время и т. п.). Этот раздел обязателен.
- 2 Данный раздел содержит все таблицы Хаффмана, используемые в кодировании ритма (или «остаточного сигнала») и данных эталонного цикла. В разделах 5 и 6 на эти таблицы должны приводиться ссылки согласно порядковым номерам этих таблиц в данном разделе. Таким образом, когда в разделе кодирования эталонного цикла приводится ссылка на таблицу 2, то она должна отсылать ко второй таблице, определенной в разделе 2. Этот раздел обязателен в зависимости от использования кодирования Хаффмана при кодировании ритма (или «остаточного сигнала») и эталонного цикла (если он хранится).
- 3 Данный раздел указывает отведения ЭКГ, содержащиеся в записи. Этот раздел обязателен.
- 4 Если эталонные циклы закодированы, то данный раздел должен идентифицировать позиции этих эталонных циклов относительно «остаточного» сигнала, содержащегося в разделе 6. Этот раздел необязателен.
- 5 Записи эталонных циклов для каждого отведения кодируются в случае, если устройство, с которого они поступили, идентифицировало эти комплексы. Данный раздел необязателен.
- 6 Данный раздел содержит «остаточный» сигнал, остающийся для каждого отведения после вычитания записей эталонного цикла. Если эталонные циклы не вычитались, он содержит весь сигнал ритма. Этот раздел обязателен.

- 7 Данный раздел содержит глобальные измерения для каждого типа эталонного цикла или для каждого комплекса QRS, содержащегося в записи, а также список возможных импульсов кардиостимулятора в записи. Этот раздел не обязателен.
- 8 Данный раздел содержит самый последний актуальный текст интерпретации диагностики записанных данных ЭКГ, включая все расшифровки, если они были выполнены. Данный раздел должен включать только самую актуальную интерпретацию и расшифровку. В тексте не должны использоваться никакие коды, специфичные для производителя. При необходимости могут использоваться мнемокоды, перечисленные в универсальных кодах интерпретации. Данные, содержащиеся в данном разделе, должны согласовываться с данными в разделах 9 и 11. Этот раздел необязателен.
- 9 Данный раздел содержит диагностические утверждения анализирующего устройства, специфичные для конкретного производителя, а также привязки интерпретаций к расшифровкам. Источник анализирующего устройства, а также фамилия и имя последнего подтверждающего врача (или устройства) определены в «разделе заголовка» (раздел 1). Данный раздел необязателен.
- 10 В данном разделе представлены набор базовых измерений и измерений, специфичных для производителя (если имеются), для каждого записанного отведения. Данный раздел необязателен.
- 11 Данный раздел содержит самую последнюю интерпретацию и данные расшифровки, закодированные в соответствии с универсальными кодами интерпретации и правилами кодирования (приложение F). Данные, содержащиеся в данном разделе, должны согласовываться с данными в разделах 8 и 9. Этот раздел необязателен.

5.3 Раздел указателей. Раздел 0

5.3.1 Цель данного раздела заключается в хранении указателей на остальные разделы записи. Всем разделам даются идентификационные номера в соответствии с 5.2.2.

5.3.2 Данный раздел начинается с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7. Байты с 11 по 16 ID заголовка раздела должны содержать строку ASCII из шести символов «SCPECG».

5.3.3 Для обеспечения гибкости управления разделом данные раздела указателей определяются следующим образом:

- независимо от присутствия необязательных разделов должно быть предоставлено одно поле указателя для каждого раздела с 0 по 11, определенного протоколом SCP-ECG. Для каждого необязательного раздела, не включенного в запись данных SCP-ECG, поле указателя должно содержать специальные коды, определенные в 5.3.3.2 и 5.3.3.3;

- каждому разделу, специфичному для производителя (если присутствуют), должно соответствовать поле указателя в разделе 0.

Каждое поле указателя содержит три части:

- a) идентификация раздела (см. 5.3.3.1);
- b) длина раздела (см. 5.3.3.2);
- c) индекс раздела (см. 5.3.3.3).

5.3.3.1 Идентифицирующий номер раздела хранится в двух байтах, содержащих этот номер, в соответствии с 5.2.2. В настоящее время номера разделов с 0 по 11 определены в протоколе SCP-ECG, номера с 12 по 127, а также номера, превышающие 1023, зарезервированы для будущего использования. Номера с 128 по 1023 являются кодами разделов, специфичных для производителя.

5.3.3.2 Длина раздела в байтах (четное число, см. 5.2.1) представлена в данной 4-байтовой целочисленной части поля без знака. Длина включает байты «ID заголовка раздела» (см. 5.2.7). Четырехбайтовое целое необходимо, чтобы позволить разделы, длина которых превышает 32 Кбайта. Для данных, содержащихся в разделах 2—11, поле указателя должно присутствовать. Если в каком-либо из этих разделов не передается никаких данных, то длина этого раздела должна иметь значение 0.

5.3.3.3 Индекс первого байта раздела должен быть представлен в данной 4-байтовой целочисленной части поля без знака. Индекс вычисляется относительно начала записи, т. е. байта 1 записи (первый байт CRC). Например, если раздел 11 начинается со сдвигом в 128 900 байтов от начала записи ЭКГ, то индекс раздела 11 будет иметь значение 128 901. Четырехбайтовое целое необходимо, чтобы позволить запись SCP-ECG, длина которой превышает 32 Кбайта. Если раздел не включен в запись SCP-ECG, то его индекс должен иметь значение NULL (0). Индекс раздела 0 должен всегда иметь значение 7, так как разделу 0 всегда предшествует контрольная сумма (2 байта) и длина записи (4 байта).

5.3.3.4 Поля указателя должны быть представлены в порядке возрастания номеров разделов. Но сами разделы не обязаны следовать в порядке возрастания номеров.

5.3.4 Обзор структуры раздела указателя:



Рисунок 3 — Обзор структуры раздела указателя

5.4 Информация заголовка. Данные пациента/данные снятия электрокардиограммы.

Раздел 1

5.4.1 Общие положения

Раздел должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

5.4.2 Введение в данные раздела

Приведенная ниже раскладка подробно описывает формат, который должен использоваться для передачи демографических данных пациента и административных данных ЭКГ в качестве части стандартного (SCP-ECG) протокола коммуникаций для цифровых данных ЭКГ.

5.4.3 Базовая методология

5.4.3.1 Известно, что несмотря на возможность передачи большого числа параметров, большинство устройств передает только их подмножество. Поэтому было принято решение сделать формат демографических данных пациента более гибким.

Каждый параметр должен храниться в отдельном поле. Включение поля в данный раздел должно быть необязательным при условии, что присутствуют следующие параметры (с 1 по 4):

Тег	Параметр	
1	2	Идентификатор пациента (используется как первичный ключ в базе данных управления ЭКГ).
2	14	Идентификатор снимающего устройства.
3	25	Дата снятия.
4	26	Время снятия.

Кроме того, рабочая группа SCP-ECG настоятельно рекомендует следующие параметры для уникальной идентификации пациента и времени снятия:

Тег	Параметр	
5	0	Фамилия пациента.
6	1	Имя пациента.
7	5	Дата рождения пациента (в принципе, датой рождения должен быть год нашей эры).
8	8	Пол пациента.
9	15	Идентификатор анализирующего устройства.
10	34	Часовой пояс даты и времени.

5.4.3.2 Гибкость достигается путем идентификации каждого поля с помощью следующих средств:

a) один ведущий байт спецификации, именуемый «тег», идентифицирует содержание поля параметров;

b) 2-байтовое целое число без знака, именуемое «длиной», содержащее длину значения поля в байтах, позволяет вносить текстовые записи различной длины и использовать мультибайтовые наборы символов (например, наборы японских символов). В длину поля должен входить символ NULL, завершающий строку текста. Например, длина фамилии «Mepuel» должна иметь значение 7, учитывающее NULL. Допустима длина поля 0, эквивалентная утверждению «не определено»;

c) нуль или более байтов параметра, именуемых «значением», содержащие фактические данные параметра.

Тег поля (один двоичный байт) разрешает определять всего 255 различных типов поля (от 0 до 254; 255 используется для завершения), из которых 55 (с 200 по 254) зарезервированы для использования

конкретным производителем. Любое поле, идентифицированное значением от 200 до 254, не определено в рамках спецификации данного протокола, что позволяет производителю определить свой собственный набор полей.

Длина поля (два двоичных байта) должна содержать фактическую длину значения поля. Байты длины и тега (первые три байта любого поля) не включены в длину поля. Максимальная возможная длина каждого значения поля составляет 65 535 байтов (два байта без знака). Тем не менее по практическим причинам максимальная длина поля не должна превышать 64 байта, за исключением элементов произвольного текста (см. 5.4.3.5).

Значение поля, содержащее данные фактических параметров, может иметь любую комбинацию двоичных байтов и текстовых символов.

5.4.3.3 В разделе «Заголовок» разрешено использование не более одного экземпляра любого поля, определенного в 5.4.5, за исключением полей, перечисленных ниже:

Тег	Описание значения	Максимальное число экземпляров
10	Лекарственные препараты	Без ограничений
13	Диагноз или указание направления к специалисту	Без ограничений
30	Произвольный текст	Без ограничений
32	Коды диагноза в истории (болезни)	Без ограничений
35	История заболевания свободным текстом	Без ограничений

5.4.3.4 Первые 16 символов идентификации пациента должны быть уникальными.

5.4.3.5 Для упрощения реализации протокола были определены максимальная длина поля, т. е. 64 байта (за исключением тега 13, тега 30 и тега 35, где ограничение составляет 80), и разумные значения длины разных полей свободного текста (таблица 3).

Таблица 3 — Максимальная и разумная длина полей произвольного текста

Раздел	Тег	Содержание	Экземпляров больше одного	Разумная длина
1	0	Фамилия	—	40
1	1	Имя	—	40
1	2	Идентификатор пациента	—	40
1	3	Вторая фамилия	—	40
1	10	Лекарственные средства	Да	40 ^{a)}
1	13	Диагноз или указание направления к специалисту	Да	80
1	14	Идентификационный номер снимающего устройства	—	40
1	15	Идентификационный номер анализирующего устройства	—	40
1	16	Описание организации, в которой выполнено снятие	—	40
1	17	Описание организации, в которой выполнен анализ	—	40
1	18	Описание отделения, в котором выполнено снятие	—	40
1	19	Описание отделения, в котором выполнен анализ	—	40
1	20	Направивший врач		60
1	21	Самый последний подтверждающий врач		60
1	22	Описание лаборанта		40
1	23	Описание помещения		40
1	30	Поле свободного текста	Да	80 ^{a)}

Окончание таблицы 3

Раздел	Тег	Содержание	Экземпляров больше одного	Разумная длина
1	31	Порядковый номер ЭКГ		12
1	35	Анамнез заболевания свободным текстом	Да	
^{a)} Для этих полей разрешены множественные экземпляры, 40 или 80 символов в каждом, заканчивающиеся символом NULL.				

5.4.4 Обзор части данных раздела «Заголовок» представлен ниже.

Примечание — Заполняющие байты (если имеются) должны иметь нулевое значение. Это применимо ко всем разделам, но не будет отображаться во всех последующих диаграммах.



Рисунок 4 — Обзор части данных раздела «Заголовок»

5.4.5 Спецификацию определенных параметров см. в таблице 4.

Таблица 4 — Спецификация определенных параметров

Тег	Длина	Значение (данные параметра)																				
0	Длина	Фамилия (текстовые символы) Данное поле должно также использоваться для передачи фамилии и имени полностью, если исходное устройство не дает явного указания имени																				
1	Длина	Имя (текстовые символы)																				
2	Длина	Идентификатор пациента (текстовые символы)																				
3	Длина	Вторая фамилия (текстовые символы) Значение поля может быть определено как подходящее для страны или области, где используется прибор ЭКГ. Например, в США это поле может содержать код префикса члена семьи, во Франции оно может содержать девичью фамилию, а в Португалии, как и в Испании и нескольких странах Латинской Америки, — вторую фамилию пациента																				
4	3	Возраст (двоичные значения) Данное поле имеет следующий формат: <table border="0"> <tr> <td>Байты</td> <td>Содержание</td> </tr> <tr> <td>1—2</td> <td>Двоичное. Возраст в единицах измерения, указанных в байте 3.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Двоичное. Единицы измерения возраста определены ниже:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Значение Единицы измерения</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 не указаны</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 год</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 месяц</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 неделя</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 день</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 час</td> </tr> </table> Если все 3 байта равны нулю, то возраст не указан	Байты	Содержание	1—2	Двоичное. Возраст в единицах измерения, указанных в байте 3.	3	Двоичное. Единицы измерения возраста определены ниже:		Значение Единицы измерения		0 не указаны		1 год		2 месяц		3 неделя		4 день		5 час
Байты	Содержание																					
1—2	Двоичное. Возраст в единицах измерения, указанных в байте 3.																					
3	Двоичное. Единицы измерения возраста определены ниже:																					
	Значение Единицы измерения																					
	0 не указаны																					
	1 год																					
	2 месяц																					
	3 неделя																					
	4 день																					
	5 час																					

Продолжение таблицы 4

Тег	Длина	Значение (данные параметра)																						
5	4	<p>Дата рождения (двоичные значения) Данное поле имеет следующий формат:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Байты</th> <th>Содержание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1—2</td> <td>Двоичное. Год (полная целочисленная нотация, например, 1990).</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Двоичное. Месяц (диапазон с 01 по 12; 01 = Январь).</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Двоичное. День (диапазон с 01 по 31).</td> </tr> </tbody> </table> <p>Если все 4 байта равны нулю, то дата рождения не указана</p>	Байты	Содержание	1—2	Двоичное. Год (полная целочисленная нотация, например, 1990).	3	Двоичное. Месяц (диапазон с 01 по 12; 01 = Январь).	4	Двоичное. День (диапазон с 01 по 31).														
Байты	Содержание																							
1—2	Двоичное. Год (полная целочисленная нотация, например, 1990).																							
3	Двоичное. Месяц (диапазон с 01 по 12; 01 = Январь).																							
4	Двоичное. День (диапазон с 01 по 31).																							
6	3	<p>Рост (двоичные значения) Это поле имеет следующий формат:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Байты</th> <th>Содержание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1—2</td> <td>Двоичное. Рост в единицах измерений, указанных в байте 3.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Двоичное. Единицы измерения роста, определенные ниже:</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Значение</th> <th>Единицы измерения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>не указаны</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>сантиметр</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>дюйм</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>миллиметр</td> </tr> </tbody> </table> <p>Если все 3 байта равны нулю, то рост не указан</p>	Байты	Содержание	1—2	Двоичное. Рост в единицах измерений, указанных в байте 3.	3	Двоичное. Единицы измерения роста, определенные ниже:	Значение	Единицы измерения	0	не указаны	1	сантиметр	2	дюйм	3	миллиметр						
Байты	Содержание																							
1—2	Двоичное. Рост в единицах измерений, указанных в байте 3.																							
3	Двоичное. Единицы измерения роста, определенные ниже:																							
Значение	Единицы измерения																							
0	не указаны																							
1	сантиметр																							
2	дюйм																							
3	миллиметр																							
7	3	<p>Вес (двоичные значения) Это поле имеет следующий формат:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Байты</th> <th>Содержание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1—2</td> <td>Двоичное. Вес в единицах измерений, указанных в байте 3.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Двоичное. Единицы измерения веса в соответствии с определением ниже:</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Значение</th> <th>Единицы измерения</th> <th>Значение</th> <th>Единицы измерения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>не указаны</td> <td>3</td> <td>фунт</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>килограмм</td> <td>4</td> <td>унция</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>грамм</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Если все 3 байта равны нулю, то вес не указан</p>	Байты	Содержание	1—2	Двоичное. Вес в единицах измерений, указанных в байте 3.	3	Двоичное. Единицы измерения веса в соответствии с определением ниже:	Значение	Единицы измерения	Значение	Единицы измерения	0	не указаны	3	фунт	1	килограмм	4	унция	2	грамм		
Байты	Содержание																							
1—2	Двоичное. Вес в единицах измерений, указанных в байте 3.																							
3	Двоичное. Единицы измерения веса в соответствии с определением ниже:																							
Значение	Единицы измерения	Значение	Единицы измерения																					
0	не указаны	3	фунт																					
1	килограмм	4	унция																					
2	грамм																							
8	1	<p>Пол (двоичные значения) Данное поле имеет следующий формат:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Байты</th> <th>Содержание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Двоичное. Указание пола, определенное как:</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Значение</th> <th>Пол</th> <th>Значение</th> <th>Пол</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>мужской</td> <td>0</td> <td>не известен</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>женский</td> <td>9</td> <td>не указан</td> </tr> </tbody> </table>	Байты	Содержание	1	Двоичное. Указание пола, определенное как:	Значение	Пол	Значение	Пол	1	мужской	0	не известен	2	женский	9	не указан						
Байты	Содержание																							
1	Двоичное. Указание пола, определенное как:																							
Значение	Пол	Значение	Пол																					
1	мужской	0	не известен																					
2	женский	9	не указан																					
9	1	<p>Раса (двоичные значения) Данное поле имеет следующий формат:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Байты</th> <th>Содержание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Двоичное. Указание расы, определенное как:</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Значение</th> <th>Раса</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>не указана</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>белая европеоидная</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>негритянская</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>азиатская</td> </tr> <tr> <td>4—9</td> <td>зарезервировано</td> </tr> <tr> <td>10—255</td> <td>другая (специфичная для производителя)</td> </tr> </tbody> </table>	Байты	Содержание	1	Двоичное. Указание расы, определенное как:	Значение	Раса	0	не указана	1	белая европеоидная	2	негритянская	3	азиатская	4—9	зарезервировано	10—255	другая (специфичная для производителя)				
Байты	Содержание																							
1	Двоичное. Указание расы, определенное как:																							
Значение	Раса																							
0	не указана																							
1	белая европеоидная																							
2	негритянская																							
3	азиатская																							
4—9	зарезервировано																							
10—255	другая (специфичная для производителя)																							
10	Длина	<p>Лекарственные препараты (двоичные байты и текстовые символы) Каждый лекарственный препарат, вводимый в демографическую область пациента, должен быть описан с помощью следующей структуры:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Байты</th> <th>Содержание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Двоичное. Индикатор таблицы кодов лекарственных препаратов. Если байт 1 установлен в значение 0, то применима следующая таблица.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Двоичное. Код класса.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Двоичное. Определенный код лекарственного препарата в определенном классе.</td> </tr> <tr> <td>4 по ***</td> <td>Текстовые символы: текстовое описание лекарственного препарата (не обязательно).</td> </tr> </tbody> </table>	Байты	Содержание	1	Двоичное. Индикатор таблицы кодов лекарственных препаратов. Если байт 1 установлен в значение 0, то применима следующая таблица.	2	Двоичное. Код класса.	3	Двоичное. Определенный код лекарственного препарата в определенном классе.	4 по ***	Текстовые символы: текстовое описание лекарственного препарата (не обязательно).												
Байты	Содержание																							
1	Двоичное. Индикатор таблицы кодов лекарственных препаратов. Если байт 1 установлен в значение 0, то применима следующая таблица.																							
2	Двоичное. Код класса.																							
3	Двоичное. Определенный код лекарственного препарата в определенном классе.																							
4 по ***	Текстовые символы: текстовое описание лекарственного препарата (не обязательно).																							

Продолжение таблицы 4

Тег	Длина	Значение (данные параметра)																				
10	Длина	<p>Определены следующие классы:</p> <table border="0"> <tr> <td>0 — не указан</td> <td>9 — блокаторы кальция</td> </tr> <tr> <td>1 — дигиталис</td> <td>10 — антигипотензивные</td> </tr> <tr> <td>2 — антиаритмические</td> <td>11 — гиполипидемические препараты</td> </tr> <tr> <td>3 — диуретики</td> <td>12 — ингибиторы АПФ</td> </tr> <tr> <td>4 — противогипертензивные</td> <td>с 13 по 19 — зарезервированы</td> </tr> <tr> <td>5 — антиангинальные</td> <td>100 — не принимает лекарства</td> </tr> <tr> <td>6 — антитромботические</td> <td>101 — принимает лекарства, но их тип неизвестен</td> </tr> <tr> <td>7 — бета-блокаторы</td> <td>102 — другое лекарственное средство</td> </tr> <tr> <td>8 — психотропные препараты</td> <td>103 по 255 — коды, специфичные для производителя</td> </tr> </table> <p>Примечания</p> <p>1 За кодом класса 0 всегда следует код лекарственного препарата со значением 0, указывая на то, что этот препарат не определен в данном документе и что текст в байтах с 4 по *** является единственным доступным описанием.</p> <p>2 Код класса, не равный 0, вместе с кодом лекарственного препарата 0 всегда указывает на то, что был применен препарат этого конкретного класса, но он либо неизвестен, либо не определен в данном документе. Даже если применены ненулевые класс и код лекарственного препарата, то текстовое описание препарата может быть также передано в байтах с 4 по ***. Не существует никаких стандартизированных условных обозначений названий.</p> <p>3 Не существует ограничений по числу лекарственных препаратов, которые можно кодировать.</p> <p>4 В рамках каждого класса код 9 должен использоваться для «другого лекарственного препарата».</p> <table border="0"> <tr> <td> <p>Класс 1. Препарат дигиталиса</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Дигосин-Ланоксин</p> <p>2 — Дигитоксин-Дигиталис</p> <p>Класс 2. Антиаритмическое средство</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Дисопирамид</p> <p>2 — Хинидин</p> <p>3 — Прокаинамид</p> <p>4 — Лидокаин</p> <p>5 — Фенитоин</p> <p>6 — Дилантин</p> <p>7 — Амиодарон</p> <p>8 — Токаинид</p> <p>9 — Другое</p> <p>10 — Энкаинид</p> <p>11 — Мекситил/Мексилетин</p> <p>12 — Флекаинид</p> <p>13 — Лоркаинид</p> <p>Класс 3. Диуретики</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Тиазид</p> <p>2 — Фуросемид (Лазикс)</p> <p>3 — Хлористый калий</p> <p>Класс 4. Противогипертензивные средства</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Клонидин</p> <p>2 — Празозин</p> <p>3 — Гидралазин</p> <p>Класс 5. Антиангинальное средство</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Изосорбид</p> <p>2 — Блокаторы кальция</p> <p>3 — Нитраты</p> </td> <td> <p>Класс 6. Антитромботические агенты</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Аспирин</p> <p>2 — Кумадин</p> <p>3 — Гепарин</p> <p>Класс 7. Бета-блокаторы</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Пропранолол</p> <p>2 — Коргард</p> <p>3 — Метопролол</p> <p>4 — Пиндолол</p> <p>5 — Ацебутолол</p> <p>Класс 8. Психотропные</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Трициклический антидепрессант</p> <p>2 — Фенотиазин</p> <p>3 — Барбитурат</p> <p>Класс 9. Блокаторы кальция</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Нифедипин</p> <p>2 — Верапамил</p> <p>Класс 10. Антигипотензивные</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Астматический препарат</p> <p>2 — Аминофиллин</p> <p>3 — Изупрел</p> <p>Класс 11. Гиполипидемические</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Холестид</p> <p>2 — Ловастатин</p> <p>3 — Симвастатин</p> <p>4 — Фибрат</p> <p>Класс 12. Ингибиторы АПФ</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Каптоприл</p> <p>4 — Варфарин</p> <p>5 — Стрептокиназа</p> <p>6 — t-PA</p> </td> </tr> </table>	0 — не указан	9 — блокаторы кальция	1 — дигиталис	10 — антигипотензивные	2 — антиаритмические	11 — гиполипидемические препараты	3 — диуретики	12 — ингибиторы АПФ	4 — противогипертензивные	с 13 по 19 — зарезервированы	5 — антиангинальные	100 — не принимает лекарства	6 — антитромботические	101 — принимает лекарства, но их тип неизвестен	7 — бета-блокаторы	102 — другое лекарственное средство	8 — психотропные препараты	103 по 255 — коды, специфичные для производителя	<p>Класс 1. Препарат дигиталиса</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Дигосин-Ланоксин</p> <p>2 — Дигитоксин-Дигиталис</p> <p>Класс 2. Антиаритмическое средство</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Дисопирамид</p> <p>2 — Хинидин</p> <p>3 — Прокаинамид</p> <p>4 — Лидокаин</p> <p>5 — Фенитоин</p> <p>6 — Дилантин</p> <p>7 — Амиодарон</p> <p>8 — Токаинид</p> <p>9 — Другое</p> <p>10 — Энкаинид</p> <p>11 — Мекситил/Мексилетин</p> <p>12 — Флекаинид</p> <p>13 — Лоркаинид</p> <p>Класс 3. Диуретики</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Тиазид</p> <p>2 — Фуросемид (Лазикс)</p> <p>3 — Хлористый калий</p> <p>Класс 4. Противогипертензивные средства</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Клонидин</p> <p>2 — Празозин</p> <p>3 — Гидралазин</p> <p>Класс 5. Антиангинальное средство</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Изосорбид</p> <p>2 — Блокаторы кальция</p> <p>3 — Нитраты</p>	<p>Класс 6. Антитромботические агенты</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Аспирин</p> <p>2 — Кумадин</p> <p>3 — Гепарин</p> <p>Класс 7. Бета-блокаторы</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Пропранолол</p> <p>2 — Коргард</p> <p>3 — Метопролол</p> <p>4 — Пиндолол</p> <p>5 — Ацебутолол</p> <p>Класс 8. Психотропные</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Трициклический антидепрессант</p> <p>2 — Фенотиазин</p> <p>3 — Барбитурат</p> <p>Класс 9. Блокаторы кальция</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Нифедипин</p> <p>2 — Верапамил</p> <p>Класс 10. Антигипотензивные</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Астматический препарат</p> <p>2 — Аминофиллин</p> <p>3 — Изупрел</p> <p>Класс 11. Гиполипидемические</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Холестид</p> <p>2 — Ловастатин</p> <p>3 — Симвастатин</p> <p>4 — Фибрат</p> <p>Класс 12. Ингибиторы АПФ</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Каптоприл</p> <p>4 — Варфарин</p> <p>5 — Стрептокиназа</p> <p>6 — t-PA</p>
0 — не указан	9 — блокаторы кальция																					
1 — дигиталис	10 — антигипотензивные																					
2 — антиаритмические	11 — гиполипидемические препараты																					
3 — диуретики	12 — ингибиторы АПФ																					
4 — противогипертензивные	с 13 по 19 — зарезервированы																					
5 — антиангинальные	100 — не принимает лекарства																					
6 — антитромботические	101 — принимает лекарства, но их тип неизвестен																					
7 — бета-блокаторы	102 — другое лекарственное средство																					
8 — психотропные препараты	103 по 255 — коды, специфичные для производителя																					
<p>Класс 1. Препарат дигиталиса</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Дигосин-Ланоксин</p> <p>2 — Дигитоксин-Дигиталис</p> <p>Класс 2. Антиаритмическое средство</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Дисопирамид</p> <p>2 — Хинидин</p> <p>3 — Прокаинамид</p> <p>4 — Лидокаин</p> <p>5 — Фенитоин</p> <p>6 — Дилантин</p> <p>7 — Амиодарон</p> <p>8 — Токаинид</p> <p>9 — Другое</p> <p>10 — Энкаинид</p> <p>11 — Мекситил/Мексилетин</p> <p>12 — Флекаинид</p> <p>13 — Лоркаинид</p> <p>Класс 3. Диуретики</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Тиазид</p> <p>2 — Фуросемид (Лазикс)</p> <p>3 — Хлористый калий</p> <p>Класс 4. Противогипертензивные средства</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Клонидин</p> <p>2 — Празозин</p> <p>3 — Гидралазин</p> <p>Класс 5. Антиангинальное средство</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Изосорбид</p> <p>2 — Блокаторы кальция</p> <p>3 — Нитраты</p>	<p>Класс 6. Антитромботические агенты</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Аспирин</p> <p>2 — Кумадин</p> <p>3 — Гепарин</p> <p>Класс 7. Бета-блокаторы</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Пропранолол</p> <p>2 — Коргард</p> <p>3 — Метопролол</p> <p>4 — Пиндолол</p> <p>5 — Ацебутолол</p> <p>Класс 8. Психотропные</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Трициклический антидепрессант</p> <p>2 — Фенотиазин</p> <p>3 — Барбитурат</p> <p>Класс 9. Блокаторы кальция</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Нифедипин</p> <p>2 — Верапамил</p> <p>Класс 10. Антигипотензивные</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Астматический препарат</p> <p>2 — Аминофиллин</p> <p>3 — Изупрел</p> <p>Класс 11. Гиполипидемические</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Холестид</p> <p>2 — Ловастатин</p> <p>3 — Симвастатин</p> <p>4 — Фибрат</p> <p>Класс 12. Ингибиторы АПФ</p> <p>0 — Не указано</p> <p>1 — Каптоприл</p> <p>4 — Варфарин</p> <p>5 — Стрептокиназа</p> <p>6 — t-PA</p>																					
11	2	<p>Систолическое давление крови (двоичные значения)</p> <p>Байты Содержание</p> <p>1, 2 Двоичное. Систолическое давление крови в миллиметрах ртутного столба</p>																				

Продолжение таблицы 4

Тега	Длина	Значение (данные параметра)																																																																																										
12	2	Диастолическое давление крови (двоичные значения) Байты Содержание 1, 2 Двоичное. Диастолическое давление крови в миллиметрах ртутного столба																																																																																										
13	Длина	Диагноз или указание направления к специалисту (текстовые символы) Данное поле содержит текстовое описание диагноза пациента или направления к специалисту																																																																																										
14	Длина	Идентификатор машины снимающего устройства (двоичные байты и текстовые символы) Данное поле однозначно идентифицирует устройство, снявшее ЭКГ. Оно использует следующую общую структуру данных для описания характеристик устройства, которая также используется в тегах 15. Байты Содержание 1, 2 Двоичное. Номер медицинской организации. 3, 4 Двоичное. Номер отделения. 5, 6 Двоичное. Идентификатор устройства. 7 Двоичное. Тип устройства Значение Тип 0 Картирующее устройство 1 Вычислительная система (или сервер) 8 Двоичное. Положено равным 255, см. строку символов производителя в конце тега 14. Примечание — Унаследованные устройства использовали этот байт для указания кода производителя. Эти коды не должны больше использоваться, за исключением идентифицирующих унаследованных файлов. В исторических целях ниже приведены ранее присвоенные коды: 0 — Не известен 8 — Mortara instruments 16 — ESA-OTE 1 — Burdick 9 — Nihon Kohden 17 — Schiller 2 — Cambridge 10 — Okin 18 — Picker-Schwarzer 3 — Compumed 11 — Quinton 19 — et medical devices 4 — Datamed 12 — Siemens (ex Elettronica-Trentina) 5 — Fukuda 13 — Spacelabs 20 — Zwönitz 6 — Hewlett-Packard 14 — Teleded 21 по 99 — Резервировано 7 — Marquette electronics 15 — Hellige 100 — Другое																																																																																										
C 9 по 14		Текстовые символы. Текстовое описание модели. До 5 байтов текста и завершающее значение NULL																																																																																										
15		Двоичное. Номер версии протокола SCP-ECG (точка должна быть удалена; версия 1.0 становится 10; версии должны быть максимально возможно обратно совместимы). Этот номер должен точно ссылаться на письменный документ, описывающий фактическую версию протокола																																																																																										
16		Двоичное. Уровень совместимости протокола SCP-ECG (1 байт). Подробная спецификация приведена в приложении В (см. В.4)																																																																																										
17		Двоичное. Код поддержки языка (1 байт). Поддерживаемые наборы символов представлены в следующей битовой карте:																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Бит 0</th> <th>Бит 1</th> <th>Бит 2</th> <th>Бит 3</th> <th>Бит 4</th> <th>Бит 5</th> <th>Бит 6</th> <th>Бит 7</th> <th>Представление</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>Только 8-битовый ASCII</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>ISO-8859-1 Latin-1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>ISO-8859-2 Latin-2 (Центральная и Восточная Европа)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>ISO-8859-4 Latin-4 (Балтика)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>ISO-8859-5 Кириллица</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>ISO-8859-6 Арабский</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>ISO-8859-7 Греческий</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>ISO-8859-8 Иудейский</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>ISO-8859-11 Тайский</td> </tr> </tbody> </table>	Бит 0	Бит 1	Бит 2	Бит 3	Бит 4	Бит 5	Бит 6	Бит 7	Представление	1	x	x	x	x	x	x	x	Только 8-битовый ASCII	1	0	x	x	x	x	x	x	ISO-8859-1 Latin-1	1	1	0	0	0	0	0	0	ISO-8859-2 Latin-2 (Центральная и Восточная Европа)	1	1	0	1	0	0	0	0	ISO-8859-4 Latin-4 (Балтика)	1	1	0	0	1	0	0	0	ISO-8859-5 Кириллица	1	1	0	1	1	0	0	0	ISO-8859-6 Арабский	1	1	0	0	0	1	0	0	ISO-8859-7 Греческий	1	1	0	1	0	1	0	0	ISO-8859-8 Иудейский	1	1	0	0	1	1	0	0	ISO-8859-11 Тайский
Бит 0	Бит 1	Бит 2	Бит 3	Бит 4	Бит 5	Бит 6	Бит 7	Представление																																																																																				
1	x	x	x	x	x	x	x	Только 8-битовый ASCII																																																																																				
1	0	x	x	x	x	x	x	ISO-8859-1 Latin-1																																																																																				
1	1	0	0	0	0	0	0	ISO-8859-2 Latin-2 (Центральная и Восточная Европа)																																																																																				
1	1	0	1	0	0	0	0	ISO-8859-4 Latin-4 (Балтика)																																																																																				
1	1	0	0	1	0	0	0	ISO-8859-5 Кириллица																																																																																				
1	1	0	1	1	0	0	0	ISO-8859-6 Арабский																																																																																				
1	1	0	0	0	1	0	0	ISO-8859-7 Греческий																																																																																				
1	1	0	1	0	1	0	0	ISO-8859-8 Иудейский																																																																																				
1	1	0	0	1	1	0	0	ISO-8859-11 Тайский																																																																																				

Продолжение таблицы 4

Тег	Длина	Значение (данные параметра)																												
14	Длина	Бит 0	Бит 1	Бит 2	Бит 3	Бит 4	Бит 5	Бит 6	Бит 7	Представление																				
		1	1	0	1	1	1	0	0	ISO-8859-15 Latin-9 (обновление Latin-1, также называется «Latin-0»)																				
		1	1	1	0	0	0	0	0	ISO/IEC 10646																				
		1	1	1	1	0	0	0	0	JIS X 0201-1976 (Японский)																				
		1	1	1	0	1	0	0	0	JIS X 0208-1997 (Японский)																				
		1	1	1	1	1	0	0	0	JIS X 0212-1990 (Японский)																				
		1	1	1	0	0	1	0	0	GB 2312-80 (Китайский)																				
		1	1	1	1	0	1	0	0	KS C5601-1987 (Корейский)																				
		1	1	1	0	1	1	0	0	Зарезервировано																				
		1	1	1	1	1	1	0	0	Зарезервировано																				
		x	x	x	x	x	x	0	1	Зарезервировано																				
		x	x	x	x	x	x	1	0	Зарезервировано																				
		x	x	x	x	x	x	1	1	Зарезервировано (за исключением следующей записи)																				
1	1	1	1	1	1	1	1	Специфичен для производителя																						
18	<p>Двоичное. Функциональные возможности устройства ЭКГ (однобайтовая битовая карта). Эта битовая карта указывает поддерживаемые функции:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Биты</th> <th>Содержание</th> <th>Установлен (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>С 0 по 3</td> <td>Сброшен (0)</td> <td>Зарезервировано</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Зарезервировано</td> <td>Зарезервировано</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Без печати</td> <td>Может печатать ЭКГ-отчеты</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Без анализа</td> <td>Может интерпретировать ЭКГ</td> </tr> <tr> <td>7(MSB)</td> <td>Без хранения</td> <td>Может хранить записи ЭКГ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Без снятия</td> <td>Может снимать данные ЭКГ</td> </tr> </tbody> </table>									Биты	Содержание	Установлен (1)	С 0 по 3	Сброшен (0)	Зарезервировано	4	Зарезервировано	Зарезервировано	5	Без печати	Может печатать ЭКГ-отчеты	6	Без анализа	Может интерпретировать ЭКГ	7(MSB)	Без хранения	Может хранить записи ЭКГ		Без снятия	Может снимать данные ЭКГ
Биты	Содержание	Установлен (1)																												
С 0 по 3	Сброшен (0)	Зарезервировано																												
4	Зарезервировано	Зарезервировано																												
5	Без печати	Может печатать ЭКГ-отчеты																												
6	Без анализа	Может интерпретировать ЭКГ																												
7(MSB)	Без хранения	Может хранить записи ЭКГ																												
	Без снятия	Может снимать данные ЭКГ																												
19	<p>Двоичное. Частота переменного тока сети питания (1 байт)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Значение</th> <th>Содержание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Не указано</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>50 Гц</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>60 Гц</td> </tr> </tbody> </table>									Значение	Содержание	0	Не указано	1	50 Гц	2	60 Гц													
Значение	Содержание																													
0	Не указано																													
1	50 Гц																													
2	60 Гц																													
С 20 по 35	Зарезервировано для будущего использования																													
36	Двоичное. Длина строки, содержащей номер версии программы анализа. Значение байта 36 должно быть не меньше 1. За байтом 36 должны следовать строки символов. Если та или иная строка символов является пустой, то должно быть указано единственное значение NULL.																													
С 37 по ***	Строка символов. Номер версии программы анализа. Строка должна завершаться значением NULL.																													
С *** по ***	Строка символов. Серийный номер устройства снятия. Строка символов должна завершаться значением NULL.																													
С *** по ***	Строка символов. Идентификатор программного обеспечения системы устройства снятия. Строка символов должна завершаться значением NULL.																													
С *** по ***	Строка символов. Идентификатор программного обеспечения реализации протокола SCP в устройстве снятия (максимум 24 символа и завершающий NULL). Строка символов должна завершаться значением NULL.																													
С *** по ***	Строка символов. Производитель устройства снятия. Содержит зарегистрированное торговое наименование производителя. Строка символов должна завершаться значением NULL.																													

Продолжение таблицы 4

Тег	Длина	Значение (данные параметра)
15	Длина	Идентификатор машины анализирующего устройства (двоичные байты и текстовые символы) Данное поле уникально идентифицирует устройство, анализирующее ЭКГ (если оно отличается от снимающего кардиографа). Формат данного поля идентичен формату, использованному для тега 14
16	Длина	Описание снявшей медицинской организации (текстовые символы) Данное поле предоставляет текстовое описание медицинской организации, снявшей ЭКГ
17	Длина	Описание анализирующей медицинской организации (текстовые символы) Данное поле предоставляет текстовое описание медицинской организации, в которой был проведен анализ ЭКГ
18	Длина	Описание снявшего отделения (текстовые символы) Данное поле предоставляет текстовое описание отделения, в котором была снята ЭКГ
19	Длина	Описание анализирующего отделения (текстовые символы) Данное поле предоставляет текстовое описание отделения, в котором был проведен анализ ЭКГ
20	Длина	Направивший врач (текстовые символы) Данное поле предоставляет текстовое описание направившего врача
21	Длина	Самый последний подтверждающий врач (текстовые символы) Данное поле предоставляет текстовое описание самого последнего подтверждающего врача
22	Длина	Описание лаборанта (текстовые символы) Данное поле предоставляет текстовое описание лаборанта
23	Длина	Описание помещения (текстовые символы) Данное поле предоставляет текстовое описание помещения, в котором была записана ЭКГ
24	1	Код срочности ЭКГ (двоичные значения) Байты Содержание 1 Двоичное. Уровень срочности. Значение 0 — это «обычный» уровень, а более высокие значения уровней связаны с повышением срочности, определяемой пользователем. Рекомендуется использовать диапазон кодов от 1 до 10
25	4	Дата снятия (двоичные значения) Данное поле имеет следующий формат: Байты Содержание 1, 2 Двоичное. Год (полное целочисленное обозначение, например, 1990) 3 Двоичное. Месяц (диапазон от 01 до 12: 01 — Январь). 4 Двоичное. День (диапазон от 01 до 31)
26	3	Время снятия (двоичные значения) Данное поле имеет следующий формат: Байты Содержание 1 Двоичное. Часы (диапазон от 00 до 23). 2 Двоичное. Минуты (диапазон от 00 до 59). 3 Двоичное. Секунды (диапазон от 00 до 59). Время снятия должно быть выражено как местное время в часовом поясе снятия (см. тег 34)
27	2	Фильтр изолинии (двоичные значения) Данное поле содержит «частоту среза» (– 3 дБ) высокочастотного фильтра изолинии в единицах (1/100) Герц
28	2	Низкочастотный фильтр (двоичные значения) Данное поле содержит «частоту среза» (– 3 дБ) низкочастотного фильтра в Герцах

Продолжение таблицы 4

Тег	Длина	Значение (данные параметра)																																																										
29	1	<p>Битовая карта фильтра (двоичные значения)</p> <p>Данное поле указывает, использовались ли при обработке ЭКГ другие фильтры, которые не были определены тегами 27 и 28. Эти биты имеют следующее определение:</p> <table> <tr> <td>0</td> <td>Режекторный фильтр 60 Герц.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Режекторный фильтр 50 Герц.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Фильтр артефактов.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Фильтр изолинии (например, адаптивный фильтр или сплайн-фильтр).</td> </tr> <tr> <td>С 4 по 7</td> <td>Не определено.</td> </tr> </table> <p>Если все биты равны нулю, то настройка фильтра не указана</p>	0	Режекторный фильтр 60 Герц.	1	Режекторный фильтр 50 Герц.	2	Фильтр артефактов.	3	Фильтр изолинии (например, адаптивный фильтр или сплайн-фильтр).	С 4 по 7	Не определено.																																																
0	Режекторный фильтр 60 Герц.																																																											
1	Режекторный фильтр 50 Герц.																																																											
2	Фильтр артефактов.																																																											
3	Фильтр изолинии (например, адаптивный фильтр или сплайн-фильтр).																																																											
С 4 по 7	Не определено.																																																											
30	Длина	<p>Поле произвольного текста (текстовые символы)</p> <p>Данное поле позволяет вносить комментарии, написанные произвольным текстом, передаваемые вместе с ЭКГ</p>																																																										
31	Длина	<p>Порядковый номер (текстовые символы)</p> <p>Порядковый номер ЭКГ</p>																																																										
32	Длина	<p>Коды диагнозов в анамнезе (двоичные значения)</p> <p>Данное поле содержит описание клинических проблем пациента и диагнозов. На количество диагнозов ограничений нет. Каждый диагноз должен быть представлен одним байтом. Байт 1 используется для обозначения применяемой таблицы кодов заболеваний. Если байт 1 не равен нулю, то это означает, что таблица кодов заболеваний не определена. Если этот байт равен нулю (0), то применяется следующий набор кодов:</p> <table> <tr> <td>Значение</td> <td>Содержание</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Диагнозы или клинические проблемы не указаны.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Является очевидно здоровым.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Острый инфаркт миокарда.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Инфаркт миокарда.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Предыдущие случаи инфаркта миокарда.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Ишемическая болезнь сердца.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Болезнь периферических сосудов.</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Порок сердца синего типа.</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Врожденный порок сердца бледного типа.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Порок клапана сердца.</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Повышенное кровяное давление.</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Нарушение мозгового кровообращения.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Кардиомиопатия.</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Перикардит.</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>Миокардит.</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>Послеоперационное состояние сердца.</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>Вживленный кардиостимулятор.</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>Эмболия легких.</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Респираторное заболевание.</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>Эндокринное заболевание.</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>Неврологическое заболевание.</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>Алиментарное заболевание.</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>Заболевание почек.</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Предоперационное состояние общей хирургии.</td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>Послеоперационное состояние общей хирургии.</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>Общемедицинский.</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>Другое.</td> </tr> <tr> <td>С 128 по 255</td> <td>Специфичное для производителя.</td> </tr> </table> <p>Отсутствующие числа в серии от 1 до 100 зарезервированы для будущего расширения некоторых категорий</p>	Значение	Содержание	0	Диагнозы или клинические проблемы не указаны.	1	Является очевидно здоровым.	10	Острый инфаркт миокарда.	11	Инфаркт миокарда.	12	Предыдущие случаи инфаркта миокарда.	15	Ишемическая болезнь сердца.	18	Болезнь периферических сосудов.	20	Порок сердца синего типа.	21	Врожденный порок сердца бледного типа.	22	Порок клапана сердца.	25	Повышенное кровяное давление.	27	Нарушение мозгового кровообращения.	30	Кардиомиопатия.	35	Перикардит.	36	Миокардит.	40	Послеоперационное состояние сердца.	42	Вживленный кардиостимулятор.	45	Эмболия легких.	50	Респираторное заболевание.	55	Эндокринное заболевание.	60	Неврологическое заболевание.	65	Алиментарное заболевание.	70	Заболевание почек.	80	Предоперационное состояние общей хирургии.	81	Послеоперационное состояние общей хирургии.	90	Общемедицинский.	100	Другое.	С 128 по 255	Специфичное для производителя.
Значение	Содержание																																																											
0	Диагнозы или клинические проблемы не указаны.																																																											
1	Является очевидно здоровым.																																																											
10	Острый инфаркт миокарда.																																																											
11	Инфаркт миокарда.																																																											
12	Предыдущие случаи инфаркта миокарда.																																																											
15	Ишемическая болезнь сердца.																																																											
18	Болезнь периферических сосудов.																																																											
20	Порок сердца синего типа.																																																											
21	Врожденный порок сердца бледного типа.																																																											
22	Порок клапана сердца.																																																											
25	Повышенное кровяное давление.																																																											
27	Нарушение мозгового кровообращения.																																																											
30	Кардиомиопатия.																																																											
35	Перикардит.																																																											
36	Миокардит.																																																											
40	Послеоперационное состояние сердца.																																																											
42	Вживленный кардиостимулятор.																																																											
45	Эмболия легких.																																																											
50	Респираторное заболевание.																																																											
55	Эндокринное заболевание.																																																											
60	Неврологическое заболевание.																																																											
65	Алиментарное заболевание.																																																											
70	Заболевание почек.																																																											
80	Предоперационное состояние общей хирургии.																																																											
81	Послеоперационное состояние общей хирургии.																																																											
90	Общемедицинский.																																																											
100	Другое.																																																											
С 128 по 255	Специфичное для производителя.																																																											
33	2	<p>Код конфигурации электродов (двоичные значения)</p> <p>Данное поле используется для идентификации размещения и системы электродов.</p> <table> <tr> <td>Байты</td> <td>Содержание</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Двоичное. Код, представляющий определения системы размещений электродов для ЭКГ в 12 отведениях (стандартная, Мэсон-Ликар, Omnitrode и т. п.).</td> </tr> <tr> <td>Значение</td> <td>Система размещения электродов</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Не указано.</td> </tr> </table> <p>Примечание — Картирующие устройства, не записывающие информацию о размещении электродов, должны использовать 0.</p>	Байты	Содержание	1	Двоичное. Код, представляющий определения системы размещений электродов для ЭКГ в 12 отведениях (стандартная, Мэсон-Ликар, Omnitrode и т. п.).	Значение	Система размещения электродов	0	Не указано.																																																		
Байты	Содержание																																																											
1	Двоичное. Код, представляющий определения системы размещений электродов для ЭКГ в 12 отведениях (стандартная, Мэсон-Ликар, Omnitrode и т. п.).																																																											
Значение	Система размещения электродов																																																											
0	Не указано.																																																											

Продолжение таблицы 4

Тега	Длина	Значение (данные параметра)			
33	2	1	Стандартные положения для 12 отведений: RA, RL, LA и LL размещены на конечностях. V1—V6 в стандартных положениях на груди. Все электроды размещаются индивидуально.		
		2	RA, RL, LA и LL размещаются на туловище (положения по Масону — Ликару). V1—V6 в стандартных положениях на груди. Все электроды размещаются индивидуально.		
		3	RA, RL, LA и LL размещаются на туловище (положения по Масону — Ликару). Электроды конечностей размещаются индивидуально. V1—V6 размещаются на груди, как часть электродного пояса (V1—V6 НЕ размещаются индивидуально).		
		4	RA, RL, LA, LL и V1—V6 (все электроды) размещаются на груди в одном электродном поясе (как Omnitrode). (Никакие из электродов не размещаются индивидуально).		
		5	ЭКГ в 12 отведениях получена из отведений Франка XYZ.		
		6	ЭКГ в 12 отведениях получена из нестандартных отведений.		
		С 7 по 255	Еще не определены. Зарезервированы для будущего использования.		
		2	Двоичное. Код, представляющий определения для системы размещения электродов для отведений XYZ, например Франк, Cube, McFee-Parungao, биполярные и т. п. [По вопросам размещения электродов на теле и уравнивающих резисторов см. главу 1 книги Vectorcardiography (Alberto Benchimol, Williams & Wilkins, Baltimore, 1973).]		
		Значения	Система размещения электродов		
		0	Не указано.		
Примечание — Картирующие устройства, не записывающие информацию о размещении электродов, должны использовать 0.					
1	Система отведений Франка (Frank, 1959; 13:737).				
2	Система отведений McFee-Parungao (см. Benchimol, Vectorcardiography, Williams & Wilkins, Baltimore, 1973, страница 6, рисунок 1.6).				
3	Система отведений Cube (Grishman et al, Amer. Heart J. 1951; 41, стр. 483).				
4	Система отведений XYZ биполярная нескорректированная (bipolar uncorrected).				
5	Система отведений XYZ псевдоортогональная (как используется в холтеровских записях).				
6	Отведения XYZ, полученные из стандартной ЭКГ в 12 отведений.				
С 7 по 255	Еще не определены. Зарезервированы для будущего использования.				
34	Длина	Часовой пояс (двоичные байты и текстовые символы)			
		Содержание данного тега идентифицирует глобальный часовой пояс, в котором были собраны данные, тем самым позволяя осуществить преобразование указанного с помощью тегов 25 и 26 времени в любой часовой пояс (например, UTC). Следующие байты параметров данного тега предоставляют три способа указания часового пояса.			
		Байт	Название	Тип	Примечания
		1, 2	Сдвиг	Двоичное со знаком	Часовой пояс, указанный как смещение от UTC в минутах (примечание 1).
		3, 4	Индекс	Двоичное без знака	Часовой пояс, указанный с помощью отображения, определенного производителем (до тех пор, пока не будет определено согласованное отображение с помощью байтов с 1 по 1000), используя это значение как индекса в следующей справочной таблице (примечание 2).
				Значение	Описание
				0	Индекс не используется
				С 1 по 1000	Зарезервировано для будущего использования
				С 1001 по 32 766	Специфичный для производителя
				32 766	Зарезервировано
с 5 по ***	Описание	Текстовая строка	Часовой пояс, указанный с помощью строки, завершающейся NULL (примечание 3).		

Окончание таблицы 4

Тег	Длина	Значение (данные параметра)
34	Длина	<p>Примечания</p> <p>1 Для смещения разрешены значения от -780 до $+780$ (т. е. ± 13 час.) и шестнадцатеричное значение $0x7FFF$, которое указывает, что поле не инициализировано или не используется. Если поле сдвига содержит разрешенное значение, отличное от $0x7FFF$, то поля индекса и описания полагаются избыточными и могут быть проигнорированы.</p> <p>2 Значение индекса задает часовой пояс только в том случае, когда значение смещения равно $0x7FFF$. Нулевое значение индекса указывает, что поле не используется или не инициализировано. Использование этого байта в соответствии с текущим определением зависит от производителя.</p> <p>3 Поле описания задает часовой пояс только в том случае, когда значение смещения равно $0x7FFF$. Эта строка должна иметь формат переменной окружения TZ в соответствии со стандартом Posix (Unix). Ссылка: <code>tzset()</code> — название стандартной подпрограммы в языке 'C/C++', переменная окружения «TZ» и связанные с ними структуры данных. Поле описания должно содержать не менее 1 байта (т. е. завершающий NULL).</p> <p>4 Если для устройства часовой пояс не определен, то тег 34 может не включаться в запись данных. Аналогично, если часовой пояс не определен, то можно использовать экземпляр тега 34, содержащий смещение = $0x7FFF$, индекс = 0, а описание = NULL.</p>
35	Длина	<p>Анамнез заболевания свободным текстом (текстовые символы)</p> <p>Данное поле позволяет вводить анамнез заболевания свободным текстом</p>
255	0	Отсутствует (завершающее значение раздела демографической информации)

5.5 Таблицы Хаффмана. Раздел 2

5.5.1 Если этот раздел присутствует, то он должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

5.5.2 Схема для сжатия сигнала, представленная ниже, основана на методе кодирования Хаффмана. Данный метод не является единственным возможным, но является рекомендуемым.

5.5.3 Данный раздел записи ЭКГ содержит определение кодовых таблиц Хаффмана, которые использовались для кодирования ЭКГ. Предоставление нескольких таблиц позволяет осуществлять оптимальное кодирование данных (например, для сжатия эталонного цикла и данных ритма, скорее всего, будут использованы разные таблицы). Следует предполагать, что при кодировании данных каждого элемента использовалась таблица № 1 (т. е. первая таблица, определенная в этом разделе 2). Для перехода к другой таблице должны использоваться управляющие коды.

5.5.4 Используются следующие базовые значения:

1) Базовое время считываний, определенное в разделе, описывающем закодированные данные (т. е. разделе 5 «Данные эталонного цикла» и разделе 6 «Данные ритма»).

2) Базовая амплитуда ЭКГ, как она определена в разделе, описывающем закодированные данные (т. е. в разделе 5 «Данные эталонного цикла» и разделе 6 «Данные ритма»).

Соответственно, структура данных, описанная в настоящем пункте, имеет следующий вид:

Байты	Содержание
1, 2	Число определенных таблиц Хаффмана (если оно равно 19999, то используется таблица по умолчанию, определенная в С.3.7.6).
3, 4	Число кодовых структур в таблице № 1.
С 5 по ***	Структуры, определяющие каждый код в таблице № 1. Каждая из структур имеет следующий формат:
1 байт	Число битов в префиксе.
1 байт	Число битов во всем коде.
1 байт	Режим переключения таблицы.
	Значение Содержание
	0 Переключиться на другую таблицу Хаффмана.
	1 Кодирование Хаффмана, если число битов в префиксе равно числу битов во всем коде.
	1 Исходные данные, если число битов в префиксе меньше числа битов во всем коде.

2 байта	Базовое значение, представленное базовым кодом [в единицах множителя величины амплитуды (AVM)].
4 байта	Базовый код — первый бит в коде, представленный младшим значащим битом 4-байтовой области.
*** + 1, *** + 2	Число структур в таблице № 2.
C *** + 3 по ***	Структуры, представляющие таблицу № 2.
и т. д.	

Коды Хаффмана были определены, чтобы разрешить отдельной структуре, описанной выше, задавать серии последовательных значений амплитуды. Упомянутый выше «префикс» является общим для всех кодов, описывающих последовательные значения — оставшееся битовое поле изменяется на один младший значащий бит (LSB) при его приращении в указанном диапазоне.

Пример байтовой структуры кода Хаффмана для этого случая показан в таблице 5.

Таблица 5 — Пример байтовой структуры (код Хаффмана)

	MSB							LSB
Принятый байт 1	P1	P2	P3	P4	C1	C2	C3	C4
Принятый байт 2	C5	C6	P5	P6	P7	C7	C8	C9
Принятый байт 3	C10	C11	P8	P9	P10	C12	C13	C14
И т. д.

Примечание — Данный пример представляет следующие закодированные значения:

P1 P2 P3 P4 C1 C2 C3 C4 C5 C6

4-битовый префикс для общей длины кода 10.

P5 P6 P7 C7 C8 C9 C10 C11

3-битовый префикс для общей длины кода 8.

P8 P9 P10 C12 C13 C14

3-битовый префикс для общей длины кода 6.

Следует учесть, что «выбор» битов в заданном байте осуществляется от старшего значащего к младшему значащему и что обработка байтов осуществляется в том порядке, в котором они были получены.

Управляющие коды, т. е. коды, которые диктуют смену таблицы Хаффмана, должны включать в себя нулевое значение (0) «переключателя режима таблицы». «Базовое значение» должно в таком случае содержать номер таблицы, на которую необходимо переключиться.

Обзор данных этого раздела представлен на рисунке 5.



Рисунок 5 — Обзор структуры раздела таблиц Хаффмана

5.6 Определения отведений ЭКГ. Раздел 3

5.6.1 Данный раздел определяет отведения, которые передаются вместе с некоторой общей административной информацией.

5.6.2 Если данный раздел присутствует, то он должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

5.6.3 Данные раздела определены ниже:

Байты	Содержание
1	Число включенных отведений.
2	Байт флага: <ul style="list-style-type: none"> Бит 0 (LSB) Установлен = вычитание эталонного цикла используется для сжатия. Сброшен = вычитание эталонного цикла не используется для сжатия. Бит 1 Зарезервированный. Бит 2 Установлен = все отведения записываются одновременно. Сброшен = не все отведения записываются одновременно. Биты с 3 по 7 Число одновременно записываемых отведений.
с 3 по 11	Подробное описание первого отведения (см. 5.6.4).
с 12 по 20	Подробное описание второго отведения (см. 5.6.4)
и т. д.	

Если не все отведения записываются одновременно, то эти отведения должны быть представлены в группах, соответствующих тем отведениям, что записаны одновременно.

Пример — Тройки отведений записываются одновременно: например, первая тройка отведений I, aVF, V2; вторая тройка отведений X, Y, Z и т. д. Детальная информация об отведениях должна быть приведена в описанном выше порядке: отведение I в первом сегменте (с 3 по 11), отведение aVF во втором сегменте (с 12 по 20), отведение V2 в третьем сегменте (с 21 по 29), отведение X в четвертом сегменте (с 30 по 38) и т. д.

Для каждого отведения передается следующая детальная информация:

Байты	Содержание
С 1 по 4	Номер начального считывания (без знака).
С 5 по 8	Номер последнего считывания (без знака).
9	Идентификация отведения. Следует использовать схему нумерации, приведенную в таблице 6.

Таблица 6 — Коды идентификации отведений

Название в SCP-ECG	Код SCP-ECG	Описание	VITAL[12] Ref ID MDC_ECG_LEAD_xxx
	0	Неспецифицированное отведение	MDC_ECG_LEAD_CONFIG
I	1	Отведение I	MDC_ECG_LEAD_I
II	2	Отведение II	MDC_ECG_LEAD_II
V1	3	V1	MDC_ECG_LEAD_V1
V2	4	V2	MDC_ECG_LEAD_V2
V3	5	V3	MDC_ECG_LEAD_V3
V4	6	V4	MDC_ECG_LEAD_V4
V5	7	V5	MDC_ECG_LEAD_V5
V6	8	V6	MDC_ECG_LEAD_V6
V7	9	V7	MDC_ECG_LEAD_V7
V2R ^{a)}	10	V2R	MDC_ECG_LEAD_V2R
V3R	11	V3R	MDC_ECG_LEAD_V3R
V4R	12	V4R	MDC_ECG_LEAD_V4R
V5R	13	V5R	MDC_ECG_LEAD_V5R

Продолжение таблицы 6

Название в SCP-ECG	Код SCP-ECG	Описание	VITAL[12] Ref ID MDC_ECG_LEAD_xxx
V6R	14	V6R	MDC_ECG_LEAD_V6R
V7R	15	V7R	MDC_ECG_LEAD_V7R
X	16	X ^{b)}	MDC_ECG_LEAD_X
Y	17	Y ^{b)}	MDC_ECG_LEAD_Y
Z	18	Z ^{b)}	MDC_ECG_LEAD_Z
CC5 ^{c)}	19	CC5, для позиций V5 и V5R	MDC_ECG_LEAD_CC5
CM5	20	CM5, для позиции V5	MDC_ECG_LEAD_CM5
LA	21	Левая рука	MDC_ECG_LEAD_LA
RA	22	Правая рука	MDC_ECG_LEAD_RA
LL	23	Левая нога	MDC_ECG_LEAD_LL
fl ^{d)}	24	fl	MDC_ECG_LEAD_fl
fE	25	fE	MDC_ECG_LEAD_fE
fC	26	fC	MDC_ECG_LEAD_fC
fA	27	fA	MDC_ECG_LEAD_fA
fM	28	fM	MDC_ECG_LEAD_fM
fF	29	fF	MDC_ECG_LEAD_fF
fH	30	fH	MDC_ECG_LEAD_fH
dI	31	Производное отведение I	MDC_ECG_LEAD_dI
dII	32	Производное отведение II	MDC_ECG_LEAD_dII
dV1	33	Производное отведение V1	MDC_ECG_LEAD_dV1
dV2	34	Производное отведение V2	MDC_ECG_LEAD_dV2
dV3	35	Производное отведение V3	MDC_ECG_LEAD_dV3
dV4	36	Производное отведение V4	MDC_ECG_LEAD_dV4
dV5	37	Производное отведение V5	MDC_ECG_LEAD_dV5
dV6	38	Производное отведение V6	MDC_ECG_LEAD_dV6
dV7	39	Производное отведение V7	
dV2R	40	Производное отведение V2R	
dV3R	41	Производное отведение V3R	
dV4R	42	Производное отведение V4R	
dV5R	43	Производное отведение V5R	
dV6R	44	Производное отведение V6R	
dV7R	45	Производное отведение V7R	
dX	46	Производное отведение X	
dY	47	Производное отведение Y	
dZ	48	Производное отведение Z	

Продолжение таблицы 6

Название в SCP-ECG	Код SCP-ECG	Описание	VITAL[12] Ref ID MDC_ECG_LEAD_XXX
dCC5	49	Производное отведение CC5	
dCM5	50	Производное отведение CM5	
dLA	51	Производное отведение LA	
dRA	52	Производное отведение RA	
dLL	53	Производное отведение LL	
dfl	54	Производное отведение fl	
dfE	55	Производное отведение fE	
dfC	56	Производное отведение fC	
dfA	57	Производное отведение fA	
dfM	58	Производное отведение fM	
dfF	59	Производное отведение fF	
dfH	60	Производное отведение fH	
III	61	Отведение III	MDC_ECG_LEAD_III
aVR	62	aVR, усиленное отведение от правой руки	MDC_ECG_LEAD_AVR
aVL	63	aVL, усиленное отведение от левой руки	MDC_ECG_LEAD_AVL
aVF	64	aVF, усиленное отведение от левой ноги	MDC_ECG_LEAD_AVF
aVRneg	65	aVRneg	MDC_ECG_LEAD_AVRneg
V8	66	V8	MDC_ECG_LEAD_V8
V9	67	V9	MDC_ECG_LEAD_V9
V8R	68	V8R	MDC_ECG_LEAD_V8R
V9R	69	V9R	MDC_ECG_LEAD_V9R
D	70	D (no HeBy — dorsalis)	MDC_ECG_LEAD_D
A	71	A (no HeBy — anterior)	MDC_ECG_LEAD_A
J	72	J (no HeBy — inferior)	MDC_ECG_LEAD_J
Defib	73	Отведение дефибриллятора: передне-боковое	MDC_ECG_LEAD_DEFIB
Extern	74	Отведение внешнего кардиостимулятора: передне-заднее	MDC_ECG_LEAD_EXTERN
A1	75	A1 (вспомогательное униполярное отведение #1)	MDC_ECG_LEAD_A1
A2	76	A2 (вспомогательное униполярное отведение #2)	MDC_ECG_LEAD_A2
A3	77	A3 (вспомогательное униполярное отведение #3)	MDC_ECG_LEAD_A3
A4	78	A4 (вспомогательное униполярное отведение #4)	MDC_ECG_LEAD_A4
dV8	79	Производное отведение V8	
dV9	80	Производное отведение V9	
dV8R	81	Производное отведение V8R	
dV9R	82	Производное отведение V9R	
dD	83	Производное отведение D (no HeBy — dorsalis)	

Продолжение таблицы 6

Название в SCP-ECG	Код SCP-ECG	Описание	VITAL[12] Ref ID MDC_ECG_LEAD_xxx
dA	84	Производное отведение A (по Небу — anterior)	
dJ	85	Производное отведение J (по Небу — inferior)	
Chest	86	Грудное отведение	MDC_ECG_LEAD_C
V	87	Прекардиальное отведение	MDC_ECG_LEAD_V
VR	88	VR, не усиленное, вектор RA	MDC_ECG_LEAD_VR
VL	89	VL, не усиленное, вектор LA	MDC_ECG_LEAD_VL
VF	90	VF, не усиленное, вектор LL	MDC_ECG_LEAD_VF
MCL	91	Модифицированное грудное отведение (индифферентный электрод на левой руке)	MDC_ECG_LEAD_MCL
MCL1	92	MCL, в позиции V1	MDC_ECG_LEAD_MCL1
MCL2	93	MCL, в позиции V2	MDC_ECG_LEAD_MCL2
MCL3	94	MCL, в позиции V3	MDC_ECG_LEAD_MCL3
MCL4	95	MCL, в позиции V4	MDC_ECG_LEAD_MCL4
MCL5	96	MCL, в позиции V5	MDC_ECG_LEAD_MCL5
MCL6	97	MCL, в позиции V6	MDC_ECG_LEAD_MCL6
CC	98	Грудное отведение (симметричное размещение)	MDC_ECG_LEAD_CC
CC1	99	CC1, в позициях V1 и V1R	MDC_ECG_LEAD_CC1
CC2	100	CC2, в позициях V2 и V2R	MDC_ECG_LEAD_CC2
CC3	101	CC3, в позициях V3 и V3R	MDC_ECG_LEAD_CC3
CC4	102	CC4, в позициях V4 и V4R	MDC_ECG_LEAD_CC4
CC6	103	CC6, в позициях V6 и V6R	MDC_ECG_LEAD_CC6
CC7	104	CC7, в позициях V7 и V8R	MDC_ECG_LEAD_CC7
CM	105	Грудные отведения	MDC_ECG_LEAD_CM
CM1	106	CM1, в позиции V1	MDC_ECG_LEAD_CM1
CM2	107	CM2, в позиции V2	MDC_ECG_LEAD_CM2
CM3	108	CM3, в позиции V3	MDC_ECG_LEAD_CM3
CM4	109	CM4, в позиции V4	MDC_ECG_LEAD_CM4
CM6	110	CM6, в позиции V6	MDC_ECG_LEAD_CM6
dIII	111	Производное отведение III	MDC_ECG_LEAD_dIII
daVR	112	Производное отведение aVR	MDC_ECG_LEAD_daVR
daVL	113	Производное отведение aVL	MDC_ECG_LEAD_daVL
daVF	114	Производное отведение aVF	MDC_ECG_LEAD_daVF
daVRneg	115	Производное отведение aVRneg	
dChest	116	Производное отведение Chest	
dV	117	Производное отведение V	

Продолжение таблицы 6

Название в SCP-ECG	Код SCP-ECG	Описание	VITAL[12] Ref ID MDC_ECG_LEAD_XXX
dVR	118	Производное отведение VR	
dVL	119	Производное отведение VL	
dVF	120	Производное отведение VF	
CM7	121	CM7, в позиции V7	MDC_ECG_LEAD_CM7
CH5	122	CH5	MDC_ECG_LEAD_CH5
CS5	123	Отрицательное: правая подключичная ямка	MDC_ECG_LEAD_CS5
CB5	124	Отрицательное: нижний угол правой лопатки	MDC_ECG_LEAD_CB5
CR5	125	CR5	MDC_ECG_LEAD_CR5
ML	126	ML, модифицированное стандартное отведение, ~ отведение II	MDC_ECG_LEAD_ML
AB1	127	AB1 (вспомогательное биполярное отведение #1)	MDC_ECG_LEAD_AB1
AB2	128	AB2 (вспомогательное биполярное отведение #2)	MDC_ECG_LEAD_AB2
AB3	129	AB3 (вспомогательное биполярное отведение #3)	MDC_ECG_LEAD_AB3
AB4	130	AB4 (вспомогательное биполярное отведение #4)	MDC_ECG_LEAD_AB4
ES	131	EASI™ ES [®]	MDC_ECG_LEAD_ES
AS	132	EASI AS	MDC_ECG_LEAD_AS
AI	133	EASI AI	MDC_ECG_LEAD_AI
S	134	EASI верхнее грудинное отведение	MDC_ECG_LEAD_S
dDefib	135	Производное отведение Defib: Отведение дефибриллятора: передне-боковое	
dExtern	136	Производное отведение Extern: отведение внешнего кардиостимулятора передне-заднее	
dA1	137	Производное отведение A1 (вспомогательное униполярное отведение #1)	
dA2	138	Производное отведение A2 (вспомогательное униполярное отведение #2)	
dA3	139	Производное отведение A3 (вспомогательное униполярное отведение #3)	
dA4	140	Производное отведение A4 (вспомогательное униполярное отведение #4)	
dMCL1	141	Производное отведение MCL1: MCL, в позиции V1	
dMCL2	142	Производное отведение MCL2: MCL, в позиции V2	
dMCL3	143	Производное отведение MCL3: MCL, в позиции V3	
dMCL4	144	Производное отведение MCL4: MCL, в позиции V4	
dMCL5	145	Производное отведение MCL5: MCL, в позиции V5	
dMCL6	146	Производное отведение MCL6: MCL, в позиции V6	
RL	147	Правая нога	MDC_ECG_LEAD_RL

Продолжение таблицы 6

Название в SCP-ECG	Код SCP-ECG	Описание	VITAL[12] Ref ID MDC_ECG_LEAD_XXX
CV5RL	148	Собаچه, в пятом межреберье над грудиной справа, в самой изогнутой части реберного хряща	MDC_ECG_LEAD_CV5RL
CV6LL	149	Собаچه, в шестом межреберье над грудиной слева, в самой изогнутой части реберного хряща	MDC_ECG_LEAD_CV6LL
CV6LU	150	Собаچه, в шестом межреберье на уровне реберно-хрящевых соединений слева	MDC_ECG_LEAD_CV6LU
V10	151	Собаچه, над остистым отростком седьмого грудного позвонка	MDC_ECG_LEAD_V10
dMCL	152	Производное отведение MCL. Модифицированное грудное отведение (индифферентный электрод на левой руке)	
dCC	153	Производное отведение CC. Грудное отведение (симметричная позиция)	
dCC1	154	Производное отведение CC1, в позициях V1 и V1R	
dCC2	155	Производное отведение CC2, в позициях V2 и V2R	
dCC3	156	Производное отведение CC3, в позициях V3 и V3R	
dCC4	157	Производное отведение CC4, в позициях V4 и V4R	
dCC6	158	Производное отведение CC6, в позициях V6 и V6R	
dCC7	159	Производное отведение CC7, в позициях V7 и V8R	
dCM	160	Производное отведение CM, грудное-грудинное	
dCM1	161	Производное отведение CM1, в позиции V1	
dCM2	162	Производное отведение CM2, в позиции V2	
dCM3	163	Производное отведение CM3, в позиции V3	
dCM4	164	Производное отведение CM4, в позиции V4	
dCM6	165	Производное отведение CM6, в позиции V6	
dCM7	166	Производное отведение CM7, в позиции V7	
dCH5	167	Производное отведение CH5	
dCS5	168	Производное отведение CS5: отрицательное: правая подключичная ямка	
дCB5	169	Производное отведение CB5: отрицательное: нижний угол правой лопатки	
dCR5	170	Производное отведение CR5	
dML	171	Производное отведение ML, модифицированное стандартное отведение, ~ отведения II	
dAB1	172	Производное отведение AB1 (вспомогательное биполярное отведение #1)	
dAB2	173	Производное отведение AB2 (вспомогательное биполярное отведение #2)	
dAB3	174	Производное отведение AB3 (вспомогательное биполярное отведение #3)	

Окончание таблицы 6

Название в SCP-ECG	Код SCP-ECG	Описание	VITAL[12] Ref ID MDC_ECG_LEAD_xxx
dAB4	175	Производное отведение AB4 (вспомогательное биполярное отведение #4)	
dES	176	Производное отведение ES. EASI ^{e)} ES	
dAS	177	Производное отведение AS. EASI AS	
dAI	178	Производное отведение AI. EASI AI	
dS	179	Производное отведение S. EASI верхнее грудинное отведение	
dRL	180	Производное отведение RL: правая нога	
dCV5RL	181	Производное отведение CV5RL. Собачье, в пятом межреберье над грудиной справа, в самой изогнутой части реберного хряща	
dCV6LL	182	Производное отведение CV6LL. Собачье, в шестом межреберье над грудиной слева, в самой изогнутой части реберного хряща	
dCV6LU	183	Производное отведение CV6LU. Собачье, в шестом межреберье на уровне реберно-хрящевых соединений слева	
dV10	184	Производное отведение V10. Собачье, над остистым отростком седьмого грудного позвонка	
	C 185 по 199	Зарезервировано для будущих расширений	
	C 200 по 255	Специфично для производителя	
<p>^{a)} V2R идентично отведению V1. Подобным же образом, отведение V1R (не приведено в таблице отведений) идентично отведению V2.</p> <p>^{b)} Отведения X, Y и Z могут записываться с помощью ортогональной системы, например, системы отведений Франка или McFee и т. п.</p> <p>^{c)} Биполярные отведения CM5, CH5, CS5, CC5, CB5, CR5 используемые вместе с нагрузочной ЭКГ. Macfarlane, Том 1, страница 323 [CX5?].</p> <p>^{d)} Отведения Франка помечены буквой 'f' для ясности и сохранения уникальности маркировки.</p> <p>^{e)} Торговая марка EASI™, правообладателем которой является Philips. Изобретатель доктор Гордон Довер (Gordon Dower). Отведения: S, верхнее грудинное положение; E, нижнее грудинное положение (отведение Франка fE); A, в левой подмышечной линии над V6 (отведение Франка fA); I, в правой подмышечной линии над V6R (отведение Франка fI).</p> <p>Примечания</p> <p>1 Схемы нумерации отведений могут быть расширены в будущих ревизиях протокола.</p> <p>2 Во избежание ненамеренного дублирования кода этих диапазонов пользователям настоящего стандарта рекомендуется обратиться к документам [6], [12], а также к другим стандартам серии ИСО/ИИЭР.</p>			

5.6.4 Нумерация считываний должна начинаться с номера считываний 1 и ссылаться на все одновременно записываемые отведения. Чтобы преобразовать эти значения в единицы времени, следует учитывать частоту считываний соответствующего раздела данных (см. 5.8.3).

Например, если восемь отведений (I, II, V1—V6) записываются одновременно в течение 10 сек. с частотой 500 считываний в секунду и хранятся таким же образом, то каждое отведение начинается со считывания 1 и заканчивается считыванием 5000.

Если отведения записываются в группах по три отведения в каждой, например, в течение 2,5 сек. с частотой 500 считываний в секунду, то отведения I, II и III начинаются со считывания 1 и заканчиваются считыванием 1250, а отведения aVR, aVL и aVF начинаются со считывания 1251.

5.6.5 Обзор данных этого раздела представлен на рисунке 6.



Рисунок 6 — Обзор части данных раздела определения отведения ЭКГ

5.7 Местоположения QRS-комплексов, зоны вычитания эталонного цикла и защищенные области. Раздел 4

5.7.1 Если этот раздел присутствует, то он определяет местоположения и ширину различных комплексов QRS. Определение эталонного цикла, типов цикла и значимости эталонного цикла типа 0 см. в 5.1.11. Подробное описание общего процесса см. в приложении С.

5.7.2 Раздел должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

5.7.3 Область заголовка данных раздела определяет конкретные величины, общие для всех отведений эталонного цикла типа 0. Остальные данные обозначают тип эталонного цикла и местоположение каждого комплекса QRS по отношению к «остаточному» сигналу. Область заголовка данных раздела имеет следующее содержание:

Байты	Содержание
1, 2	Длина данных эталонного цикла типа 0 в миллисекундах.

Примечание — Число считываний N вычисляется в результате деления длины L эталонного цикла (в миллисекундах) на интервал времени между считываниями SI (в микросекундах, см. 5.9.3, байты 3, 4) по формуле

$$N = \text{усечение} \left[\frac{(1000 \text{ мкс/мс} \cdot L)}{SI} \right].$$

Производитель должен присвоить такую длину (в байтах от 1 до 2), чтобы при использовании этой формулы получилось требуемое число считываний эталонного цикла. Например, 1000 мс данных при 2000 мкс между считываниями дает N , равное 500 считываниям.

3, 4	Номер считывания (целое без знака), соответствующего опорной точке QRS-комплекса, относительно начала эталонного цикла типа 0. В приложении С эта точка сокращенно называется fcM . Первое считывание имеет номер 1.
5, 6	Общее число QRS-комплексов во всей записи ЭКГ.

5.7.4 Приведенная ниже информация о местоположении зон вычитания эталонного цикла хранится в блоках по 14 байтов для каждого QRS-комплекса. Общее число блоков равно числу QRS-комплексов. Оно хранится в байтах с 5 по 6 области заголовка, см. 5.7.3.

Байты	Содержание
1, 2	Тип цикла первого QRS (определение «типа цикла» см. в 5.1.11).
С 3 по 6	Номер считывания ¹⁾ (целое без знака) остаточных данных, указывающий начало вычитания/сложения эталонного цикла 0 для первого QRS-комплекса, если комплекс имеет тип 0, иначе нулевое значение (0) ²⁾ , ³⁾ .

¹⁾ Все номера считываний в данном разделе ссылаются на исходные считывания, сделанные перед обработкой для прореживания и/или сжатия. Первое считывание исходных данных нумеруется числом 1.

²⁾ Если байты 1, 2 указывают на эталонный цикл типа 0, то байты с 3 по 6 и с 11 по 14 выделяют область вокруг QRS-комплекса для вычитания или добавления эталонного цикла типа 0 в соответствии с указаниями и иллюстрациями, приведенными в приложении С. Границы этой области в приложении С сокращенно называются $SB(k)$ и $SE(k)$ соответственно.

³⁾ Если байты 1, 2 указывают на эталонный цикл не нулевого типа, то вычитание эталонного цикла не используется, в таком случае байты с 3 по 6 и с 11 по 14 содержат 0 (нуль).

- С 7 по 10 Номер считывания¹⁾ (целое без знака) остаточных данных, указывающий опорную точку 1-го QRS-комплекса²⁾. В приложении С данное местоположение сокращенно называется $fc(1)$.
- С 11 по 14 Номер считывания¹⁾ (целое без знака) остаточных данных, указывающий конец вычитания/добавления эталонного цикла 0 для 1-го QRS-комплекса, если комплекс имеет тип 0, в противном случае нулевое значение (0)³⁾, 4).
- С 15 по 16 Тип цикла 2-го QRS-комплекса
и т. д.

5.7.5 Приведенная ниже информация по местоположению защищенных областей (QRS-комплексов) хранится в блоках по 8 байтов на каждый QRS-комплекс. Общее число блоков равно числу QRS-комплексов и хранится в байтах с 5 по 6 области заголовка²⁾, см. 5.7.3.

Байты Содержание

- С 1 по 4 Номер считывания¹⁾ (целое без знака) остаточных данных, указывающий начало защищенной области 1-го QRS-комплекса. В приложении С данное местоположение сокращенно называется $QB(1)$.
- С 5 по 8 Номер считывания¹⁾ (целое без знака) остаточных данных, указывающий конец защищенной области 1-го QRS-комплекса. В приложении С данное местоположение сокращенно называется $QE(1)$.
- С 9 по 12 Номер считывания¹⁾ (целое без знака) остаточных данных, указывающий начало защищенной области 2-го QRS-комплекса. В приложении С данное местоположение сокращенно называется $QB(2)$.
- С 13 по 16 Номер считывания¹⁾ (целое без знака) остаточных данных, указывающий конец защищенной области 2-го QRS-комплекса. В приложении С данное местоположение сокращенно называется $QE(2)$.

и т. д.

5.7.6 Обзор данных этого раздела представлен на рисунке 7.



Рисунок 7 — Обзор структуры раздела 4

5.8 Закодированные данные эталонного цикла типа 0. Раздел 5

5.8.1 Данный раздел содержит подробное описание эталонного цикла типа 0. Определение эталонного цикла, типов эталонного цикла и значимости эталонного цикла типа 0 см. в 5.1.11. Детальное описание общего процесса см. в приложении С.

5.8.2 Если этот раздел присутствует, то он должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

¹⁾ Все номера считываний в данном разделе ссылаются на исходные считывания, сделанные перед обработкой для прореживания и/или сжатия. Первое считывание исходных данных нумеруется числом 1.

²⁾ Блоки, описанные в 5.7.4 и 5.7.5, могут также использоваться для указания местоположения защищенных зон при использовании бимодального сжатия без вычитания эталонного цикла. В этом случае байты с 3 по 6 и с 11 по 14 блока, описанного в 5.7.4, должны иметь значение 0.

³⁾ Если байты 1, 2 указывают на эталонный цикл типа 0, то байты с 3 по 6 и с 11 по 14 выделяют область вокруг QRS-комплекса для вычитания или добавления эталонного цикла типа 0 в соответствии с указаниями и иллюстрациями, приведенными в приложении С. Границы этой области в приложении С сокращенно называются $SB(k)$ и $SE(k)$ соответственно.

⁴⁾ Если байты 1, 2 указывают на эталонный цикл не нулевого типа, то вычитание эталонного цикла не используется, в таком случае байты с 3 по 6 и с 11 по 14 содержат 0 (нуль).

5.8.3 Данные раздела начинаются с заголовка, имеющего следующий формат:

Байты	Содержание
1, 2	Множитель величины амплитуды (AVM). Используется следующим образом: Множитель значения амплитуды выражается в нановольтах ($1 \cdot 10^{-9}$ В). <i>Пример</i> — 1250 → 1 квант амплитуды = 1,250 мкВ. 2441 → 1 квант амплитуды = 2,441 мкВ.
3, 4	Интервал времени между считываниями для данного раздела выражается в микросекундах ($1 \cdot 10^{-6}$ с). <i>Пример</i> — 4000 → 250 считываний/с; 1250 → 800 считываний/с.
5	Данное значение следующим образом идентифицирует кодирование данных считываний: 0 = фактические (разность нулевого порядка) данные, используемые для данных эталонного цикла 0; 1 — данные разности первого порядка, используемые для данных эталонного цикла 0; 2 — данные разности второго порядка, используемые для данных эталонного цикла 0.
6	Зарезервировано.

Примечания

1 Данные разности определяются как: [значение считываний (разность) в момент времени t] — [значение считываний (разность) в момент времени $t - 1$]. См. таблицу 7.

2 Для первых двух считываний в каждом отведении разности второго порядка в протоколе SCP-ECG не вычисляются. Амплитуды исходных значений этих считываний сохраняются. Значение первого считывания также сохраняется в потоке закодированных данных, использующем разности первого порядка.

3 Пример результатов, закодированных с помощью разностей второго порядка, приведен в таблице 8 для серии из восьми считываний.

4 Пример результатов, закодированных с помощью разностей первого порядка, приведен в таблице 9 для той же серии из восьми считываний.

Таблица 7 — Вычисление разностей

Исходные данные	Разности первого порядка	Разности второго порядка
X(1)	D1(1)=X(1)	D2(1)=X(1)
X(2)	D1(2)=X(2) - X(1)	D2(2)=X(2)
X(3)	D1(3)=X(3) - X(2)	D2(3)=D1(3) - D1(2)=X(3) - 2*X(2) + X(1)
X(4)	D1(4)=X(4) - X(3)	D2(4)=D1(4) - D1(3)=X(4) - 2*X(3) + X(2)

Таким образом, общая формула для разности первого порядка имеет следующий вид

$$D1(n) = X(n) - X(n - 1).$$

Общая формула для разности второго порядка имеет следующий вид

$$D2(n) = X(n) - 2 \cdot X(n - 1) + X(n - 2).$$

Декодирование данных разности второго порядка выполняется по следующей формуле

$$X(n) = D2(n) + 2 \cdot X(n - 1) - X(n - 2).$$

Таблица 8 — Пример закодированных результатов с помощью разностей второго порядка

Номер считывания	n	1	2	3	4	5	6	7	8
Значение считывания	X(n)	10	12	13	15	18	22	20	15
Разность 2-го порядка	D2(n)	—	—	-1	1	1	1	-6	-3
Закодированные данные		10	12	-1	1	1	1	-6	-3

Таблица 9 — Пример закодированных результатов с помощью разностей первого порядка

Номер считывания	n	1	2	3	4	5	6	7	8
Значение считывания	$X(n)$	10	12	13	15	18	22	20	15
Разность 1-го порядка	$D1(n)$	—	2	1	2	3	4	-2	-5
Закодированные данные		10	2	1	2	3	4	-2	-5

5.8.4 Данные раздела содержат длины байтов закодированных отведений. Они имеют следующий формат:

Байты	Содержание
1, 2	Число байтов (целое без знака) в сжатых данных эталонного цикла 0 для первого закодированного отведения.
3, 4	Число байтов (целое без знака) в сжатых данных эталонного цикла 0 для второго закодированного отведения

и т. д.

5.8.5 Затем следуют закодированные данные эталонного цикла 0. Если раздел 2 присутствует, то данные кодируются как последовательности кодов Хаффмана, взятых из раздела 2. Отведения кодируются в порядке, указанном в разделе 3. Если раздел 2 отсутствует, то данные ЭКГ (разностные или неразностные) должны иметь формат двухбайтовых целых чисел со знаком.

Могут быть применены другие форматы за счет предоставления «фиктивной» таблицы Хаффмана с одной структурой кода. Число битов префикса должен быть присвоен нуль. Число битов всего кода должно быть присвоено желаемое число битов в значении считывания.

5.8.6 Обзор данных этого раздела представлен на рисунке 8.

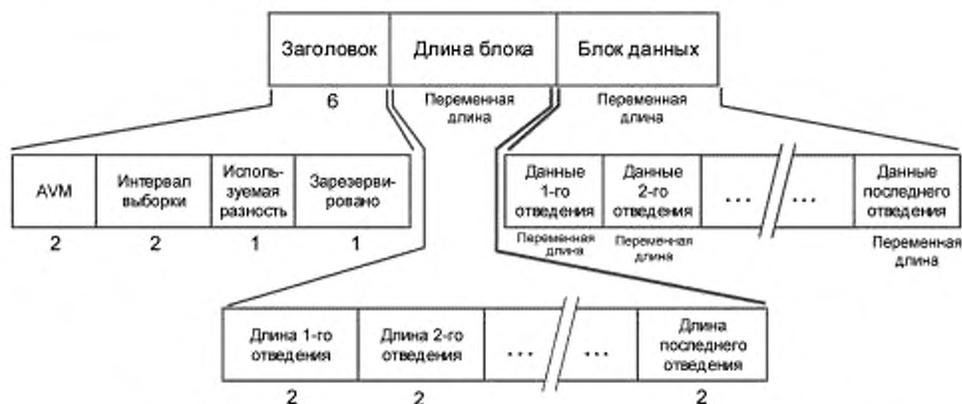


Рисунок 8 — Обзор структуры раздела закодированного эталонного цикла типа 0

5.9 Данные ритма. Раздел 6

5.9.1 Данный раздел содержит либо:

- 1) все данные ритма ЭКГ целиком, если не было произведено никаких вычитаний эталонного цикла (см. 5.6.3, байт 2), либо
- 2) остаточный сигнал после вычитания эталонных циклов.

5.9.2 Если данный раздел присутствует, то он должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

5.9.3 Данные раздела начинаются с заголовка, имеющего следующий формат:

Байты	Содержание
1, 2	Множитель величины амплитуды (AVM). Используется следующим образом: Множитель величины амплитуды выражен в нановольтах ($1 \cdot 10^{-9}$ Вольт).

Пример — 1250 → 1 квант амплитуды = 1,250 мкВ.
2441 → 1 квант амплитуды = 2,441 мкВ.

- 3, 4 Интервал времени считываний для данного раздела в микросекундах ($1 \cdot 10^{-6}$ с).
Пример — 4000 → 250 считываний/с.
1250 → 800 считываний/с.
- 5 Данное значение следующим образом идентифицирует кодирование данных считываний:
 0 — фактические (разность нулевого порядка) данные, используемые для данных ритма;
 1 — разности первого порядка, используемые для данных ритма;
 2 — разности второго порядка, используемые для данных ритма.
- 6 Данное значение следующим образом идентифицирует сжатие данных ритма:
 0 — бимодальное сжатие не используется;
 1 — бимодальное сжатие используется.

Примечание — Если используется бимодальное сжатие, то интервал времени защищенной области считываний соответствует указанному в 5.8.3, но AVM такой, как в байтах 1 и 2 из настоящего пункта. За пределами защищенной области, AVM и интервал времени считываний соответствуют байтам с 1 по 4 из настоящего пункта.

5.9.4 Данные этого раздела содержат длины байтов закодированных отведений, имеющие следующий формат:

Байты Содержание

- 1, 2 Число байтов (целое без знака) сжатых данных ритма для первого закодированного отведения.
 3, 4 Число байтов (целое без знака) сжатых данных ритма для второго закодированного отведения.

5.9.5 Затем следуют данные ритма. Если раздел 2 присутствует, то эти данные кодируются как последовательности кодов Хаффмана, взятых из раздела 2. Отведения кодируются в порядке, указанном в разделе 3. Если раздел 2 отсутствует, то данные ЭКГ (разностные или неразностные) должны иметь формат двухбайтовых целых чисел со знаком.

Могут быть применены другие форматы за счет предоставления «фиктивной» таблицы Хаффмана с одной структурой кода. Число битов префикса должен быть присвоен нуль. Число битов всего кода должно быть присвоено желаемое число битов в значении считывания.

5.9.6 Обзор данных этого раздела представлен на рисунке 9.

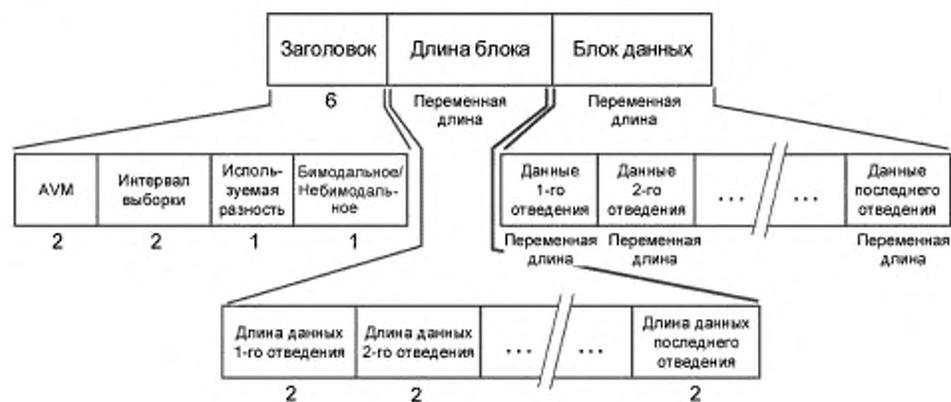


Рисунок 9 — Обзор структуры раздела данных ритма

5.10 Глобальные измерения. Раздел 7

5.10.1 Общие положения

Данный раздел содержит результаты глобальных измерений для каждого типа эталонного цикла либо для каждого QRS-комплекса в записи, а также список импульсов электрокардиостимулятора в записи. Если измерения предоставлены для каждого QRS-комплекса, то первый блок измерений должен содержать глобальные измерения цикла типа 0. Понятие «глобальный» относится к измерениям, снятым со всех отведений ЭКГ, но не обязательно представляющих более одного отдельного цикла. Обсуждение типов циклов см. в 5.1.11.

5.10.2 ID заголовка раздела

Если раздел присутствует, то должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

5.10.3 Данные глобальных измерений электрокардиограммы и данные измерений импульсов электрокардиостимулятора

5.10.3.1 Общие положения

Данные раздела содержат данные глобальных измерений ЭКГ и данные измерений пиковых потенциалов электрокардиостимулятора, если таковые присутствуют. Специальные коды, определенные в проекте CSE, зарезервированы для обозначения следующего:

- 29999 (десятичное) Измерение, не вычисляемое программой.
 29998 (десятичное) Измерение не получено в связи с отказом измерительной программы в обработке отведения.
 19999 (десятичное) Измерение не получено в связи с отсутствием зубца (например, P-зубца при предсердной фибрилляции).

Эти коды должны заменять результаты измерений в соответствующих случаях.

5.10.3.2 Данные глобальных измерений ЭКГ

Байты Содержание

- 1 Этот байт содержит число типов эталонных циклов либо число QRS-комплексов + 1 (сравните с байтами 1, 2 в 5.10.3.5). Данный байт ссылается на число хранящихся блоков измерений, в которых первый блок (байты с 7 по 22) всегда содержит измерения для эталонного цикла типа 0. Если данный байт содержит число типов эталонных циклов (т. е. не равен значению, содержащемуся в байтах 1, 2, описанных в 5.10.3.5, увеличенному на 1), то каждый следующий блок содержит глобальные измерения для каждого следующего типа эталонного цикла. Если этот байт содержит число QRS-комплексов + 1, то следующие блоки содержат измерения для каждого следующего индивидуального цикла.
- 2 Число импульсов электрокардиостимулятора, для которых передаются времена их появления.
- 3, 4 Средний интервал *RR* в миллисекундах по всем QRS-комплексам.
- 5, 6 Средний интервал *PP* в миллисекундах по всем QRS-комплексам.
- С 7 по 22 Измерения для эталонного цикла типа 0 (см. 5.10.4).
- С 23 по 38 Измерения для эталонного цикла типа 1 или для первого QRS-комплекса (см. байт 1) и т. д.

5.10.3.3 Данные измерений импульсов электрокардиостимулятора (если таковые имеются)

Байты Содержание

- 1, 2 Время первого импульса в миллисекундах от начала записи ритма (целое без знака).
- 3, 4 Амплитуда первого импульса в микровольтах ($1 \cdot 10^{-6}$ В) (целое со знаком).
- 5, 6 Время второго импульса в миллисекундах от начала записи ритма (целое без знака).
- 7, 8 Амплитуда второго импульса в микровольтах ($1 \cdot 10^{-6}$ В) (целое со знаком).
- и т. д.

Время и амплитуда этих импульсов электрокардиостимулятора представляются физической величиной со знаком в диапазонах от 0 до 65535 с и ± 32767 мВ соответственно.

Разрешение времени для импульсов электрокардиостимулятора должно быть меньше или равно 2 мс.

5.10.3.4 Информация об импульсах электрокардиостимулятора

Для каждого импульса, идентифицированного в 5.10.3.2, байт 2, а также в 5.10.3.3, этот раздел должен содержать один блок из шести байтов, предоставляющий дополнительную информацию об импульсе. Порядок блоков соответствует порядку импульсов, идентифицированных в 5.10.3.3.

Байты Содержание

- 1 Тип импульса электрокардиостимулятора #1:
- 0 Неизвестен.
 - 1 Импульс не вызывает ни P-зубец, ни QRS-комплекс.
 - 2 Импульс вызывает QRS-комплекс.
 - 3 Импульс вызывает P-зубец.
- С 4 по 127 Зарезервировано.
- С 128 по 254 Специфичны для производителя.
- 255 Анализ типа импульса не производился.
- 2 Источник импульса электрокардиостимулятора #1:
- 0 Неизвестен.
 - 1 Внутренний.
 - 2 Внешний.
- 3 по 255 Зарезервировано.

- 3, 4 Индекс QRS-комплекса, вызванного импульсом электрокардиостимулятора #1:
 0 Без ссылки.
 1 Ссылка на QRS #1 первого QRS-комплекса.
 2 Ссылка на QRS #2 второго QRS-комплекса и т. д.
- 5, 6 Ширина импульса в микросекундах — 0 означает «неизвестна» или «не вычислена» (целое без знака).

5.10.3.5 Информация о типе QRS-комплекса

Данный раздел идентифицирует тип эталонного цикла для каждого комплекса QRS в ЭКГ. Комплексы рассматриваются по порядку. Типы эталонного цикла нумеруются в соответствии с их появлением в разделе данных глобальных измерений ЭКГ (5.10.3.2).

Байты Содержание

- 1, 2 Число комплексов QRS.
 3 Тип эталонного цикла первого комплекса QRS (0 — ??).
 4 Тип эталонного цикла второго комплекса QRS (0 — ??)

и т. д.

5.10.3.6 Дополнительные глобальные измерения

Данный раздел предусмотрен для дополнительных измерений сверх тех, что определены в 5.10.3.2. Он размещен здесь, чтобы реализации предыдущих версий протокола оставались работающими.

Байты Содержание

- 1, 2 Желудочковый ритм, ударов в минуту (целое без знака).
 3, 4 Предсердный ритм, ударов в минуту (целое без знака).
 5, 6 Скорректированный сегмент QT (в миллисекундах) (целое без знака).
 7 Тип формулы, используемой для коррекции сердечного ритма:
 0 Неизвестен или не указан.
 1 Bazett.
 2 Hodges.
 С 3 по 127 Зарезервированы.
 С 128 по 254 Специфичны для производителя.
 255 Измерение недоступно.
- 8, 9 Число байтов в последующих отмеченных полях (ноль в случае отсутствия таких полей).
 С 10 по *** Тегированные поля, описанные в таблице 10. Допустимы теги от 0 до 254, тег 255 является завершающим. Каждое поле имеет как минимум идентификатор тега (1 байт) и спецификацию длины (1 байт). Длина поля с тегом 255 равна 0.

Таблица 10 — Тегированные поля

Тег	Длина	Значение (данные параметров)
0	5	<p>Дисперсия интервалов QT_e для всех отведений (двоичное) Интервалы QT, измеренные от начала QRS до окончания зубца T, в миллисекундах. В измерении используются все отведения ЭКГ. Допустимые значения от 0 до 254 (миллисекунды); 255 — измерение не проводилось.</p> <p>Байт Содержание</p> <p>1 Дисперсия = максимальный интервал QT_e — минимальный интервал QT_e. 2 Корригированная дисперсия сердечного ритма: макс. — мин. 3 Дисперсия = стандартное отклонение интервалов QT_e. 4 Корригированная дисперсия сердечного ритма: стандартное отклонение. 5 Формула коррекции сердечного ритма (допустимые значения см. в определении байта 7)</p>
1	5	<p>Дисперсия интервалов QT_a для всех отведений (двоичное) Интервалы QT, измеренные от начала QRS до вершины зубца T, в миллисекундах. В измерении используются все отведения ЭКГ. Допустимые значения от 0 до 254 (миллисекунды); 255 — измерение не предоставлено.</p> <p>Байт Содержание</p> <p>1 Дисперсия = максимальный интервал QT_a — минимальный интервал QT_a. 2 Корригированная дисперсия сердечного ритма: макс. — мин. 3 Дисперсия = стандартное отклонение интервалов QT_a. 4 Корригированная дисперсия сердечного ритма: стандартное отклонение. 5 Формула коррекции сердечного ритма (допустимые значения см. в определении байта 7)</p>

Окончание таблицы 10

Тег	Длина	Значение (данные параметров)												
2	5	<p>Прекардиальная дисперсия интервалов QTc (двоичное) Интервалы QT, измеренные от начала QRS до окончания зубца T, в миллисекундах. В измерении используются только прекардиальные отведения ЭКГ. Допустимые значения от 0 до 254 (миллисекунды); 255 — измерение не проводилось.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Байт</th> <th>Содержание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Дисперсия = максимальный интервал QTc — минимальный интервал QTc.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Корригированная дисперсия сердечного ритма: макс. — мин.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Дисперсия = стандартное отклонение интервалов QTc.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Корригированная дисперсия сердечного ритма: стандартное отклонение.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Формула коррекции сердечного ритма (допустимые значения см. в определении байта 7)</td> </tr> </tbody> </table>	Байт	Содержание	1	Дисперсия = максимальный интервал QTc — минимальный интервал QTc.	2	Корригированная дисперсия сердечного ритма: макс. — мин.	3	Дисперсия = стандартное отклонение интервалов QTc.	4	Корригированная дисперсия сердечного ритма: стандартное отклонение.	5	Формула коррекции сердечного ритма (допустимые значения см. в определении байта 7)
Байт	Содержание													
1	Дисперсия = максимальный интервал QTc — минимальный интервал QTc.													
2	Корригированная дисперсия сердечного ритма: макс. — мин.													
3	Дисперсия = стандартное отклонение интервалов QTc.													
4	Корригированная дисперсия сердечного ритма: стандартное отклонение.													
5	Формула коррекции сердечного ритма (допустимые значения см. в определении байта 7)													
3	5	<p>Прекардиальная дисперсия интервалов QTa (двоичное) Интервалы QT, измеренные от начала QRS до вершины зубца T, в миллисекундах. В измерении используются только прекардиальные отведения ЭКГ. Допустимые значения от 0 до 254 (миллисекунды); 255 — измерение не предоставлено.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Байт</th> <th>Содержание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Дисперсия = максимальный интервал QTa — минимальный интервал QTa.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Корригированная дисперсия сердечного ритма: макс. — мин.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Дисперсия = стандартное отклонение интервалов QTa.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Корригированная дисперсия сердечного ритма: стандартное отклонение.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Формула коррекции сердечного ритма (допустимые значения см. в определении байта 7)</td> </tr> </tbody> </table>	Байт	Содержание	1	Дисперсия = максимальный интервал QTa — минимальный интервал QTa.	2	Корригированная дисперсия сердечного ритма: макс. — мин.	3	Дисперсия = стандартное отклонение интервалов QTa.	4	Корригированная дисперсия сердечного ритма: стандартное отклонение.	5	Формула коррекции сердечного ритма (допустимые значения см. в определении байта 7)
Байт	Содержание													
1	Дисперсия = максимальный интервал QTa — минимальный интервал QTa.													
2	Корригированная дисперсия сердечного ритма: макс. — мин.													
3	Дисперсия = стандартное отклонение интервалов QTa.													
4	Корригированная дисперсия сердечного ритма: стандартное отклонение.													
5	Формула коррекции сердечного ритма (допустимые значения см. в определении байта 7)													
C 4 по 254	(отсутствует)	Зарезервированы												
255	0	Отсутствует (окончание раздела)												

5.10.4 Формат блока измерений для каждого типа эталонного цикла или для каждого отдельного комплекса QRS

Байты	Содержание
1, 2	Начало P.
3, 4	Завершение P.
5, 6	Начало QRS.
7, 8	Завершение QRS.
9, 10	Завершение T.
11, 12	Ось P во фронтальной плоскости (в угловых градусах, если не определена, то 999).
13, 14	Ось QRS во фронтальной плоскости (в угловых градусах, если не определена, то 999).
15, 16	Ось T во фронтальной плоскости (в угловых градусах, если не определена, то 999).

Примечания

1 Если блок измерений содержит данные эталонного цикла некоторого типа, то времена начала и окончания задаются в миллисекундах от начала эталонного цикла. Если блок измерений содержит данные конкретного цикла, то времена начала и окончания задаются в миллисекундах от начала записи ЭКГ. Длительности зубцов и интервалов могут быть вычислены вычитанием времени начала зубца или интервала из времени окончания.

2 Для осей (P, QRS, T) на фронтальной плоскости используется соглашение, показанное на рисунке 10.



Рисунок 10 — Определение угла

5.10.5 Блок глобальных измерений, специфичный для производителя

Блок переменной длины, содержащий глобальные измерения, специфичные для производителя, может быть добавлен в данный раздел после информации об импульсах электрокардиостимулятора.

Начало блока, специфичного для производителя (считая от начала ID заголовка раздела), должно определяться по информации, приведенной в данных глобальных измерений ЭКГ. Например, если блоки измерений содержат глобальные измерения для каждого типа эталонного цикла, то начало блока, специфичного для производителя, будет равно $16 \text{ (см. 5.2.7)} + 6 + (\text{число типов эталонного цикла, умноженное на } 16) + (\text{число импульсов электрокардиостимулятора, умноженное на } 4) + (\text{число импульсов электрокардиостимулятора, умноженное на } 6) + (2 + \text{число QRS-комплексов}) + (9 + \text{число байтов в тегированных глобальных измерениях}) + 1$. Конец блока должен предоставляться в ID заголовка раздела с помощью общей длины раздела, включая ID заголовка раздела (см. 5.2.7).

5.10.6 Структура данных глобальных измерений

Структура данных раздела 7, содержащего глобальные измерения, представлена на рисунке 11.

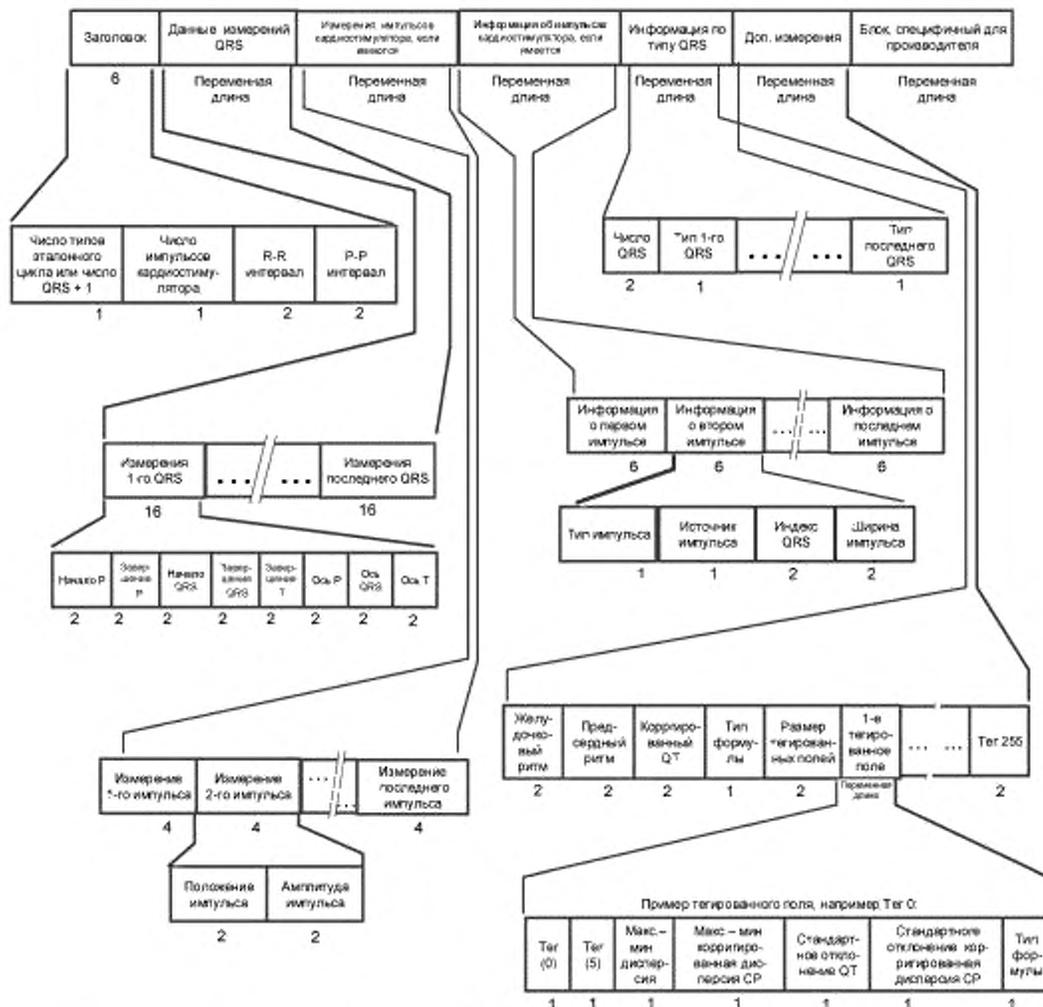


Рисунок 11 — Структура данных раздела глобальных измерений

5.11 Хранение полного текста интерпретирующих утверждений. Раздел 8

5.11.1 Данный раздел содержит текстовую версию самой поздней диагностической интерпретации ЭКГ.

5.11.2 Если раздел присутствует, то должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

5.11.3 Данные этого раздела включают заголовок, за которым следует несколько утверждений.

5.11.4 Заголовок имеет следующую структуру:

Байты	Содержание
1	Двоичное. Подтвержденный/неподтвержденный отчет: Значение Тип 0 Исходные данные (без расшифровки). 1 Подтвержденный отчет. 2 Расшифровка не подтверждена.
2, 3	Двоичное. Год (полная целочисленная нотация, например, 1990).
4	Двоичное. Месяц (диапазон с 01 по 12; 01 = Январь).
5	Двоичное. День (диапазон с 01 по 31).
6	Двоичное. Часы (диапазон от 00 до 23).
7	Двоичное. Минуты (диапазон от 00 до 59).
8	Двоичное. Секунды (диапазон от 00 до 59).
9	Двоичное. Число утверждений в данном разделе.

5.11.5 Данные утверждений

Байты	Содержание
1	Двоичное. Порядковый номер утверждения, начиная с 01.
2, 3	Двоичное. Длина поля утверждения (число байтов в утверждении, начиная с первого байта и включая завершающий байт NULL).
С 4 по ***	Тело утверждения: текст, завершающийся байтом NULL.

5.11.6 В утверждениях не допускаются никакие коды, если они не сопровождаются текстовым описанием.

5.11.7 Структура раздела представлена на рисунке 12.

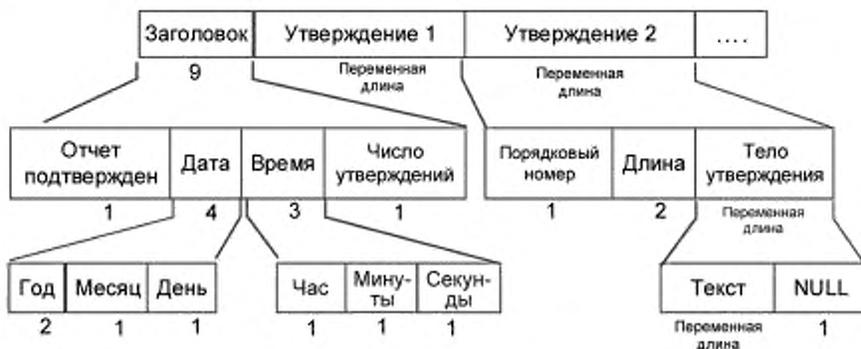


Рисунок 12 — Структура раздела 8

5.12 Хранение интерпретирующих утверждений, специфичных для производителя, и данных, относящихся к цепочке расшифровок. Раздел 9

5.12.1 Данный раздел зарезервирован для диагностических описаний, специфичных для производителя анализирующего устройства, и интерпретируемых цепочек расшифровок. Источник анализирующего устройства, фамилия и имя проводящего расшифровку врача (или наименование устройства) определены в «Разделе заголовка» (раздел 1).

5.12.2 Если раздел присутствует, то он должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

5.12.3 Структура и формат данных этого раздела специфичны для производителя.

5.13 Блок измерения отведений. Раздел 10

5.13.1 Данный раздел содержит отдельные измерения каждого записанного отведения. Обязательные измерения и их формат приведены ниже. В нем предусмотрены область, специфичная для производителя, а также управляющие коды особых условий.

5.13.2 Если раздел присутствует, то он должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

5.13.3 Данные раздела измерения отведений должны состоять из одной записи для каждого измеряемого отведения. Каждая запись должна состоять из четырех полей:

- a) идентификатор отведения (двоичный, два байта). Схему нумерации отведения см. в 5.6.4, байт 9;
- b) длина записи в байтах (целое без знака), исключая байты с 1 по 4 (двоичное; 2 байта);
- c) до 50 базовых измерений (целые со знаком) (двоичные поля; 2 байта каждое);
- d) область измерений, специфичная для производителя, начиная с байта 105 и до конца (двоичные). Организация или формат этой области настоящим документом не регламентируются.

5.13.4 Специальные коды, определенные в проекте CSE, зарезервированы для обозначения следующего:

- | | |
|--------------------|--|
| 29999 (десятичное) | Измерение, не вычисляемое программой. |
| 29998 (десятичное) | Измерение не получено в связи с отказом измерительной программы в обработке отведения. |
| 19999 (десятичное) | Измерение не получено в связи с отсутствием зубца (например, P-зубца при предсердной фибрилляции). |

Заголовок данных этого раздела содержит число отведений, для которых передается блок измерений (двоичное, 2 байта). За ним следуют два байта информации, специфичной для производителя.

5.13.5 Каждый блок измерений отведения должен иметь следующий состав:

Байты	Содержание
1, 2	Идентификатор отведения.
3, 4	Длина записи.
5, 6	Длительность P, мс (общая длительность, включая компоненты P + и P –).
7, 8	Интервал PR, мс.
9, 10	Длительность QRS-комплекса, мс.
11, 12	Интервал QT, мс.
13, 14	Длительность Q, мс.
15, 16	Длительность R, мс.
17, 18	Длительность S, мс.
19, 20	Длительность R', мс.
21, 22	Длительность S', мс.
23, 24	Амплитуда Q, мкВ.
25, 26	Амплитуда R, мкВ.
27, 28	Амплитуда S, мкВ.
29, 30	Амплитуда R', мкВ.
31, 32	Амплитуда S', мкВ.
33, 34	Амплитуда точки J, мкВ (амплитуда точки J = амплитуда окончания QRS).
35, 36	Амплитуда P(+), мкВ.
37, 38	Амплитуда P(-), мкВ.
39, 40	Амплитуда T(+), мкВ.
41, 42	Амплитуда T(-), мкВ.
43, 44	Наклон ST сегмента, мкВ/с.
45, 46	Описание морфологии зубца P, в соответствии с приведенным ниже определением.
47, 48	Описание морфологии зубца T, в соответствии с приведенным ниже определением.
49, 50	Изоэлектрический сегмент перед началом QRS, в мс (сегмент I).
51, 52	Изоэлектрический сегмент после окончания QRS, в мс (сегмент K).

Примечание — Определение изоэлектрических сегментов I и K см. в European Heart Journal 1985, том 6, стр. 815—825. Кратко говоря, «I» является интервалом между глобальным началом QRS, полученным из всех одновременно записанных отведений, и началом QRS в конкретном отведении. Аналогично, «K» является временем между окончанием QRS в определенном отведении и глобальным окончанием QRS.

- | | |
|--------|--|
| 53, 54 | Внутреннее отклонение электрокардиограммы, в мс. |
| 55, 56 | Код качества, отражающий условия записи ЭКГ, в соответствии с приведенным ниже определением. |
| 57, 58 | Амплитуда ST в точке J плюс 20 мс. |
| 59, 60 | Амплитуда ST в точке J плюс 60 мс. |
| 61, 62 | Амплитуда ST в точке J плюс 80 мс. |
| 63, 64 | Амплитуда ST в точке J плюс 1/16 среднего интервала R—R. |

- 65, 66 Амплитуда ST в точке J плюс 1/8 среднего интервала R—R.
 67, 104 Зарезервированы для будущего использования.
 С 105 по *** Блок результатов измерений, специфичных для производителя.

Все измерения должны быть выражены целочисленными значениями со знаком. Амплитуды зубцов Q, S, S', T(-) и P(-) должны быть выражены отрицательными целочисленными значениями. То же относится к амплитуде точек J, J + 20, J + 60 и J + 80, когда они отрицательные. Обратите внимание, что точка J (J) совпадает с окончанием комплекса QRS.

Байты с 67 по 104 должны иметь значение 0 и передаваться, если раздел содержит блок, специфичный для производителя.

5.13.5.1 Коды описания морфологии P и T (байты с 45 по 48) определены следующим образом:

Значение	Содержание
0	Неизвестно.
1	Положительный 
2	Отрицательный 
3	Положительный/отрицательный 
4	Отрицательный/положительный 
5	Положительный/отрицательный/положительный 
6	Отрицательное/положительное/отрицательное 
7	Зазубренный в форме M 
8	Зазубренный в форме W 

5.13.5.2 Код качества (байты 55, 56) определен следующим образом:

Два двоичных байта на отведение, состоящие из 8 двухбитовых полей. Каждое поле характеризует уровень шума одного из четырех классов.

Младший значащий бит байта 55 определен как бит 0. Старший значащий бит байта 56 определен как бит 15.

Биты	Содержание	Уровень	Класс
0, 1	Шум сети переменного тока (основной).	0	Отсутствует/нет.
2, 3	Выход за пределы.	1	Умеренный/да.
4, 5	Дрейф.	2	Существенный.
6, 7	Дрожание или мышечный артефакт.	3	Неизвестно.
8, 9	Всплески или внезапные скачки.		
10, 11	Электрод отсутствует или отключен.		
12, 13	Электрокардиостимулятор.		
14, 15	Переставленное отведение.		

5.13.5.3 Структура данных этого раздела представлена на рисунке 13.

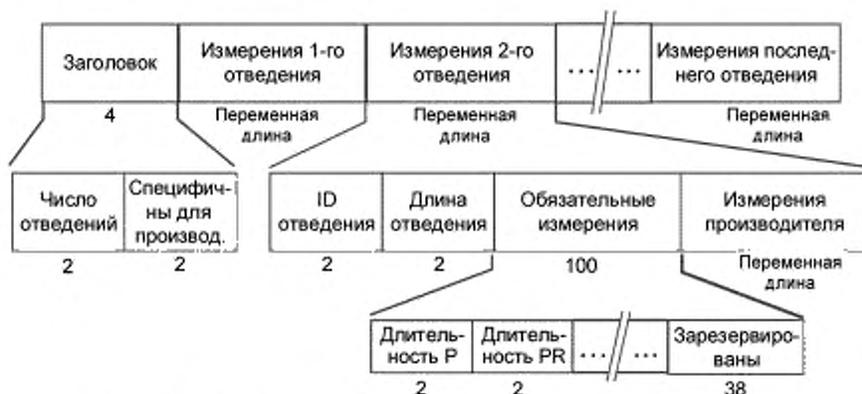


Рисунок 13 — Структура данных раздела блока измерений отведений

5.14 Хранение универсальных кодов интерпретирующих утверждений. Раздел 11

5.14.1 Настоящий раздел содержит данные самой последней интерпретации и расшифровки, закодированные в соответствии с Универсальными кодами утверждений и правилами кодирования,

определенными в приложении F. Данные, содержащиеся в этом разделе, должны быть согласованы с данными, передаваемыми в разделах 8 и 9.

5.14.2 Если этот раздел присутствует, то он должен начинаться с «ID заголовка раздела» в соответствии с 5.2.7.

5.14.3 Определение структуры и формата

Данные должны храниться по принципу «утверждение за утверждением». Существует три возможных типа утверждений:

- 1) универсальные коды интерпретации (в соответствии с приложением F);
- 2) полный текст (как используется в разделе 8);
- 3) логика утверждений (идентифицирующая логические связи между утверждениями).

Для хранения трех типов утверждений определены три отдельных поля утверждений.

Только одному полю типа «Логика утверждений» разрешается идентифицировать логические связи между утверждениями других типов. Если раздел не содержит поле типа «Логика утверждений», то предполагается, что все утверждения равным образом действительны и не имеют «специальных» связей друг с другом помимо того, что объявлено в утверждении. Число полей типов «Универсальные коды интерпретации» и «Полный текст» не ограничивается.

5.14.4 Организация данных этого раздела представлена в 5.14.5, а ее объяснение дано ниже.

5.14.4.1 Заголовок

Байт	Содержание
1	Двоичное. Подтвержденный/неподтвержденный отчет. Значение Тип 0 Исходные данные (без расшифровки). 1 Подтвержденный отчет. 2 Расшифровка не подтверждена.
2, 3	Двоичное. Год (полная целочисленная нотация, например, 1990).
4	Двоичное. Месяц (диапазон с 01 по 12; 01 = Январь).
5	Двоичное. День (диапазон с 01 по 31).
6	Двоичное. Часы (диапазон от 00 до 23).
7	Двоичное. Минуты (диапазон от 00 до 59).
8	Двоичное. Секунды (диапазон от 00 до 59).
9	Двоичное. Число утверждений в данном разделе.

5.14.4.2 Данные утверждения

Байт	Содержание
1	Двоичное. Порядковый номер утверждения, начиная с 1. Каждому утверждению присвоен порядковый номер, чтобы их можно было легко связать с помощью логических операторов типа 3.
2, 3	Двоичное. Длина поля утверждения (число байтов в утверждении, начиная с первого байта и включая завершающий байт NULL).
С 4 по ***	Поле утверждения: Байт Содержание 1 Двоичное. Тип поля утверждения: Значение Тип 1 Тип кодированного утверждения, взятый из Универсальных кодов интерпретации. 2 Тип полного текста, как используется в разделе 8. 3 Тип логики утверждения в соответствии с приведенным ниже описанием. Со 2 по *** Данные, зависящие от типа поля. Завершаются значением NULL (0).

5.14.4.3 Тип утверждения

Тип 1 Данный тип должен содержать одно кодированное утверждение, за которым необязательно следует один или несколько модификаторов в соответствии с Универсальными кодами интерпретации. Каждый элемент (кодированное утверждение или модификатор) должен занимать один блок данных, завершающийся значением NULL (0). Блоки данных имеют переменную длину, и число блоков не ограничено. Единственным ограничением является суммарная длина всех блоков, которая не должна превышать 65 535 байтов.

Тип 2 Данный тип имеет единственный блок данных, содержащий только текстовые символы, и завершается значением NULL (0).

Тип 3 Данный тип имеет единственный блок данных, содержащий только текстовые символы, и завершается значением NULL (0). Содержание данного поля идентифицируют логические связи между утверждениями с помощью логических операторов, применяемых к утверждениям, идентифицируемым своими порядковыми номерами.

Пример — выражение «(1 + 2);3», где «+» = «ИЛИ», «;» = «И», а скобки «(...)» указывают приоритет, читается как «(утверждение № 1 ИЛИ утверждение № 2) И утверждение № 3».

5.14.5 Структура данных раздела 11

См. рисунок 14.

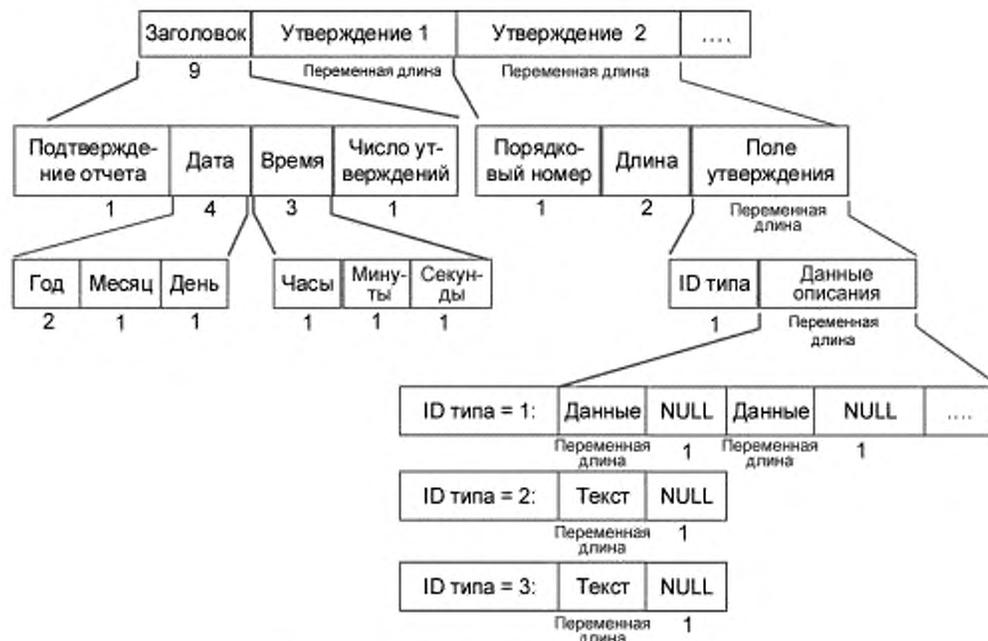


Рисунок 14 — Структура данных раздела 11

6 Минимальные требования к кодированию и сжатию данных сигнала электрокардиограммы

6.1 Область применения

Как описано в разделе 1, ЭКГ применяется в повседневной клинической практике, когда пациент находится в спокойном состоянии, получает дозированные физические нагрузки, ведет обычную повседневную деятельность в течение длительного времени, например при амбулаторном мониторинге (так называемым холтеровским мониторингом), или находится в палате интенсивной терапии для контроля нарушения сердечного ритма. Рекомендации по сжатию данных записей ЭКГ на протяжении длительных периодов времени были исключены из настоящего стандарта. Спецификации кодирования и сжатия, описанные в настоящем стандарте, ограничиваются обычным снятием электрокардиограммы пациента в состоянии покоя.

6.2 Введение

Записи ЭКГ в состоянии покоя, как правило, имеют длину 10 сек. При оцифровке этих данных с точностью, рекомендованной Международным комитетом по электрокардиографии организация АНА,

AAMI, CSE и другими, а именно 500 считываний/с и максимум 5 мкВ/LSB для каждого отведения ЭКГ, в секунду формируется 1000 байтов данных, в которых на каждое считывание отводится 16 битов. Таким образом, данные стандартной 10-секундной ЭКГ в 12 отведениях занимают 80 000 байтов (в этом случае избыточность отведений от конечностей, которые можно реконструировать из отведений I и II, уже была устранена).

Хотя эти объемы данных существенно меньше тех, что возникают при медицинской визуализации, электрокардиография дает большое количество цифровых данных по сравнению с другими медицинскими данными, например, с историей болезни пациента, кодами диагнозов и биомедицинскими лабораторными данными. Хотя современные технологии значительно повысили доступный объем хранения данных и скорость их передачи, снижение объема данных по-прежнему остается желательным (и даже экономически необходимым), в особенности при передаче этих данных по обычной телефонной сети.

В действительности существует два веских основания сжатия цифровых данных ЭКГ:

1) снизить требования к (магнитному) хранилищу медицинских баз данных и больничных информационных систем;

2) сократить время (и затраты на телефонную связь) передачи данных ЭКГ.

Хотя семантика диагностической информации ЭКГ теоретически может храниться в нескольких байтах, постоянно необходимы повторные анализы сделанных записей и сравнение новых записей с предыдущими, в особенности для кардиологических пациентов. Небольшие изменения морфологии ЭКГ могут служить чувствительными индикаторами протекания заболевания. Их можно распознать с помощью сравнения последовательного ряда записей ЭКГ, но если вместо записей хранятся только текстовые результаты анализа основных особенностей ЭКГ, эта возможность может быть потеряна.

За последние десятилетия были разработаны разные алгоритмы сжатия ЭКГ. Сжатие ЭКГ, за исключением специфичных ситуаций, когда применялось только сокращение избыточности, всегда сопровождалось некоторым ухудшением исходной записи. Так как стандарты точности, форматов данных или методов сжатия отсутствуют, то сжатые данные ЭКГ могут подвергаться повторному анализу и сравнению только в рамках систем обработки одного производителя. Также невозможен обмен сжатыми данными между системами разных производителей. Кроме того, отсутствует количественная информация о ухудшении данных, вызванных процедурами сжатия и реконструкции сжатых данных.

Главной целью и достижением, достигнутым в ходе осуществления направления Workpackage 2 в рамках Проекта SCP-ECG предварительных программ AIM (1989—1990) Европейского сообщества, было определение и согласование пределов точности и спецификаций сжатия данных ЭКГ, а также определение такого кодирования данных, при котором сжатые ЭКГ можно было бы передавать и повторно анализировать в системах разных производителей. Рекомендации, полученные в результате реализации этого направления, сформировали основу настоящего стандарта.

6.3 Методология сжатия электрокардиограммы

Можно идентифицировать следующие принципы, применяемые к сжатию данных ЭКГ:

1) сокращение избыточности в рамках цифровой записи (обратимое сжатие данных);

2) ограничение полосы пропускания и снижение частоты считываний;

3) сокращение информации с помощью необратимого сжатия данных, при котором могут задаваться, а могут и не задаваться пределы точности.

В ходе проекта SCP-ECG был подготовлен обзор различных алгоритмов, разработанных за последние 20 лет, для сжатия ЭКГ, снятых у пациента в состоянии покоя, а также холтеровских ЭКГ. Важный вклад в сжатие данных ЭКГ можно найти в работах, приведенных в библиографии.

Ниже приведены основные заключения, сделанные в этом обзоре:

1) сокращение избыточности является единственным методом избежать ухудшения сигнала. Сокращение избыточности приводит к коэффициентам сжатия в диапазоне от 2 до 5;

2) другие схемы сжатия позволяют получить коэффициент сжатия от 5 до 12;

3) меры искажения реконструкции сигнала, как правило, приводятся в единицах среднеквадратичной амплитуды RMS (root mean square). Однако показатели RMS являются усредненными и даже при малых величинах RMS может возникнуть непредвиденно большое число абсолютных искажений важных частей сигнала;

4) проверка схем сжатия всегда должна включать в себя анализ ошибок в абсолютной амплитуде, так как они могут превышать показатели RMS в 10—20 раз;

5) применялись также различные преобразования сигнала (дискретное преобразование Фурье, преобразование Карунена — Лозва (Karhunen — Loeve), преобразование Уолша). Полученный диапазон коэффициентов сжатия составил от 6 до 12. Однако для этих методов точность восстановления задается только в RMS. Опубликованные результаты указывают на то, что сжатие с помощью таких преобразований может использоваться для сокращения данных одного типичного цикла ЭКГ, но не для сжатия всей записи ЭКГ;

6) измеримость минимальных зубцов и воспроизводимость зазубрин/волн соединения определяет возможное сжатие ЭКГ. В настоящий момент согласно рекомендациям CSE требуется минимальная измеримость элементов до 20 мкВ/6 мс. В отчетах отмечались клинически значимые зазубрины длиной 4 мс. Однако в результате недавних экспериментов требования к минимальной длительности элементов сигнала по практическим причинам были доведены до 10 мс. При частоте 500 считываний/с более короткие элементы в действительности не могут быть надежно измерены;

7) стандартизация сжатия данных ЭКГ требует:

а) гармонизации спецификаций аппаратного обеспечения, шума усилителя, диапазона входного напряжения, точности аналого-цифрового преобразования, значения LSB и т. п.;

б) определения пределов воспроизводимости и максимальной устойчивости к ошибкам.

6.4 Основные результаты исследований по сжатию данных электрокардиограммы в проекте SCP-ECG

6.4.1 Предложенное решение по сжатию

За исключением сокращения избыточности, любое сжатие приводит к сокращению разрешения сигнала. Тем не менее, с практической точки зрения, не каждый мкВ разрешения и не каждый бит разрешения являются значимыми. Более важно то, что измерения, полученные при адекватных параметрах разрешения времени и амплитуды, соответствуют друг другу перед сжатием и после него.

Поэтому исследователями некоторых компаний была разработана схема сжатия, в которой эталонный цикл обрабатывается с помощью исходных данных и хранится или передается таким образом, чтобы повторная обработка обеспечила такие же результаты измерения, как и прежде. Этого можно достигнуть с помощью:

а) сжатия, использующего только сокращение избыточности;

б) передачей указателей (точек идентификации зубцов), позволяющих повторное измерение, на основании тех же ссылок.

За исключением эталонного цикла остаточная запись хранится и передается. Остаточная запись формируется путем вычитания эталонного цикла из исходной записи сигнала ЭКГ в каждой локации цикла. Остаточная запись пропускается через низкочастотный фильтр, обрезается, и частота считываний сокращается. Из этой записи первые или вторые разности амплитуды кодируются методом Хаффмана и хранятся или передаются. Воссоздание записи ЭКГ для просмотра возможно с помощью добавления эталонного цикла в остаточную запись в соответствующих местах циклов. Данный метод позволяет получить общие коэффициенты сжатия до 20 раз.

Подробный анализ данной схемы сжатия в проекте SCP-ECG показал, что в реконструированной записи могут возникать относительно большие ошибки в QRS-комплексе. Эти ошибки возникают в результате низкочастотной фильтрации. В частности, разделы QRS в остаточной записи содержат высокочастотные компоненты, которые удаляются после низкочастотной фильтрации, округления и сокращения частоты считываний, осуществляемых методами, предложенными и используемыми в некоторых коммерческих программах.

Поэтому в проекте SCP-ECG был разработан метод, применяющий, по сути, ту же самую схему сжатия, но при этом защищающий раздел QRS от низкочастотной фильтрации и сокращения частоты считываний. Таким образом, сохраняются все детали комплекса QRS-T, на основании которых должен быть выведен основной морфологический диагноз. В остаточной записи, необходимой для реконструкции записи ЭКГ, на основании которой должен быть сделан диагноз ритма, при применении схемы сжатия, разработанной в SCP-ECG, могут быть обнаружены только едва заметные человеческому глазу изменения. Эти изменения не влияют на диагноз ритма исследуемых случаев.

Основным преимуществом новой схемы сжатия является защита существенных деталей чувствительных разделов данных QRS и возможность значительного улучшения общей точности. Подробное описание методологии приведено в приложении С вместе с числовыми примерами.

6.4.2 Методология тестирования предложенных решений

Для исследования поведения этого и других разных алгоритмов сжатия первым использовался набор (тестовый набор номер 1), состоящий из 11 ЭКГ, взятых из базы данных CSE, предназначенной

для оценки точности распознавания зубцов. Эти ЭКГ были выбраны в соответствии с ритмом (синусовый ритм, фибрилляция предсердий, трепетание предсердий), наличием «нормальных» циклов и экстрасистол, с различной морфологией QRS, включая обычный инфаркт, инфаркт миокарда, гипертрофию левого желудочка и другие. Они представляют различные типы сигналов ЭКГ и содержат низкие и высокие уровни низкой частоты (изолинии) и высокочастотного шума (частота сканирования, мышечный тремор). Основные наблюдения могут быть произведены на основании этого набора данных. Для получения статистически значимых данных был разработан второй набор (тестовый набор номер 2), состоящий из 89 + 19 ЭКГ из диагностических исследований CSE. Эти данные были выбраны в соответствии с распределением амплитуд, которые должны быть кратными 1 мкВ. Они также состоят из случаев с нормальным и нарушенным ритмом, экстрасистолами, а также с нормальной и патологической морфологией QRS.

В некоторых ситуациях полезно использовать искусственные сигналы (например, симулирующих трепетание предсердий) и нескольких искусственных ЭКГ с нормальной морфологией P-QRS-T. Во избежание неправдоподобных результатов, связанных с краями сигнала и т. п., было предусмотрено, что первые и вторые производные всех отведений являются непрерывными. Преимущество синтезированных сигналов заключается в том, что истинные амплитуды и интервалы известны, а результаты экспериментов сжатия не скрываются за последствиями удаления шума или его воспроизведения.

В приложении С представлен набор тестовых ЭКГ, с помощью которого в соответствии с требованиями, описанными в настоящем стандарте, может быть выполнено тестирование соответствия и оценивание на наличие ошибок в алгоритмах сжатия ЭКГ.

6.5 Минимальные требования к сжатию данных электрокардиограммы

6.5.1 Общие положения

На основании результатов исследований, проведенных в рамках проекта SCP-ECG, в качестве стандарта для цифрового кодирования и сжатия ЭКГ были выбраны описанные ниже дискретизация и пределы искажений.

6.5.2 Категории схем сжатия

Можно идентифицировать три основные категории сжатия информации ЭКГ:

- категория А — из исходной записи ЭКГ должен храниться или передаваться только набор параметров измерений и диагностических утверждений;
- категория В — хранится/передается набор измерений, диагностических утверждений и эталонный цикл, а также остаточная запись, из которых может быть реконструирована исходная запись ЭКГ с определенными искажениями;
- категория С — хранится/передается набор измерений и диагностических утверждений, а также сжатая исходная ЭКГ с сокращенной избыточностью. Кроме этого, эталонный цикл (в качестве результата обработки) также может быть сжат, храниться или передаваться.

6.5.3 Минимальные требования к кодированию и сжатию электрокардиограммы

6.5.3.1 Способ сжатия данных оставлен на усмотрение производителей. Однако в том случае, когда применяется вычитание эталонного цикла, должны передаваться эталонный цикл типа 0 и остаточная запись. Ошибки реконструкции в единицах RMS и в абсолютных величинах должны верифицироваться на тестовом наборе SCP. Меры искажений должны вычисляться от начала первого вычитания до конца последнего вычитания. Для сжатия, при котором только исключается избыточность, ошибки реконструкции (в единицах RMS и абсолютных величинах, за исключением ошибок дискретизации) должны равняться 0 при оцифровке с частотой 500 считываний/с и дискретизацией 5 мкВ/LSB.

6.5.3.2 Если для сжатия данных используется вычитание эталонного цикла, то все отведения записи ЭКГ должны записываться одновременно.

6.5.3.3 Дискретизация: $SR \geq 500$ считываний/с; $LSB \leq 5$ мкВ.

6.5.3.4 Эталонный цикл: $SR \geq 500$ считываний/с; $LSB \leq 5$ мкВ.

6.5.3.5 Остаточная запись: ошибка усечения $\leq \pm 15$ мкВ.

6.5.3.6 Остаточная запись: интервал между считываниями ≤ 8 мс.

6.5.3.7 Ошибка реконструкции: $RMS \leq 10$ мкВ.

6.5.3.8 Абсолютная ошибка: ≤ 100 мкВ в одном считывании за пределами P-QRS-T.

6.5.3.9 Абсолютная ошибка внутри QRS: ≤ 15 мкВ в отдельном считывании.

Приложение А
(обязательное)

**Кодирование алфавитно-цифровых данных электрокардиограммы
в многоязычной среде**

А.1 Общие положения

В настоящем приложении рассмотрен метод кодирования текстовых полей в SCP-ECG. Он взят из стандартов ИСО/МЭК, описывающих использование нескольких наборов символов. Для лучшего понимания настоящего приложения необходимо ознакомиться со структурой и правилами расширения 8-битового кода ИСО, представленных в ИСО/МЭК 4873 и ИСО/МЭК 2022.

Несколько наборов символов требуется не только в случае японского языка, но также для европейских языков, использующих символы, не входящие в ASCII (например, «ä» в немецком языке, «ç» во французском, «å» в шведском и т. п.). Таким образом, использование расширенных наборов символов должно обеспечить международное принятие протокола SCP-ECG.

Строка символов, включающая неизвестные наборы символов, может привести к серьезным проблемам в идентификации пациентов в некоторых машинах. Поэтому в данном приложении должен быть также описан метод обработки не поддерживаемых наборов символов.

А.2 Область применения

К полям протокола SCP-ECG, перечисленным в таблице А.1, должно быть применено кодирование текста.

Таблица А.1 — Поля протокола SCP-ECG

Раздел	Тег	Содержание
1	0	Фамилия
1	1	Имя
1	2	Идентификатор пациента
1	3	Вторая фамилия
1	10	Лекарственные средства
1	13	Диагноз или указание направления к специалисту
1	14	Идентификационный номер снимающего устройства
1	15	Идентификационный номер анализирующего устройства
1	16	Описание организации, в которой выполнено снятие
1	17	Описание организации, в которой выполнен анализ
1	18	Описание отделения, в котором выполнено снятие
1	19	Описание отделения, в котором выполнен анализ
1	20	Направивший врач
1	21	Самый последний подтверждающий врач
1	22	Описание лаборанта
1	23	Описание помещения
1	30	Поле свободного текста
1	31	Порядковый номер ЭКГ

Окончание таблицы А.1

Раздел	Тег	Содержание
1	32	Коды диагнозов в истории
1	33	Код конфигурации электрода
1	34	Часовой пояс
1	35	Анамнез заболевания свободным текстом
8 + 11	—	Диагностический отчет свободным текстом
9	—	Информация отчета, специфичная для производителя

Данное кодирование предназначено в качестве формата обмена, а не внутреннего представления. Ожидается (но не требуется), что каждая компьютерная система ЭКГ должна преобразовывать данный формат в некоторое внутреннее представление для обработки и визуализации, а для обмена данными преобразовывать внутреннее представление в данный формат.

А.3 Ссылки и определения

А.3.1 Ссылки

См. раздел 2, а также следующие источники:

ИСО/МЭК 2375, Информационные технологии. Процедура регистрации управляющих последовательностей и наборов кодированных символов (ISO/IEC 2375, Information technology — Procedure for registration of escape sequences and coded character sets)

ИСО/МЭК 6429:1992, Информационные технологии. Функции управления для наборов кодированных символов (ISO/IEC 6429:1992, Information technology — Control functions for coded character sets)

ИСО/МЭК 8859-2:1999, Информационные технологии. 8-битовые однобайтовые наборы кодированных графических знаков. Часть 2. Латинский алфавит № 2 (ISO/IEC 8859-2:1999, Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 2: Latin alphabet No. 2)

JIS X 0202, Методики расширения кода для использования с кодом для обмена информацией: Японский промышленный стандарт (JIS) [JIS X 0202, Code Extension Techniques for Use with the Code for Information Interchange: Japanese Industrial Standard (JIS)]

SCHEIFLER R. W. Compound Text Encoding version 1.1, MIT X Consortium Standard

А.3.2 Термины и определения

Для целей настоящего приложения следующие определения были взяты из ИСО/МЭК 4873 и JIS C 6228, который 1 марта 1987 г. был переименован в JIS X 0202.

В соответствии с настоящим стандартом набор символов Latin-1, определенный в ИСО/МЭК 8859-1, должен использоваться по умолчанию.

А.3.2.1 кодированный набор символов, код (coded character set, code): Набор однозначных правил, определяющий набор символов и связь один-к-одному между каждым символом набора и его кодированным представлением с помощью одного или нескольких сочетаний битов.

А.3.2.2 управляющий символ (control character): Функция управления, кодированное представление которой состоит из комбинации значений одного бита.

А.3.2.3 графический символ (graphic character): Символ, не являющийся функцией управления, обладающий визуальным представлением, как правило, написанным от руки, напечатанным или отображенным, который также обладает кодированным представлением, состоящим из одной или нескольких комбинаций битов.

А.3.2.4 функция управления (control function): Действие, влияющее на запись, обработку, передачу или интерпретацию данных, которое также обладает кодированным представлением, состоящим из одной или нескольких комбинаций битов.

А.3.2.5 спецификация формата (format effector): Символ, управляющий организацией и расположением информации в устройствах визуализации символов, например, устройствах печати и отображения.

А.3.2.6 назначать (to designate): Идентифицировать набор символов, которые необходимо представить заранее определенным образом в некоторых случаях сразу, а в других при появлении следующей функции управления.

А.3.2.7 вызывать (to invoke): Обеспечить представление назначенного набора символов с помощью заранее определенных комбинаций битов там, где эти комбинации битов возникают, и до тех пор, пока не появится соответствующая функция расширения.

А.3.2.8 представлять (to represent):

а) использовать заранее определенную комбинацию битов, назначающую символ из назначенного и вызванного набора символов, или

б) использовать управляющую последовательность со значением дополнительной управляющей функции.

A.4 Значения

Значения байтов представлены в настоящем приложении как два десятичных числа в форме столбец/строка в соответствии со стандартами ИСО/МЭК. Это означает, что значение может быть вычислено как (столбец*16) + строка; например, 01/11 соответствует значению 27 (1B hex).


Пространство кодирования байтов разделено на четыре диапазона (см. рисунок A.1):

- C0 байты с 00/00 по 01/15;
- GL байты с 02/00 по 07/15;
- C1 байты с 08/00 по 09/15;
- GR байты с 10/00 по 15/15.

Диапазоны C0 и C1 являются наборами «управляющих символов», в то время как GL и GR являются наборами «графических символов». В диапазоне GL байт 02/00 всегда определяется как пробел (SPACE), а байт 07/15 (обычно команда удаления DELETE) никогда не используется.

Массив из столбцов 16 на 16, пронумерованных от 00 до 15, и строк, пронумерованных от 0 до 15, содержит 256 позиций кодов. Столбцы массива с 00 по 07 содержат 128 позиций символов, которые находятся в отношении один к одному с символами 7-битового набора. Их кодированное представление является таким же, как в 7-битовой среде с добавлением восьмого бита, равного НУЛЮ. Столбцы с 08 по 15 содержат дополнительные 128 позиций. Восьмой бит их кодового представления является ЕДИНИЦЕЙ. Столбцы с 08 по 09 используются для обозначения управляющих символов, а столбцы с 10 по 15 — для обозначения графических символов, за исключением позиций 10/0 и 15/15.

Кодовая 8-битовая таблица может быть расширена за счет различных средств расширения, одним из которых является применение соответствующей управляющей последовательности, как показано в A.6.2.

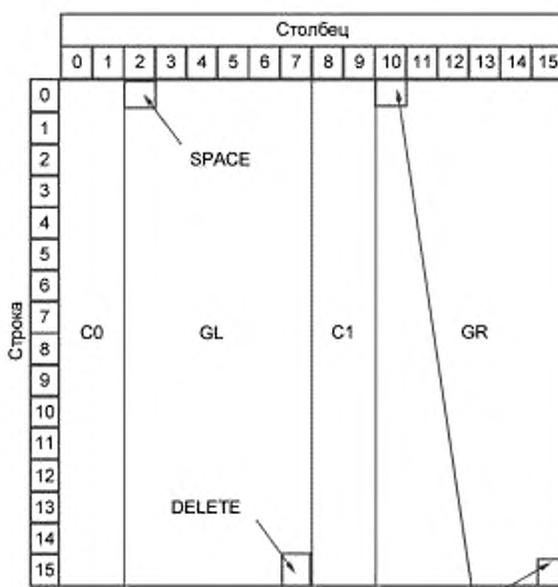

Эти два значения никогда не входят в 94 символа

Рисунок A.1 — Диапазоны пространства кодирования байтов

A.5 Управляющие символы

Определение каждого управляющего символа взято из ИСО/МЭК 646 и ИСО/МЭК 4873.

Как показано в таблице A.2, в SCP-ECG для кодирования свободного текста должно использоваться только подмножество управляющих символов C0. Не должны использоваться никакие значения из управляющего набора C1.

При обмене данными текстовых строк (например, определенных в разделах 8, 10 и 11) может потребоваться некоторая информация по их формату. Для этой цели должны использоваться символы форматирования

(перечисленные в таблице А.2), но их использование должно быть сведено к минимуму, так как некоторые машины могут неправильно их обрабатывать.

Таблица А.2 — Управляющие символы

Категория	Обозначение	Название	Кодированное представление
Символ форматирования	BS	BACKSPACE (возврат)	00/08
Символ форматирования	HT	HORIZONTAL TAB (горизонтальная табуляция)	00/09
Символ форматирования	LF	LINE FEED (перевод строки)	00/10
Символ форматирования	VT	VERTICAL TAB (вертикальная табуляция)	00/11
Символ форматирования	FF	FORM FEED (перевод страницы)	00/12
Символ форматирования	CR	CARRIAGE RETURN (возврат каретки)	00/13
Расширение кода	ESC	ESCAPE (выход)	01/11

1) BS

Возврат может использоваться для формирования составных символов с помощью наложения знаков (ИСО/МЭК 646 позволяет осуществлять представление такого рода). Тем не менее некоторые машины не имеют возможности наложения знаков, поэтому для представления составных символов лучше использовать адекватные наборы символов (например, ИСО/МЭК 8859-1).

2) HT, VT

Спецификация настроек ширины табуляции не является частью данного предложения.

3) CR

Возврат каретки также может использоваться для образования составных символов. То же самое можно сказать о BACKSPACE.

4) LF

Некоторые машины (например, работающие с операционной системой UNIX) могут интерпретировать перевод строки (00/10) как переход на начало новой строки (NEWLINE). Это можно интерпретировать как использование (нерекомендуемого) режима NEW LINE, описанного в Е.1.3 в ИСО/МЭК 6429:1992.

В настоящем приложении символ форматирования NEWLINE представлен парой CR + LF. Поэтому при использовании описанной выше среды ожидается, что эта пара преобразуется во внутреннее представление (т. е. CR + LF преобразуется в LF).

Нулевой байт (NULL) используется в протоколе SCP-ECG в качестве признака завершения строки. Но он не является частью этой строки. Это соответствует ИСО/МЭК 646 и ИСО/МЭК 4873.

А.6 Кодирование набора символов**А.6.1 Общий принцип многоязычного кодирования текста**

Для реализации многоязычной среды необходимо средство переключения разных наборов символов в текстовой строке. Некоторые графические символы обладают различным визуальным представлением, но имеют один код, например, строчная «а» с тильдой, определенная в ИСО/МЭК 8859-1, и строчная «а» с бревисом, определенная в ИСО/МЭК 8859-2, имеют один код, а именно 14/03. Кроме того, существуют некоторые многобайтовые наборы символов, например японский Кандзи и китайский Ханьцзы, содержащие тысячи символов, кодирование которых одним байтом невозможно.

ИСО/МЭК 2022 определяет способы расширения кода (см. рисунок А.2), делая возможным использование нескольких наборов графических символов в текстовой строке, обеспечивая тем самым многоязычную среду. В ИСО/МЭК 2022 расширение кода реализуется отображением желаемого набора графических символов на кодовое пространство, используя следующие два шага:

1) желаемый набор графических символов назначается как одно из множеств G0, G1, G2 или G3; это выполняется с помощью управляющих последовательностей;

2) назначенный набор (G0, G1, G2 или G3) отображается в пространстве кодирования с 02/00 по 07/15 или 10/00 по 15/15; это выполняется с помощью функций переключения регистра.

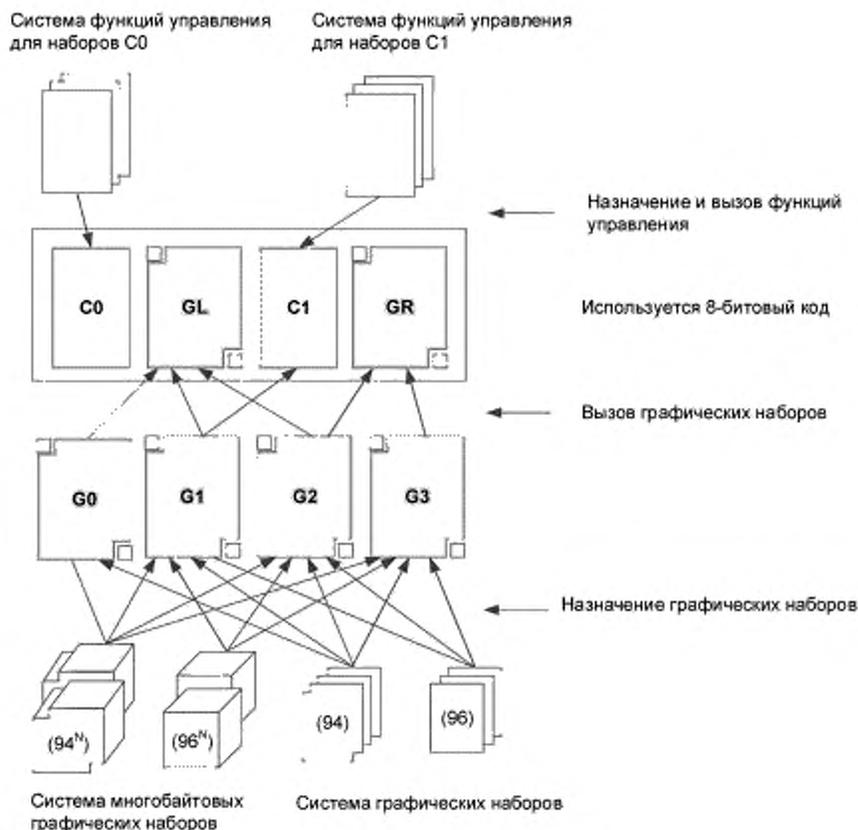


Рисунок А.2 — Способы расширения кода (см. ИСО/МЭК 2022)

А.6.2 Настройка по умолчанию и начальная настройка

А.6.2.1 Следует использовать только 8-битовую среду, а также всегда применять G0 для GL и G1 для GR (см. рисунок А.3). Такой подход реализуется за счет объявления необходимых средств расширения в соответствии с разделом 9 в ИСО/МЭК 2022:1994. В этом случае назначение также служит вызовом, поэтому необходимость в явном вызове отсутствует.

Набор из 96 символов может быть назначен/вызван только в диапазон GR. Это связано с тем, что код 02/00 назначен пробелу (SPACE), а код 07/15 — удалению (DELETE), поэтому диапазон GL может содержать только 94 символа в диапазоне кодов от 02/01 до 07/14. Диапазон GR может содержать 96 символов с кодами от 00/00 до 15/15. Поэтому в диапазон GR могут быть вызваны как наборы из 94 символов, так и наборы из 96 символов.

В наборе из 94 символов никакие символы не должны размещаться в позициях 02/00, 07/15, 10/00 и 15/15, в то время как в наборе из 96 символов эти позиции могут содержать символы. Трехмерный блок на рисунке А.3 представляет многобайтовый набор символов. Набор из 94N символов использует N ($N > 1$) байтов для каждого символа, как показано на рисунке А.3.

А.6.2.2 По умолчанию набор GL соответствует левой половине таблицы ИСО/МЭК 8859-1. Это равносильно кодировке ASCII (ANSI X3.4-1968).

А.6.2.3 По умолчанию набор GR соответствует правой половине таблицы ИСО/МЭК 8859-1. Эти спецификации определяют набор символов по умолчанию, который может использоваться без управляющей последовательности в соответствии с указанным в 6.4 «Начальным назначением и вызовом» в ИСО/МЭК 2022. Подмножество ИСО/МЭК 2022 для SCP-ECG показано на рисунке А.3.

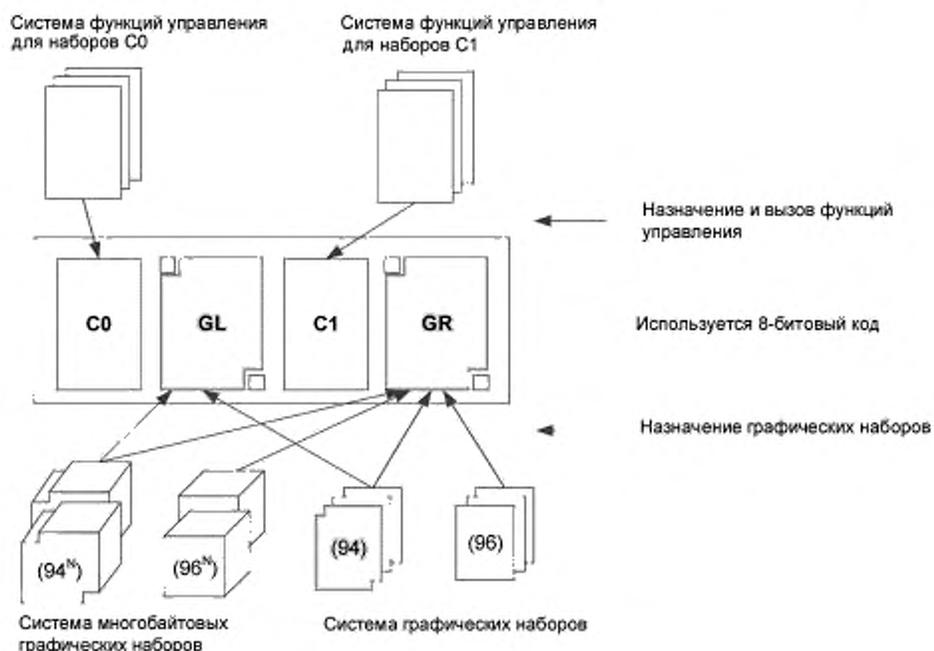


Рисунок А.3 — Набор GR по умолчанию (подмножество ИСО/МЭК 2022)

А.6.2.4 Подразумеваемое начальное состояние в ИСО/МЭК 2022 определено последовательностью, показанной в таблице А.3.

Таблица А.3 — Подразумеваемое начальное состояние в ИСО/МЭК 2022

Управляющая последовательность	Описание
ESC 02/00 04/03	G0 и G1 только в 8-битовой среде. Назначение также служит вызовом
ESC 02/00 04/07	В 8-битовой среде, C1 представлено в 8 битах
ESC 02/00 04/09	Наборы графических символов могут содержать 94 или 96 символов
ESC 02/00 04/11	Используется 8-битовый код
ESC 02/08 04/02	Назначение ASCII в G0
ESC 02/13 04/01	Назначение правой части ИСО Latin-1 в G1
ESC 02/01 04/00	Назначение ИСО/МЭК 646 в C0

Набор символов по умолчанию для SCP-ECG показан на рисунке А.4.



Рисунок А.4 — Набор символов по умолчанию для SCP-ECG

А.6.3 Расширение набора символов

А.6.3.1 На рисунке А.5 показана структура поля строки, закодированного в соответствии с ИСО/МЭК 2022. Текстовая строка с таким кодированием содержит символы управляющей последовательности или функции переключения регистра, а также объявление средств расширения в начале строки.



Рисунок А.5 — Структура поля текстовой строки (ИСО/МЭК 2022)

А.6.3.2 Метод ИСО/МЭК 2022 является гибким и эффективным, но его полная реализация может быть очень сложной для протокола SCP-ECG. Некоторые управляющие последовательности, функции переключения регистра и объявления могут быть опущены в соответствии с настоящим стандартом.

Чтобы опустить некоторые управляющие последовательности и предложить более простой метод многоязычного кодирования, применяются следующие правила:

- 1) объявления (1), показанные на рисунке А.5, должны быть опущены по соглашению между обменивающимися сторонами о средствах расширения;
- 2) функции переключения регистра (3) и (4) должны быть опущены с помощью управляющих последовательностей, которые назначают, а также вызывают G0 и G1 в GL и GR соответственно, как это определено последовательностью «ESC 02/00 04/03»;

3) управляющая последовательность (2) опускается с помощью следующей начальной установки по умолчанию:

- назначить ASCII (левая часть таблицы ИСО/МЭК 8859-1) в G0, а также вызвать ее в GL,
- назначить Latin-1 (правая часть ИСО/МЭК 8859-1) в G1, а также вызвать ее в GR,
- назначить ИСО/МЭК 646 в C0,
- никаких назначений в C1.

Если используется только набор ИСО/МЭК 8859-1, то в текстовой строке не должны присутствовать никакие управляющие последовательности. Это обычная 8-битовая текстовая строка в кодировке ASCII. Если в строке требуется другой набор символов, то для переключения набора символов необходимо указать перед ним управляющую последовательность.

Формат текстового поля с несколькими наборами символов приведен в таблице А.4.

Таблица А.4 — Формат закодированной текстовой строки в SCP-ECG

Символы из набора символов по умолчанию	Управляющая последовательность	Символы из нового набора символов	Управляющая последовательность для смены набора символов	—
---	--------------------------------	-----------------------------------	--	---

Каждая передаваемая строка должна начинаться с набора символов по умолчанию. Новое поле или завершающий NULL должны осуществлять сброс к набору символов по умолчанию.

А.6.3.3 Формат управляющей последовательности для набора символов расширения

ESC (I) F:

- «ESC» является символом начала управляющей последовательности. Он имеет кодовое представление 01/11.
- «(I)» означает один или несколько «промежуточных символов», которые находятся в диапазоне 02/00—02/15. Он задает функцию управляющей последовательности.

- «F» означает «финальный символ», который всегда находится в диапазоне 04/00—07/14. Финальные символы зарегистрированы международным регистрирующим органом. Некоторые из финальных символов перечислены в А.6.4.

А.6.3.4 Чтобы указать, что другой набор символов является GL-набором, используется одна из следующих управляющих последовательностей:

ESC 02/08 F	Набор из 94 символов;
ESC 02/04 02/08 F	Набор из 94N символов;
ESC 02/04 F	Некоторый специальный набор из 94N символов.

В последовательности «ESC 02/04 F» могут использоваться финальные символы 04/01 и 04/02. Это исключение взято из 6.3.9, ИСО/МЭК 2022:1994. Последовательность «ESC 02/04 04/02» для набора японских символов широко используется в Японии.

А.6.3.5 Чтобы указать, что другой набор символов является GR-набором, используется одна из следующих управляющих последовательностей:

ESC 02/09 F	Набор из 94 символов;
ESC 02/13 F	Набор из 96 символов;
ESC 02/04 02/09 F	Набор из 94N символов.

А.6.3.6 Разрешены промежуточные символы 02/00, 02/01, 02/04, 02/09 и 02/13. Следующие промежуточные символы не разрешены в SCP-ECG:

02/02, 02/03, 02/05, 02/06, 02/07, 02/10, 02/11, 02/12, 02/14 и 02/15.

А.6.3.7 Финальные символы для частного кодирования (в диапазоне от 03/00 до 03/15) не разрешены в SCP-ECG.

А.6.3.8 Другие управляющие последовательности, описанные в ИСО/МЭК 2022, не должны использоваться для SCP-ECG.

А.6.3.9 Набор из 94N символов использует для каждого символа N байтов (N > 1). Значение N получено из значения столбца финального символа F, указанного выше:

столбец 04	2 байта;
столбец 05	2 байта;
столбец 06	3 байта;
столбец 07	4 или более байтов.

В кодировании 94N значения байтов 02/00 и 07/15 (в GL), а также 10/00 и 15/15 (в GR) никогда не используются (определения столбцов взяты из ИСО/МЭК 2022).

А.6.4 Финальные символы

В SCP-ECG должны использоваться только международные зарегистрированные финальные символы. Некоторые из финальных символов, которые могут использоваться, показаны в таблице А.5.

Наборы, перечисленные как «Левая половина...», всегда должны определяться как GL. Наборы, перечисленные как «Правая половина...», всегда должны определяться как GR. Другие наборы могут определяться как GL, так и GR.

Если финальные коды 04/01, 04/02 и 04/03 используются в форме «ESC 02/04 F», то они всегда определены как GR.

Таблица А.5 — Финальные символы

F	94/96	Описание
04/02	94	7-битовая графика ASCII (ANSI X3.4-1968). Левая половина наборов ИСО/МЭК 8859
04/09	94	Правая половина JIS X 0201-1976 (подтверждена в 1984 году) 8-битовый код алфавитно-цифровой Катаканы
04/10	94	Левая половина JIS X 0201-1976 (подтверждена в 1984 году) 8-битовый код алфавитно-цифровой Катаканы
04/01	96	Правая половина ИСО/МЭК 8859-1, латинский алфавит № 1
04/02	96	Правая половина ИСО/МЭК 8859-2, латинский алфавит № 2
04/03	96	Правая половина ИСО/МЭК 8859-3, латинский алфавит № 3
04/04	96	Правая половина ИСО/МЭК 8859-4, латинский алфавит № 4
04/06	96	Правая половина ИСО/МЭК 8859-7, латинский/греческий алфавит
04/07	96	Правая половина ИСО/МЭК 8859-6, латинский/арабский алфавит
04/08	96	Правая половина ИСО/МЭК 8859-8, латинский/еврейский алфавит
04/12	96	Правая половина ИСО/МЭК 8859-5, латинский алфавит/кириллица № 1
04/13	96	Правая половина ИСО/МЭК 8859-9, латинский алфавит № 5
04/01	942	GB2312-1980, Ханьцзы Китая (КНР)
04/02	942	JIS X 0203-1983, набор японских графических символов
04/03	942	KS C5601-1987, набор корейских графических символов

А.7 Код языка

Поле «Код языка» раздела 2 в протоколе SCP-ECG используется для идентификации класса используемого набора символов. Это поле кодируется в соответствии с таблицей А.6.

Таблица А.6 — Код языка

Значение	Описание
Бит 0 сброшен в 0	Используется только кодировка ASCII
Бит 0 установлен в 1	Использует набор символов, не связанный с кодировкой ASCII (включает правую половину ИСО/МЭК 8859-1)
Бит 1 сброшен в 0	Используется только ИСО/МЭК 8859-1
Бит 1 установлен в 1	Используются наборы символов, отличные от ИСО/МЭК 8859-1
Бит 2 сброшен в 0	Многобайтовый набор символов не используется
Бит 2 установлен в 1	Используется многобайтовый набор символов
Биты с 3 по 7	Всегда сбрасываются в 0

Следует учитывать, что при использовании правой половины ИСО/МЭК 8859-1 бит 0 должен иметь значение 1. В этом случае в строке не должны появляться никакие управляющие последовательности.

А.8 Метод обработки не поддерживаемых наборов символов

А.8.1 Общие положения

Использование в строке не поддерживаемых наборов символов может привести к серьезным проблемам при идентификации пациента. Ниже описан метод обработки не поддерживаемых наборов символов. Предполагается, что существует система, которая может отобразить/напечатать все символы.

A.8.2 Машина, использующая ИСО/МЭК 8859-1

Все символы диапазонов GR и GL, которые не поддаются обработке, следует распечатывать, отображать и вводить следующим образом:

- заменить все символы «\» (05/02) на два символа «\\»;

- заменить символ перехода (escape) (01/11), предшествующий неизвестным управляющим последовательностям, на четыре символа «\033». Следует учесть, что известные управляющие последовательности должны обрабатываться надлежащим образом.

A.8.2.1 Машина, использующая ASCII

Все символы диапазонов GR и GL, которые не поддаются обработке, следует распечатывать, отображать и вводить следующим образом:

- заменить все символы «\» (05/02) на два символа «\\»;

- заменить символ перехода (escape) (01/11), предшествующий неизвестным управляющим последовательностям, на четыре символа «\033» (следует учесть, что известные управляющие последовательности должны обрабатываться надлежащим образом);

- заменить символы диапазона GR на четыре символа «\ppp», где «ppp» — трехзначное восьмеричное представление каждого байта.

Проверка кода языка является полезной практикой для данного метода. Тем не менее синтаксический разбор текстовой строки по-прежнему необходим, так как в одной строке могут быть как поддерживаемые, так и не поддерживаемые наборы символов.

Примечание — Это предложение не определяет действия для случаев переполнения полей отображения, печати или ввода.

A.9 Краткое изложение управляющих последовательностей, описанных в данном приложении для кодирования произвольного текста в SCP-ECG

В начале обмена информацией может потребоваться объявление средств расширения кода, использованных в последующих данных. Если подобное объявление должно быть вложено в кодированную символьную информацию, то следует использовать один или несколько классов трехсимвольных управляющих последовательностей ESC 02/00 F. В зависимости от соглашения между обменивающимися сторонами подобное объявление может быть опущено.

Не перечисленные в таблице A.7 управляющие последовательности не должны использоваться в текстовых полях. «Объявитель» не должен явно отображаться в этом поле.

Таблица A.7 — Управляющие последовательности

Управляющая последовательность	Описание	Примечание
ESC 02/00 04/03	Диапазоны G0 и G1 используются только в 8-битовой среде; назначение также служит вызовом	Объявитель ^{a)}
ESC 02/00 04/07	В 8-битовой среде коды диапазона C1 представлены в 8 битах	Объявитель ^{a)}
ESC 02/00 04/09	Наборы графических символов могут содержать 94 или 96 символов	Объявитель ^{a)}
ESC 02/00 04/11	Используется 8-битовый код	Объявитель ^{a)}
ESC 02/08 04/02	Назначить левую половину ASCII ИСО/МЭК 8895-1 в диапазон G0	По умолчанию
ESC 02/13 04/01	Назначить правую половину ИСО/МЭК 8895-1 Latin-1 в диапазон G1	По умолчанию
ESC 02/01 04/00	Назначить ИСО/МЭК 646 в диапазон C0	По умолчанию
ESC 02/08 F	Назначить набор из 94 символа в диапазон G0	
ESC 02/04 02/08 F	Назначить набор из 94N символов в диапазон G0	
ESC 02/04 F	Назначить набор некоторых специальных символов 94N в диапазон G0	
ESC 02/09 F	Назначить набор из 94 символов в диапазон G1	
ESC 02/13 F	Назначить набор из 96 символов в диапазон G1	
ESC 02/04 02/09 F	Назначить набор из 94N символов в диапазон G1	
^{a)} Финальные символы (04/03, 04/07, 04/09, 04/11) объявляют фактически используемое расширение кода, откуда происходит понятия «объявитель», а также «объявляющая последовательность». Финальный символ объявляющей последовательности указывает средства представления графических наборов и некоторых наборов управления в 7-битовой и 8-битовой средах.		

Приложение В
(обязательное)

Определение соответствия стандарту SCP-ECG

В.1 Общие сведения

Стандарт SCP-ECG определяет средства, с помощью которых устройства и системы ЭКГ могут обмениваться информацией. Категории формата данных, определенные в настоящем приложении, предоставляют пользователям и производителям устройств и/или систем ЭКГ достаточно простую кодификацию функций и информационного содержания, связанного с SCP-ECG, которые могут быть предоставлены конкретным устройством. Способы кодирования данных ЭКГ точно определены, но при этом являются гибкими. При реализации настоящего стандарта производитель может ограничиться некоторым подмножеством всех возможных способов кодирования данных ЭКГ. Поэтому в разделе В.3 определена процедура тестирования, которое должны пройти производители, объявляющие соответствие SCP-ECG. В связи с гибкостью, допускаемой в информационном содержании и кодировании, пользователь/покупатель должен определить, насколько устройство и/или система пригодны для конкретного применения.

Производители, объявляющие соответствие своих устройств и/или систем стандарту SCP-ECG, должны следовать спецификациям и определениям, приведенным в настоящем приложении. Формат данных включает в себя элементы, указанные в разделах 5 и 6 настоящего стандарта (и в приложениях, на которые они ссылаются). Соответствие поддержки коммуникаций не является обязательной частью настоящего стандарта. Если обмен записями ЭКГ между двумя разными устройствами картирования и/или системами выполняется по каналам последовательной передачи данных (прямое подключение по кабелю или через модем), то возможным решением может служить использование функций передачи сообщений запросов, указанных в приложении D, и транспорта данных, описанного в приложении E. Если используются различные средства обеспечения коммуникаций (например, Bluetooth, беспроводное соединение, ЛВС и т. п.), то сообщения запросов и транспорт данных должны быть точно описаны в стиле приложений D и E. Эти описания должны быть сделаны свободно доступными, чтобы потенциальные пользователи/покупатели устройства картирования или системы могли получать их по запросу.

В настоящее время не существует признанного средства/метода, позволяющего осуществлять проверку соответствия спецификациям настоящего стандарта. В лучшем случае подобное средство было бы полезно производителям в их деятельности по обеспечению совместимости их устройств. За счет гибкости, которую позволяют информационное содержание и кодирование, совместимость между устройствами разных производителей должна определяться для каждого случая, даже если было показано, что оба устройства соответствуют стандарту SCP-ECG. От одной лишь декларации о соответствии настоящему стандарту будет мало пользы пользователю/покупателю. Поэтому декларация о соответствии стандарту SCP-ECG должна сопровождаться декларацией о совместимости с устройством или устройствами другого производителя или производителей, однозначно идентифицированных торговой маркой производителя, описанием модели и идентификатором программного обеспечения, реализующего SCP.

В.2 Спецификация соответствия

В.2.1 Категории форматов данных

В таблице В.1 определены категории форматов данных, которые должны использоваться в декларации о соответствии стандарту SCP-ECG. Информационное содержание, предусмотренное каждой категорией, представлено в графе «Описание содержания». Соответствие предполагает, что данные каждого раздела должны кодироваться, как указано в применимом подразделе раздела 5.

Таблица В.1 — Категории форматов данных для спецификаций соответствия

Категория	Требуемый раздел данных	Описание содержания
I	0, 1, [2] ^{a)} , 3, 6, (7) ^{b)} , (8) ^{b)} , (10) ^{b)}	Демографические данные и данные ритма ЭКГ (несжатые или сжатые без потери качества)
II	0, 1, [2] ^{a)} , 3, 4, 5, 6, (7) ^{b)} , (8) ^{b)} , (10) ^{b)}	Демографические данные, данные ритма ЭКГ (несжатые или сжатые без потери качества) и эталонные циклы
<p>^{a)} Квадратные скобки [] указывают на то, что раздел данных 2 необходим, если использовалось кодирование Хаффмана.</p> <p>^{b)} Круглые скобки () указывают на то, что эти разделы данных не обязательны для экспорта. «Импорт» и «Экспорт» определены в В.2.2.</p>		

В будущих версиях может быть добавлена дополнительная категория, удовлетворяющая определенным требованиям устройств ЭКГ, используемых в других приложениях (например, в телемедицине или медицинской помощи на дому).

Все устройства, для которых декларировано соответствие стандарту SCP-ECG, должны как минимум импортировать данные, описанные в разделах 0, 1, 3, 6, 7 и 8. Во все категории могут быть добавлены дополнительные разделы (например, 9, 10, 11). Данные, специфичные для производителя, должны (не обязательно) быть включены в определенные в настоящем стандарте поля, байты и блоки данных, специфичные для производителя. Резервированные, не указанные и не определенные поля, байты и блоки данных не должны использоваться для данных, специфичных для производителя.

В.2.2 Функции обмена данными

В.2.2.1 Экспорт

Способность сделать запись SCP-ECG, имеющую заданную категорию формата данных, доступной для коммуникационных каналов. В соответствии со спецификацией SCP-ECG запись SCP-ECG создается из необработанных данных ЭКГ, с использованием сжатия, указанного в 6.5.3.

В.2.2.2 Импорт

Способность принимать из коммуникационного канала, извлекать и делать доступной для пользователя информацию из записи SCP-ECG, имеющей заданную категорию формата данных. Импортирующее устройство должно как минимум импортировать данные, описанные в разделах 0, 1, 3, 6, 7 и 8 (например, из стандартного 10-секундного ЭКГ в 12 отведений (кодируются I, II, V1, V2, V3, V4, V5, V6)), и делать извлеченную информацию доступной для пользователя (при этом должны быть выполнены требования 6.5.3).

В.2.2.3 Пересылка

Экспорт ранее импортированной записи в том же формате данных, с модификацией или без модификации отдельных разделов. Записи ЭКГ, хранящиеся в форматах, отличных от SCP, могут быть преобразованы в соответствии с форматом SCP-ECG. Данные сигнала ЭКГ, импортированные в формате SCP ЭКГ, не должны искажаться в процессе сжатия для пересылки.

Целью определения пересылки является сохранение компонентов записи (например, раздела, специфичного для производителя), которые импортирующее устройство неспособно обработать. Требование того, чтобы данные ЭКГ не испытывали дополнительные потери при пересылке, подразумевает либо отправку исходных сжатых данных или дополнительное сжатие без потери качества. Редактирование пользователем демографических данных, измерений и интерпретаций, а также сокращение или потери данных по выбору пользователя, не входят в настоящий стандарт.

В.2.2.4 Коммуникационный канал

Любой механизм, способный передать запись SCP-ECG для внешнего доступа.

Примечание — Примером коммуникационного канала может служить RS-232, используемый для передачи сообщений запросов, описанных в приложении D, с использованием транспорта, описанного в приложении E. Настоящий стандарт не запрещает, но и не поддерживает использование какого-либо другого механизма.

В.2.3 Передача сообщений SCP-ECG/транспортный протокол

Если обмен записями ЭКГ между разными устройствами картирования и/или системами выполнен по каналу последовательной передачи данных (прямое подключение по кабелю или через модем), то возможное решение задачи отправки сообщений запросов можно найти в приложении D, а решение транспорта данных — в приложении E. Для устройства должны быть декларированы поддерживаемые технологии коммуникаций (RS-232, Bluetooth, беспроводное соединение, ЛВС и т. д.), а также утверждение, что информация о коммуникационном протоколе отправки сообщений запросов и транспорте данных может быть получена по запросу. Обычно производитель должен раскрыть информацию о механизме или механизмах, с помощью которых можно получить доступ к файлам данных, форматированных в соответствии со стандартом SCP-ECG.

Если устройство картирования/система поддерживает коммуникационный протокол RS-232, то декларация «поддерживается отправка сообщений запросов» означает, что имеет место соответствие с приложением D, но при этом используется транспортный протокол, который не определен в настоящем стандарте и который производитель должен раскрыть. Декларация «поддерживаются отправка сообщений запросов и транспортный протокол» означает соответствие приложениям D и E. Если устройство не поддерживает все указанные функции, оно будет считаться соответствующим стандарту, если может отвечать на запросы таким образом, как это описано в настоящем стандарте. Например, если «Запрос списка пациентов» (D.2.2.2) не поддерживается, то на такой запрос можно передать ответ «обработка запроса не поддерживается» [D.2.6, 11]]. Устройство, которое не может возвращать ответ на неподдерживаемый запрос или его ответ отличается от указанного в настоящем стандарте, не будет считаться соответствующим стандарту.

Известно, что существуют другие механизмы для передачи файлов в формате SCP-ECG. Настоящий стандарт не запрещает, но и не поддерживает использование каких-либо других механизмов, отличных от отправки сообщений запросов SCP-ECG и транспортного протокола, определенных в приложениях D и E.

В.2.4 Спецификация декларации о соответствии

Декларация о соответствии стандарту SCP-ECG должна иметь следующую форму и содержание:

Указанное устройство следующим образом соответствует версии стандарта на SCP-ECG x.x:	
Устройство	<p>Торговая марка производителя</p> <p>Описание модели</p> <p>Идентификатор программного обеспечения реализации SCP-ECG.</p>
Экспорт	<p>Категория(и) формата данных или «не поддерживается».</p> <p>Разделы данных с описанием содержания.</p> <p>Список производителей (и устройств) с указанием категорий и дополнительных разделов, для которых было подтверждено соответствие в области возможностей экспорта (тестированием для каждого устройства), или следующее утверждение: «Список производителей (и устройств) с указанием категорий и дополнительных разделов, для которых было подтверждено соответствие в области возможностей экспорта (тестированием для каждого устройства), можно получить по запросу».</p>
Импорт	<p>Категория(и) формата данных или «не поддерживается».</p> <p>Разделы данных с описанием содержания.</p> <p>Список производителей (и устройств) с указанием категорий и необязательных разделов, для которых было подтверждено соответствие импорту стандарту (тестированием каждого устройства), или следующая декларация: «Список производителей (и устройств) с указанием категорий и необязательных разделов, для которых было подтверждено соответствие импорту стандарту (тестированием каждого устройства), можно получить по запросу».</p>
Пересылка данных	«Поддерживается» или «не поддерживается».
Коммуникационный канал	<p>Поддерживаемый коммуникационный протокол: RS-232.</p> <p>Передача: «Сообщения запросов и транспорт данных не поддерживаются», или «Сообщения запросов поддерживаются», или «Сообщения запросов и транспорт данных поддерживаются».</p> <p>Получение: «Сообщения запросов и транспорт данных не поддерживаются», или «Сообщения запросов поддерживаются», или «Сообщения запросов и транспорт данных поддерживаются».</p> <p>Если поддерживаемый коммуникационный протокол отличается от RS-232 или передача и/или получение отличаются от «Сообщения запросов и транспорт данных поддерживаются», то должно быть добавлено следующее предложение: «Информация о коммуникационном протоколе сообщений запросов и транспорта данных может быть получена по запросу» или «Механизм(ы) доступа к файлам данных, форматированных в соответствии со стандартом SCP-ECG, можно получить по запросу».</p> <p>В случае декларации «Сообщения запросов и транспорт данных поддерживаются» для передачи и/или получения должны быть добавлены список производителей (и устройств), для которых подтверждена совместимость с уровнем обмена сообщениями/транспорта SCP (путем тестирования) или следующая декларация: «Список производителей (и устройств), для которых подтверждена совместимость с уровнем обмена сообщениями/транспорта SCP-ECG (путем тестирования), можно получить по запросу».</p>

В.2.5 Гипотетические примеры**В.2.5.1 Кардиограф**

Декларация о соответствии стандарту SCP-ECG версии 2.x	
Устройство	<p>MyECG Company</p> <p>Модель Top1</p> <p>Реализация SCP-ECG MyECG SCP версия 2.</p>
Экспорт	<p>Категория формата данных II.</p> <p>Разделы данных 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, содержащие демографические данные, данные ритма ЭКГ, эталонные циклы, глобальные измерения, измерения отведений и интерпретацию.</p> <p>Совместимость экспорта для категории II была подтверждена посредством тестирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xzq Manufacturing, Inc. Модели LB1577, LB1755 и ZM922 (SCP-ECG версия 1.3, версия реализации программного обеспечения 6.1); - BestECG, LTD. Модель PQRST2 (SCP-ECG версия 1.3, версия реализации программного обеспечения 3.0).

Окончание таблицы

Импорт	<p>Категория формата данных I: Разделы данных 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, содержащие демографические данные, данные ритма ЭКГ, глобальные измерения, измерения отведений и интерпретацию.</p> <p>Категория формата данных II: Разделы данных 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, содержащие демографические данные, данные ритма ЭКГ, эталонный цикл, глобальные измерения, измерения отведений и интерпретацию.</p> <p>Список производителей (и устройств) с указанием категорий и необязательных разделов, для которых было подтверждено соответствие импорта стандарту (тестированием каждого устройства) можно получить по запросу.</p>
--------	---

В.2.5.2 Система управления

Декларация о соответствии стандарту SCP-ECG версии 2.x	
Устройство:	<p>MyECG Comrapu Модель Top2 Реализация SCP_ECG версии MyECG SCP версия 2.</p>
Экспорт	Не поддерживается.
Импорт:	<p>Категория формата данных I: Разделы данных 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, содержащие демографические данные, данные ритма ЭКГ, глобальные измерения, измерения отведений и интерпретацию.</p> <p>Категория формата данных II: Разделы данных 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, содержащие демографические данные, данные ритма ЭКГ, эталонные циклы, глобальные измерения, измерения отведений и интерпретации.</p> <p>Список производителей (и устройств) с указанием категорий и необязательных разделов, для которых было подтверждено соответствие импорта стандарту (тестированием каждого устройства), можно получить по запросу.</p>

В.2.5.3 Дефибриллятор, ЭКГ в 12 отведений

Декларация о соответствии стандарту SCP-ECG версия 2.x	
Устройство:	<p>MyECG Comrapu Модель Top3 Реализация SCP_ЭКГ версии MyECG SCP версия 2.</p>
Экспорт	Не поддерживается.
Импорт:	<p>Категория формата данных I: Разделы данных 0, 1, 2, 3, 6, содержащие демографические данные и данные ритма ЭКГ.</p> <p>Совместимость экспорта для категории I была подтверждена посредством тестирования: - Xzq Manufacturing, Inc. Модели LB1577, LB1755 и ZM922 (SCPECG версия 1.3, версия реализации программного обеспечения 6.1); - BestECG, LTD. Модель PQRST2 (SCP-ECG версия 1.3, версия реализации программного обеспечения 3.0).</p>

В.3 Тестирование/подтверждение совместимости формата данных стандарту SCP-ECG

В.3.1 Обзор

Тестирование/подтверждение соответствия/совместимости формата данных стандарту SCP-ECG может быть выполнено отдельными производителями. Требования к тестированию/подтверждению соответствия показаны на рисунке В.1 и подробно рассмотрены в В.3.2. Каждый производитель, декларирующий соответствие экспорта, предоставляет публично доступный и бесплатный пример записей в формате SCP-ECG для каждого устройства, генерирующего ЭКГ, и для каждого заявленного уровня формата данных, а также дополнительные обеспечивающие файлы данных, позволяющие импортирующему производителю подтвердить соответствие точного декодирования записей SCP-ECG. Прочитав файлы производителя А, производитель В может подтвердить, что файлы производителя А могут быть импортированы. Если в декларации о соответствии SCP-ECG производитель В заявляет, что совместимость с А в области импорта была подтверждена, то производитель В в письменной форме оповещает об этом производителя А. Затем производитель А может заявить о подтверждении совместимости с В в области экспорта. Тем самым производители совместно подтверждают совместимость друг с другом.

Подтверждение соответствия импорта может быть представлено диаграммой, показанной на рисунке В.1.

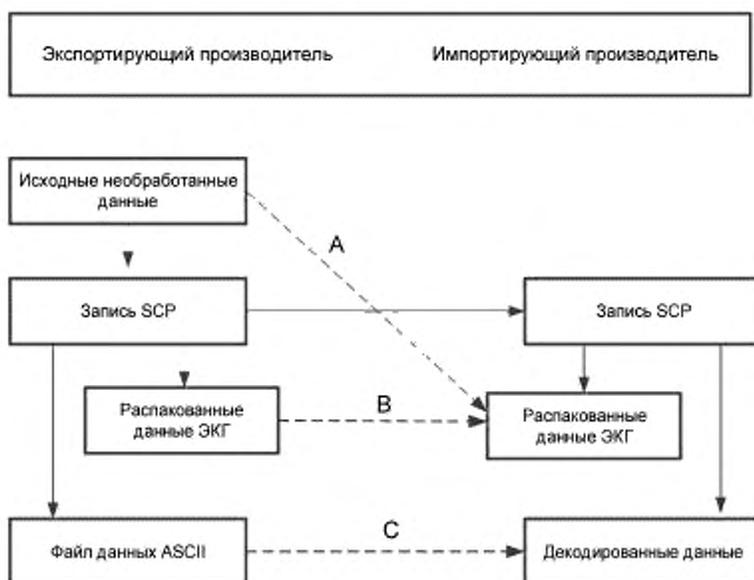


Рисунок В.1 — Диаграмма подтверждения импорта

В.3.2 Требования

Производитель экспорта должен создать пять типов файлов и сделать их открытыми и общедоступными для каждого предоставленного теста, для каждого типа экспортирующего устройства и для каждого уровня соответствия.

- 1) двоичный файл в формате SCP-ECG (***.ECG);
- 2) исходный файл необработанных данных ЭКГ, из которого был получен файл SCP-ECG, в двоичном формате, определенном в В.3.3 (***.EC0);
- 3) распакованный файл данных ЭКГ из файла SCP-ECG, полученный с помощью процесса распаковки производителя экспорта и имеющий двоичный формат, определенный в В.3.3 (***.EC1);
- 4) текстовый файл, описанный в В.3.3 и содержащий определения данных в исходном и распакованном двоичных файлах ЭКГ (***.EC2);
- 5) файл данных ASCII (для данных, не являющихся сигналами), содержащий все демографические данные, измерения и данные интерпретации (***.EC3).

Производитель экспорта должен предоставить тестовые комплекты, состоящие из файлов пяти требуемых типов, как минимум для тех случаев, что указаны в разделе С.5 (и в таблице С.13). Производитель экспорта может также предоставить дополнительные тестовые комплекты, состоящие из файлов требуемых типов. Набор тестовых комплектов, предоставляемых производителем экспорта, должен включать файлы, содержание которых ограничено пределами реализации стандарта производителем экспорта.

Для всех тестовых комплектов, предоставленных производителем экспорта, производитель импорта должен импортировать записи SCP-ECG, а затем подвергнуть их декодированию и распаковке. Для каждого теста распакованные данные ЭКГ должны сравниваться с исходными данными ЭКГ (сравнение «А» на рисунке В.1), а распакованные данные ЭКГ должны соответствовать требованиям к дискретизации и пределам искажений, указанным в 6.5. Сравнение «В» между распакованными данными производителя экспорта и распакованными данными производителя импорта позволяет производителю импорта оценить различия, наблюдаемые в сравнении «А». Сравнение «В» не обязательно.

Для каждого тестового комплекта производитель импорта должен сравнить декодированную демографическую информацию, измерения и данные интерпретации с данными в файле ASCII, предоставленном производителем экспорта (сравнение «С» в диаграмме). Это сравнение должно быть точным для всех полей данных, декодированных производителем импорта.

Производитель может заявить совместимость импорта для каждого устройства производителя и для каждой категории формата данных, которая была подтверждена. Если декларировано соответствие импорта для экспортированных файлов другого производителя, то производитель экспорта должен быть оповещен об этом в письменной форме.

и экспортирующий производитель должен иметь возможность декларировать совместимость экспорта между ним и импортирующим производителем.

В.3.3 Двоичный формат файла ЭКГ (***.EC0, ***.EC1)

Каждая тестовая ЭКГ должна быть предоставлена вместе со следующей информацией:

1) текстовый файл (***.EC2), содержащий:

- i) описатели данных каждого отведения ЭКГ, разделенные запятой (может быть как больше, так и меньше отведений, чем типичные 8, хранящиеся для ЭКГ в 12 отведениях, снятой в состоянии покоя),
- ii) общее число считываний для каждого отведения,
- iii) частота считываний (в секунду) или интервал между считываниями (микросекунды),
- iv) число нановольт в младшем значащем бите,

2) двоичные файлы (***.EC0, ***.EC1) с данными ЭКГ, хранящимися в виде 16-битовых слов со знаком в формате Intel (нижний байт, верхний байт). Последовательность считываний (S_1, S_2, \dots, S_n) для отведений (L_1, L_2, \dots, L_m):

$S_1L_1, S_1L_2 \dots S_1L_m, S_2L_1, S_2L_2 \dots S_nL_1, S_nL_2 \dots S_nL_m$

Пример — Приведенный в таблице В.2 пример описывает сигнал, снятый с 8 отведений ЭКГ, идентичный для каждого отведения, с чередующимися считываниями $\pm 1,0$ мВ на каждое отведение. В данном случае значениям ± 1000 соответствуют шестнадцатеричные значения 03E8 и FC18.

***.EC2 — Текстовый файл, имеющий следующее содержание:

отведения: I, II, V1, V2, V3, V4, V5, V6;

5000 считываний на отведение; 500 считываний в секунду; 1000 нановольт в младшем значащем бите.

***.EC0 или ***.EC1 — Двоичный файл (в шестнадцатеричном формате для каждого байта).

Таблица В.2 — Пример для 8 отведений ЭКГ

		Отведения								
		I	II	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
Байты	00—0F	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	Считывание 1
	10—1F	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	Считывание 2
	20—2F	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	Считывание 3
	30—3F	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	Считывание 4
	40—4F	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	E8 03	Считывание 5
	50—5F	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	18 FC	Считывание 6

В.4 Кодирование соответствия SCP-ECG

В 5.4.5 указано, что байт 16 тега 14 (идентификатор машины снимающего устройства) содержит кодированные категории совместимости. Старшие четыре бита байта 16 должны использоваться для характеристики категории формата данных, а младшие четыре бита того же байта зарезервированы, как это показано в таблице В.3. Хотя конкретное устройство может декларировать множество разных категорий формата данных (В.2.4), старшие четыре бита байта 16 должны указывать категорию формата данных записи, в которую встроено тег.

Таблица В.3 — Спецификация 5.4.5, тег 14, байт 16

Спецификация 5.4.5, тег 14, байт 16:		Старшие 4 бита: категория формата данных SCP-ЭКГ (I или II)				Зарезервировано			
		бит 7	бит 6	бит 5	бит 4	бит 3	бит 2	бит 1	бит 0
Старшие 4 бита	Категория I:	1	1	0	1				
Совместимость содержания данных	Категория II:	1	1	1	0				
Младшие 4 бита: зарезервированы						0	0	0	0

Приложение С
(обязательное)

**Общий подход и проверка соответствия рекомендуемого метода сжатия
сигнала электрокардиограммы**

С.1 Общие положения

В настоящем приложении представлен общий подход к рекомендуемым методам сжатия данных сигнала SCP-ECG. Принципы методологии сжатия вначале представлены в форме различных диаграмм (раздел С.2). Затем приводится более детальное описание рекомендуемой методологии сжатия и распаковки данных вместе с соответствующими математическими определениями (см. разделы С.3 и С.4). В заключение приведено описание набора тестов для испытания соответствия (см. раздел С.5).

Для оценки ошибок распаковки при применении данных методов сжатия ЭКГ, а также для тестирования абсолютной точности реализации сжатия был разработан общедоступный набор тестов. Он полезен для подтверждения соответствия и тестирования производительности.

С.2 Принципы «ВЫСОКОГО» сжатия данных SCP-ECG

С.2.1 Исходная ЭКГ — «необработанные данные»

- а) Выделить опорные точки во всех комплексах ЭКГ, например, время QRSmax или какой-либо иной маркер:
- опорные точки для вычитания эталонного цикла (см. fc1—fc7 на рисунке С.1).
б) Идентифицировать типы комплексов ЭКГ, например нормальный тип, различные экстрасистолы:
- QRS-тип 0, 1 и т. д.

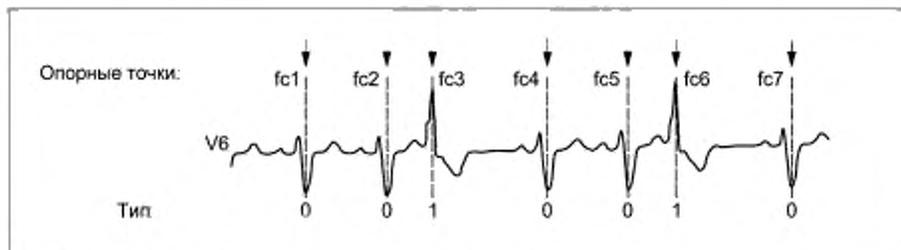


Рисунок С.1 — Пример необработанных данных, опорных точек и типизации QRS

С.2.2 Эталонный цикл 0

- а) Вычислить «Эталонный цикл типа 0», например, репрезентативный усредненный цикл, медианный цикл, модальный цикл.
б) Идентифицировать точки начала и завершения зубцов эталонного цикла 0 (см. рисунок С.2):
- длина вычитаемого эталонного цикла 0;
- указатели на сегменты данных QRS (см. рисунки С.3 и С.4), которые должны быть защищены от фильтрации и прореживания.

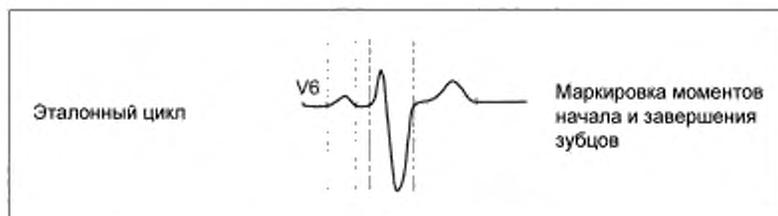


Рисунок С.2 — Пример эталонного цикла

С.2.3 Остаточная запись

Вычлесть эталонный цикл типа 0 из всех комплексов ЭКГ типа 0, используя опорные точки (см. рисунок С.3).

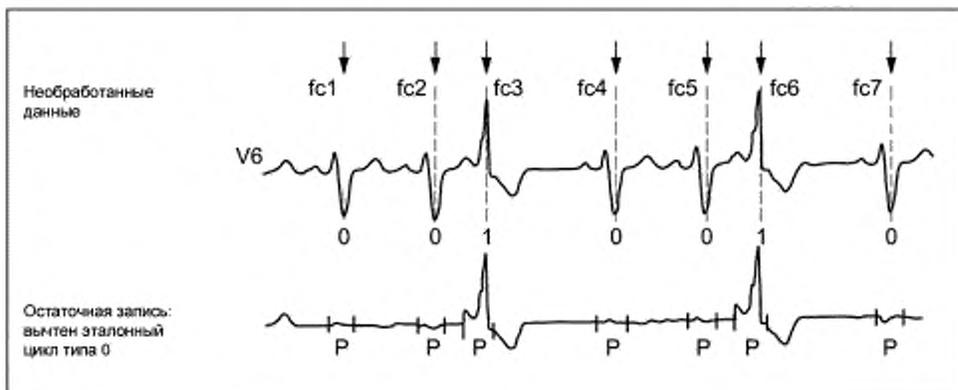


Рисунок С.3 — Пример остаточной записи

С.2.4 Сжатые данные

- Низкочастотная фильтрация остаточной записи (исключая защищенные области *p*).
- Прореживание считываний от 2 до 8 мс (исключая защищенные области *p*).
- Вычисление последовательных разностей второго порядка для всех результирующих данных (см. рисунок С.4).

С.4).

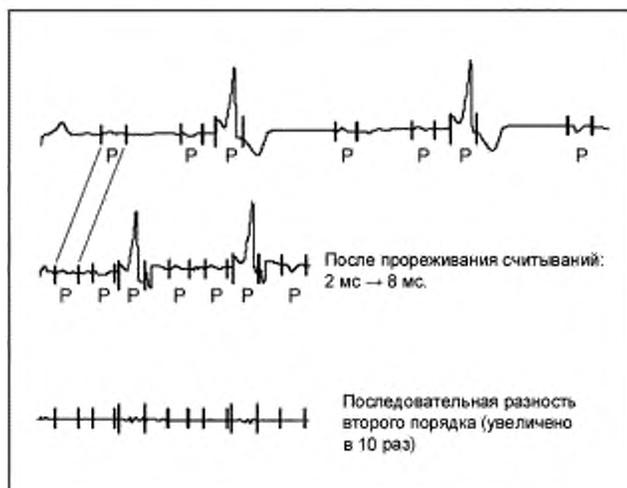


Рисунок С.4 — Пример сжатия остаточных данных

С.2.5 Кодирование

Далее последовательные разности второго порядка кодируются методом Хаффмана, см. численные примеры.

С.2.6 Распаковка данных SCP-ECG

Для распаковки данных ЭКГ, как правило, выполняются в обратном порядке шаги, применяемые для сжатия. Если используется «высокое сжатие», то для остаточной записи и репрезентативного цикла 0 должны выполняться шаги (а) и (b), описанные ниже. Шаги (с) и (d) применимы только к остаточной записи, в то время как (е) и (f) применимы и к репрезентативному циклу 0, и к остаточной записи.

Ниже приведены шаги распаковки:

- декодирование с применением таблиц Хаффмана;
- восстановление данных из разностей первого или второго порядка;

- с) воссоздание прореженных считываний;
 d) низкочастотная фильтрация воссозданной остаточной записи за пределами защищенных областей;
 e) умножение на AVM (модификатор значения амплитуды);
 f) в случае высокого сжатия: сложение эталонного цикла 0 с остаточной записью во всех местах комплекса типа 0. Для этого должны использоваться хранящиеся указатели $fc(k)$, $SB(k)$ и $SE(k)$ остаточной записи и fcM эталонного цикла 0.

Шаги с С.2.1 по С.2.6 подробно рассмотрены в разделах С.3 и С.4.

С.3 Уравнения для сжатия данных SCP-ECG

С.3.1 Определения

С.3.1.1 Необработанные данные

Элементы необработанных данных: $X_r(m, n)$

Нижний индекс r : необработанные данные

Отведение: m ; $1 \leq m \leq M$

Считывание: n ; $1 \leq n \leq N$

Дискретизация амплитуды: LSB [мкВ] = $AVM \cdot 10^{-3}$

(AVM , множитель значения амплитуды, указанный в разделе 6, байты заголовка 1, 2.)

Интервал между считываниями: SI [мс] = $STM \cdot 10^{-3}$

(STM , множитель времени считываний, указанный в разделе 6, байты заголовка 3, 4.)

С.3.1.2 Связь номера и времени считывания

a) По определению: первое считывание ($n = 1$) выполняется в момент $t = 0$.

b) Интервал между считываниями (SI) 2 мс указан как минимальное требование для данных, совместимых с SCP-ECG.

с) При $SI = 2$ мс связь между считыванием n и временем t записи имеет вид

$$t = (n - 1) \cdot SI[\text{мс}] = 2(n - 1)[\text{мс}].$$

С.3.1.3 Примеры деноминации и индексирования данных ЭКГ

С.3.1.3.1 Необработанные данные

Отведения I, II, V1, ..., V6 → $M = 8$.

Длина записи 10 с, интервал между считываниями 2 мс.

Число считываний → $N = 5000$

Отведение I: $X_r(1,1), X_r(1,2), \dots, X_r(1,n), \dots, X_r(1,5000)$

Отведение II: $X_r(2,1), X_r(2,2), \dots, X_r(2,n), \dots, X_r(2,5000)$

Отведение V1: $X_r(3,1), X_r(3,2), \dots, X_r(3,n), \dots, X_r(3,5000)$

Отведение V6: $X_r(8,1), X_r(8,2), \dots, X_r(8,n), \dots, X_r(8,5000)$

С.3.1.3.2 Эталонный цикл

Отведения I, II, V1, ..., V6 → $M = 8$.

Длина записи 1 с, интервал между считываниями 2 мс.

Число считываний → $p = 500$

Отведение I: $Y_r(1,1), Y_r(1,2), \dots, Y_r(1,n), \dots, Y_r(1,5000)$

Отведение II: $Y_r(2,1), Y_r(2,2), \dots, Y_r(2,n), \dots, Y_r(2,5000)$

Отведение V1: $Y_r(3,1), Y_r(3,2), \dots, Y_r(3,n), \dots, Y_r(3,5000)$

Отведение V6: $Y_r(8,1), Y_r(8,2), \dots, Y_r(8,n), \dots, Y_r(8,5000)$

Примечание — Данные (потенциалы V) для отведений III, aVR, aVL и aVF могут быть вычислены по формуле Эйнтховена и Голдберга, согласно которой:

$$III = I - I = V_F - V_L, \quad V_{aVR} = \frac{-(I + II)}{2} = \frac{2V_R - V_L - V_F}{2},$$

$$V_{aVL} = I - \frac{II}{2} = \frac{2V_L - V_R - V_F}{2}, \quad V_{aVF} = II - \frac{I}{2} = \frac{2V_F - V_L - V_R}{2}.$$

С.3.1.4 Указатели

С.3.1.4.1 Необработанные данные

Указатель на опорную точку цикла k в необработанных данных (число комплексов QRS в необработанных данных): $fc(k)$.

С.3.1.4.2 Эталонный цикл

Указатель на опорную точку в данных эталонного цикла (опорной точкой может быть пространственный максимум, начало QRS-комплекса или любая другая точка QRS-комплекса):

fcM .

Указатель на начало зубца P в данных эталонного цикла:

PBM.

Указатель на завершение зубца Р в данных эталонного цикла:	PEM.
Указатель на начало QRS-комплекса в данных эталонного цикла:	QBM.
Указатель на окончание QRS-комплекса в данных эталонного цикла:	QEM.
Указатель на окончание зубца Т в данных эталонного цикла:	TEM.
С.3.1.4.3 Остаточная запись	
Указатель на начало вычитания эталонного цикла 0 для цикла k в необработанных данных:	SB(k).
Указатель на окончание вычитания эталонного цикла 0 для цикла k в необработанных данных:	SE(k).
Указатель на начало защищенной области комплекса k в необработанных данных и в остаточных данных:	QB(k).
Указатель на завершение защищенной области комплекса k в необработанных данных и в остаточных данных:	QE(k).

Примечание — Указатели QB(k), QE(k) явно хранятся в записи SCP-ECG, раздел 4 (см. 5.7.5). Защищенная область включает в себя интервал от начала до завершения QRS-комплекса, но он может превышать его (например, из-за границ прореженных N-считываний, см. С.3.4.2). Начало и завершение QRS-комплекса могут быть вычислены по значению опорной точки fcM эталонного цикла 0, длительности его QRS-комплекса и интервалов bM и eM (см. С.3.3.1), а также по значениям опорных точек $fc(k)$ для каждого цикла.

$$QRSonset(k) = fc(k) - bM,$$

$$QRSoffset(k) = fc(k) - eM,$$

где $QRSonset$ — начало комплекса QRS, а $QRSoffset$ — его завершение.

С.3.2 Огрубление всех значений до разрешения 5 мкВ

С.3.2.1 Общие положения

При дискретизации амплитуды (разрешение, точность) необработанных данных и данных эталонного цикла младший значащий бит (LSB) должен иметь значение ≤ 5 мкВ. Следующие уравнения описывают округление данных до 5 мкВ/LSB в предположении, что исходные данные записываются с разрешением 1 мкВ/LSB.

Примечания

1 Не все компиляторы одинаково обрабатывают округление и огрубление. При разработке программы, выполняющей сжатие, необходимо обеспечить правильное выполнение округления положительных и отрицательных чисел. Например, в процессорах Intel округление всегда направлено к нулю, т. е. $-9/5 = -1,8$ округляется до -1 . Напротив, при вычислениях со смещением двоичного числа результат округления будет эквивалентен -2 .

2 Индекс t : огрубленные данные.

С.3.2.2 Необработанные данные

$$X_1(m, n) = \frac{X_t(m, n) + 2}{5} \text{ для } X_t(m, n) \geq 0,$$

$$X_1(m, n) = \frac{X_t(m, n) - 2}{5} \text{ для } X_t(m, n) < 0.$$

С.3.2.3 Данные эталонного цикла

$$Y_1(m, p) = \frac{X_t(m, p) + 2}{5} \text{ для } Y_t(m, p) \geq 0,$$

$$Y_1(m, p) = \frac{X_t(m, p) - 2}{5} \text{ для } Y_t(m, p) < 0.$$

С.3.3 Вычитание эталонного цикла из необработанных данных сигнала

С.3.3.1 Общие положения

Протокол SCP-ECG спроектирован для обработки данных сигнала ЭКГ, которые могут подвергаться сжатию и кодированию различными методами:

a) только сокращение избыточности;

b) «высокое сжатие» при помощи «эталонного цикла 0», кодируемого отдельно; он может быть вычтен из необработанных данных и остаточные данные могут быть отфильтрованы, считывания прорежены и т. д.

Далее подробно описаны вычисление и спецификация остаточной записи в случае, когда применяется метод b), описанный выше как схема «высокого сжатия».

С.3.3.2 Огрубленные необработанные данные

Пусть имеются огрубленные необработанные данные отведения V6 с выделенными комплексами ЭКГ (опорные точки $fc(k)$), показанные на рисунке С.5.

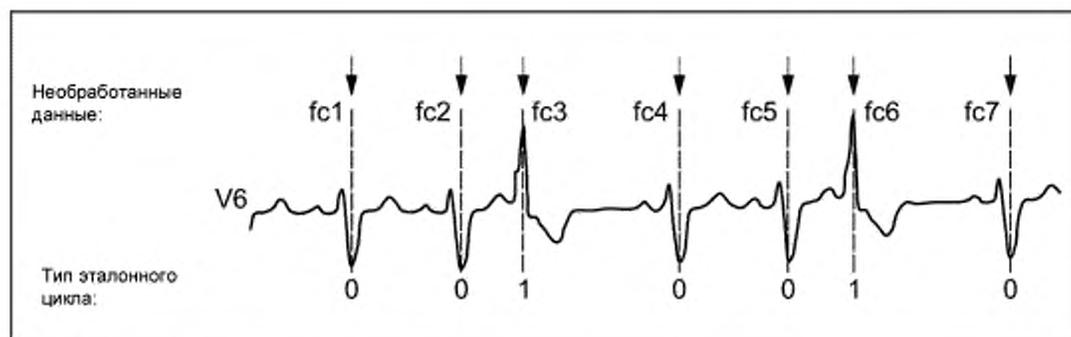


Рисунок С.5 — Пример необработанных данных и опорных точек с указанием типов QRS

В таблице С.1 приведены местоположения и типы комплексов QRS, выделенных в необработанных данных, показанных на рисунке С.5 в диапазоне от $t = 0$ до $t = 5$ с (считывания от 1 до 2500).

Таблица С.1 — Местоположения и типы комплексов QRS

Считывание	Указатель	Тип QRS	Данные
1			$X(t(m,1))$
2			$X(t(m,2))$
333	fc1	0	$X(t(m,333))$
675	fc2	0	$X(t(m,675))$
840	fc3	1	$X(t(m,840))$
1357	fc4	0	$X(t(m,1357))$
1702	fc5	0	$X(t(m,1702))$
1869	fc6	1	$X(t(m,1869))$
2373	fc7	0	$X(t(m,2373))$
5000			$X(t(m,5000))$

С.3.3.3 Вычисление остаточных данных

С.3.3.3.1 Совместите («синхронизируйте») опорную точку fcM данных эталонного цикла 0 с каждой из опорных точек $fc1, fc2, \dots, fc(k)$ комплексов необработанных данных цикла типа 0. См. рисунок С.6.

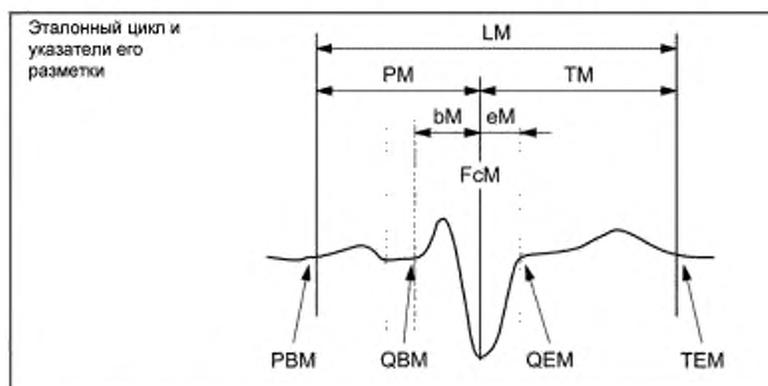


Рисунок С.6 — Пример эталонного цикла и указателей его разметки

В таблице С.2 представлены непосредственные места размещения указателей и формула для их вычисления по данным записи SCP-ECG.

Таблица С.2 — Непосредственные места размещения указателей

Указатель	Подраздел	Раздел	Байт	Непосредственное хранение	Вычисление
LM	5.10.4	7		Нет	TEM-PBM
PM	5.7.3/5.10.4	4,7		Нет	fcM-PBM
TM	5.7.3/5.10.4	4,7		Нет	TEM-fcM
BM	5.7.3/5.10.4	4,7		Нет	fcM-QBM
EM	5.7.3/5.10.4	4,7		Нет	QEM-fcM
FcM	5.7.3	4	3, 4	Да	
PBM	5.10.4	7	1, 2	Да	
PEM	5.10.4	7	3, 4	Да	
QBM	5.10.4	7	5, 6	Да	
QEM	5.10.4	7	7, 8	Да	
TEM	5.10.4	7	9, 10	Да	

С.3.3.3.2 Вычитание каждого считывания данных эталонного цикла из необработанных данных в соответствующем месте цикла $fc(k)$.

Примечание — Длина сегмента данных, который необходимо вычесть, не обязательно является полной длиной LM эталонного цикла. К тому же в необработанных данных она может изменяться от цикла к циклу. Чтобы это учесть, в разделе 4 протокола SCP-ECG (см. 5.7.4) байты с 3 по 6 зарезервированы для хранения указателей начала вычитания данных эталонного цикла. Байты с 11 по 14 зарезервированы для хранения конца вычитания данных эталонного цикла для каждого цикла соответственно.

С.3.3.3.3 Из практических соображений удобнее всего постоянно вычитать данные «полного» эталонного цикла от PBM до TEM (данный сегмент имеет длину LM). Указатели на начало и конец вычитания данных эталонного цикла для цикла k вычисляются по следующим формулам:

$$SB(k) = fc(k) - PM,$$

$$SE(k) = fc(k) - TM.$$

Эти указатели должны использоваться во время процедуры вычитания и должны храниться в поле данных QRS, описанном в разделе 4.

Примечание — Вычитание эталонного цикла («нормального» типа 0) не является эффективным, если цикл необработанных данных имеет другой тип, например, является экстрасистолой (тип 1). Тем не менее сегменты данных QRS экстрасистол также должны быть защищены от низкочастотной фильтрации и прореживания считываний.

С.3.3.3.4 Данные, остающиеся после вычитания эталонного цикла во всех подходящих местах комплекса $fc(k)$, называются остаточной записью.

С.3.4 Низкочастотная фильтрация

С.3.4.1 Низкочастотная фильтрация остаточной записи эффективно повышает коэффициент сжатия. Так как высокочастотные компоненты, как правило, можно встретить только в QRS, все сегменты данных за исключением тех, где были размещены комплексы QRS, могут быть отфильтрованы и подвергнуты прореживанию считываний.

С.3.4.2 Указатели на защищенный сегмент данных цикла k вычисляются следующим образом:

$$QB(k) = ORSonset(k) - eB(k),$$

$$QE(k) = ORSoffset(k) + eE(k).$$

Если глобальные измерения эталонного цикла (см. 5.10.4) представлены для типа цикла k , то указатели на QRSonset и QRSoffset вычисляются следующим образом:

$$\text{QRSonset}(k) = fc(k) - bM,$$

$$\text{QRSoffset}(k) = fc(k) - eM,$$

где bM обозначает интервал от опорной точки fcM до начала QRS эталонного цикла, а eM — это интервал от fcM до завершения QRS. Значения bM и eM могут быть вычислены по местоположению опорной точки эталонного цикла (хранится в байтах 3, 4 раздела 4, см. 5.7.3) и указателей на начало и завершение QRS (хранятся в байтах 5, 6, 7, 8 раздела 7, см. 5.10.4).

Значения $eB(k)$ и $eE(k)$ в уравнениях являются поправками к сегменту защищенных данных, предотвращающими проблемы, связанные с прореживанием/восстановлением считываний. Практическим решением является определение таких границ QB и QE , чтобы интервал прореживания считываний между циклом $k-1$ и циклом k [$QB(k) - QE(k-1) - 1$] являлся бы кратным интервалу считываний остаточной записи.

Таким образом, $QB(k)$ может быть сокращен на значение $eB(k)$ (от 0 до коэффициента снижения частоты -1), чтобы учесть потребность в сохранении кратности предшествующего незащищенного интервала коэффициенту снижения частоты. Более того, указатель $QE(k)$ последнего комплекса может быть увеличен на значение $eE(k)$ (от 0 до коэффициента снижения частоты -1), чтобы учесть необходимость в сохранении кратности последнего незащищенного интервала коэффициенту снижения частоты. Опорные точки $eB(k)$ или $eE(k)$ могут дополнительно быть уменьшены или увеличены на значения, кратные коэффициенту снижения частоты, чтобы обеспечить «запас надежности» от возможных ошибок в местах начала и завершения QRS.

С.3.4.3 Простой нерекурсивный фильтр, работающий по принципу «скользящего среднего», дает приемлемые результаты низкочастотной фильтрации остаточной записи. Длина фильтра L составляет 9 считываний.

Для нечетной длины фильтра L фильтруемые значения вычисляются следующим образом:

$$F(m, a) = X(m, a);$$

$$F(m, a+1) = \frac{X(m, a) + X(m, a+1) + X(m, a+2) + 1}{3};$$

$$F(m, a+2) = \frac{X(m, a) + X(m, a+1) + X(m, a+2) + X(m, a+3) + X(m, a+4) + 2}{5};$$

$$F(m, a+3) = \dots;$$

$$F(m, n) = \frac{X\left\{m, n - \left\lfloor \frac{L-1}{2} \right\rfloor\right\} + \dots + X(m, n) + \dots + X\left\{m, n + \left\lfloor \frac{L-1}{2} \right\rfloor\right\} + \frac{L-1}{2}}{L};$$

$$X(m, b-3) = \dots;$$

$$F(m, b-2) = \frac{X(m, b-4) + X(m, b-3) + X(m, b-2) + X(m, b-1) + X(m, b) + 2}{5};$$

$$F(m, b-1) = \frac{X(m, b-2) + X(m, b-1) + X(m, b) + 1}{3};$$

$$F(m, b) = X(m, b).$$

Примечание — Методы округления определены в С.3.2.2 и С.3.2.3. Константы округления 1, 2, ..., $(L-1)/2$ в следующих уравнениях фильтра должны быть отрицательными, если фильтруемые значения отрицательны.

После вычитания эталонного цикла типа 0 могут потребоваться дополнительные отступы в остаточных данных на границах зон вычитания $SB(k)$ и $SE(k)$. Эти отступы не должны фильтроваться, чтобы их можно было воспроизвести в восстановленных остаточных данных.

Существует три интервала фильтрации, a и b для каждого комплекса k и один дополнительный от конца комплекса K до конца потока данных.

1) От конца вычитания эталонного цикла типа 0 из предшествующего комплекса ($k-1$) до начала вычитания из текущего комплекса k :

$$a = SE(k-1) + 1, \quad SE(0) = 0,$$

$$b = SB(k) - 1.$$

2) От начала вычитания эталонного цикла типа 0 из текущего комплекса k до начала QRS текущего комплекса k :

$$a = SB(k),$$

$$b = SB(k-1).$$

3) От начала QRS текущего комплекса k до конца вычитания эталонного цикла типа 0 из текущего комплекса k .

$$a = QE(k) + 1,$$

$$b = SE(k).$$

4) Интервал фильтрации для остающихся считываний до конца данных:

$$a = SE(K) + 1,$$

$$b = N,$$

где m — номер отведения;

n — номер считывания;

K — число комплексов QRS;

N — номер последнего считывания;

k — номер комплекса QRS;

указатель на начало вычитания эталонного цикла типа 0 для цикла (k) в необработанных данных: SB(k);

указатель на конец вычитания эталонного цикла типа 0 для цикла (k) в необработанных данных: SE(k);

указатель на начало защищенной области комплекса (k) в необработанных и в остаточных данных: QB(k);

указатель на конец защищенной области комплекса (k) в необработанных и в остаточных данных: QE(k).

С.3.5 Прореживание считываний

К «медленно изменяющимся» данным наряду с низкочастотной фильтрацией может быть применено прореживание считываний. Для остаточной записи протокол SCP-ECG определяет минимальную частоту считываний 125 считываний/с, что равносильно интервалу между считываниями 8 мс.

Прореживание считываний разрешается только за пределами защищенных сегментов данных QRS. В SCP прореживание считываний именуется «бимодальным сжатием».

Для прореживания считываний применяется усредняющий алгоритм. Он отличается от прореживания считываний с последующим усреднением четырех считываний.

Для реализации SCP-ECG производители могут выбрать метод прореживания считываний, а именно усреднение или пропуск считываний. Следует отметить, что лучшие результаты получаются, если алгоритмы сжатия и распаковки согласованы между собой.

Хотя настоящий стандарт не требует никакого конкретного метода прореживания и восстановления, на границах зон вычитания в процессе восстановления могут возникнуть переходные эффекты, если не были выполнены определенные требования. Поэтому SCP-ECG рекомендует использовать следующие границы вычитания эталонного цикла типа 0:

- поместить SB(k) в начале интервала прореженных считываний (например, считывания 1, 5, 9, 13, 17, 21, ...);

- поместить SE(k) в конце интервала прореженных считываний (например, считывания 4, 8, 12, 16, 20, ...).

Если эти условия выполнены, то нет необходимости знать, какой алгоритм прореживания используется во избежание переходных состояний на границах зон вычитания во время восстановления.

Интервал считываний 8 мс является максимальным разрешенным для остаточной записи в SCP-ECG. Поэтому наименьшая эффективная частота считываний для остаточной записи составляет 125 считываний/с. Признак бимодального сжатия указан в 5.9.3, байт 6.

Чтобы избежать проблем восстановления при прореживании считываний, практическим решением является задание таких границ QB и QE, при которых интервал прореживания считываний между циклом $k - 1$ и циклом k ($= QB(k) - QE(k - 1) - 1$) является кратным интервалу между считываниями в остаточной записи.

В обновлении указателей начала и конца защищенной области после прореживания считываний нет необходимости, так как они находятся внутри остаточной записи, а не в остаточной записи, прореженной считываниями (см. спецификацию раздела 4 в 5.7).

Не существует никакого универсального алгоритма для восстановления прореженных считываний. Выбор способа выполнения восстановления (интерполяция или повторение считываний) оставлен на усмотрение производителей. Однако среднеквадратичная ошибка и абсолютные отклонения восстановления между исходной и распакованной ЭКГ должны быть проверяемыми на тестовом наборе SCP-ECG. Этот тестовый набор описан в С.5.

Пример фильтрации и прореживания остаточной записи, получаемой из данных ЭКГ, представлены в таблице С.3.

Таблица С.3 — Пример фильтрации и прореживания

Номер считывания	Указатель	Защищенный сегмент	Отфильтрованные данные	Прореженные данные	Комментарий
1		Нет	Да	Да	
2		Нет	Да	Да	

Окончание таблицы С.3

Номер считывания	Указатель	Защищенный сегмент	Отфильтрованные данные	Прореженные данные	Комментарий
3		Нет	Да	Да	
178	SB1	Нет	Да	Да	Начало P1
264		Нет	Да	Да	
265	QB1	Да	Нет	Нет	Начало защищенной области, первый QRS
267	QRSonset1	Да	Нет	Нет	Начало QRS, первый QRS
333	fc1	Да	Нет	Нет	Опорная точка, первый QRS
361	QE1 = QRSoffset1	Да	Нет	Нет	Конец защищенной области и завершение QRS, первый QRS
362		Нет	Да	Да	
495	SE1	Нет	Да	Да	Завершение T1
520	SB2	Нет	Да	Да	Начало P2
605		Нет	Да	Да	
606	QB2	Да	Нет	Нет	Начало защищенной области, второй QRS
609	QRSonset2	Да	Нет	Нет	Начало QRS, второй QRS
675	fc2	Да	Нет	Нет	Опорная точка, второй QRS

Примечание — QB2 не равно QRSonset2, так как в этом случае разность для прореживания считываний ($= QB2 - QE1 - 1$) была бы равна $609 - 361 - 1 = 247$ считываний, что не кратно коэффициенту прореживания считываний, равному 4. Подходящим для QB2 является считывание 606, так как $606 - 361 - 1 = 244$ считывания, что кратно этому коэффициенту.

С.3.6 Вычисление и хранение разностных данных

С.3.6.1 Общие положения

Чтобы воспользоваться взаимосвязью считываний, вместо «исходных» значений эталонного цикла и данных остаточной записи можно хранить и кодировать последовательные разности первого или второго порядка соответствующих данных. Как правило, длина слова (в битах) исходных считываний гораздо больше, чем длина последовательных разностей первого или второго порядка.

Протокол SCP-ECG оставляет за пользователем выбор того, хранить/передавать разности первого или второго порядка (или даже исходные данные) или нет. Это должно быть указано в байте 5 заголовка раздела 5 (для данных эталонного цикла) и раздела 6 (для остаточных данных) соответственно.

С.3.6.2 Вычисление последовательных разностей первого и второго порядков

Предполагается, что из остаточной записи, полученной из записи необработанных данных с N считываниями, в прореженной записи остаются Q считываний.

Эти считывания обозначаются следующим образом для отведения m :

$$Z(m,1), Z(m,2), \dots, Z(m,q), \dots, Z(m,Q).$$

Затем вычисляются разности следующим образом:

Разности первого порядка:

$$\Delta_1(m,q+1) = Z(m,q+1) - Z(m,q); q = 1, \dots, (Q-1).$$

Примечание — $\Delta_1(m,1) \equiv Z(m,1)$, где « \equiv » означает «определен как».

Разности второго порядка:

$$\Delta_2(m,q+2) = Z(m,q+2) - 2Z(m,q+1) + Z(m,q); q = 1, \dots, (Q-2).$$

Примечание — $\Delta_2(m,1) \equiv Z(m,1)$, $\Delta_2(m,2) \equiv Z(m,2)$.

Подобным же образом разности первого и/или второго порядка для эталонного цикла могут быть вычислены для данных эталонного цикла $Y_i(m,p)$.

С.3.6.3 Восстановление данных из разностей

Восстановление данных из разностей требует хранения/передачи одного (первого) исходного значения, поскольку

$$Z(m,q+1) = Z(m,q) + \Delta 1(m,q+1); q = 1, \dots, (Q-1),$$

где $Z(m,1)$ необходимо для восстановления $Z(m,2)$:

$$Z(m,2) = Z(m,1) + \Delta 1(m,2).$$

Примечание — $Z(m,1) = \Delta 1(m,1)$.

Восстановление данных из разностей второго порядка требует хранения и передачи двух исходных значений:

$$Z(m,q+2) = 2Z(m,q+1) - Z(m,q) + \Delta 2(m,q+2); q = 1, \dots, (Q-2),$$

где $Z(m,1)$ и $Z(m,2)$ являются обязательными значениями для восстановления $Z(m,3)$,

$$Z(m,3) = 2Z(m,2) - Z(m,1) + \Delta 2(m,3).$$

Примечание — $Z(m,1) = \Delta 2(m,1)$, $Z(m,2) = \Delta 2(m,2)$.

Соответствующие исходные значения должны храниться в начале кодированных данных (см. 5.8.3).

С.3.7 Кодирование записи SCP-ECG методом Хаффмана

С.3.7.1 Общие положения

Кодирование методом Хаффмана обеспечивает минимальную избыточность кодирования данных с неодинаковой вероятностью возникновения. Применяется схема кодирования, в которой наиболее часто возникающим значениям назначается самая короткая длина битового кода. А наиболее редко возникающим данным присваивается наибольшая длина битового кода. Кодирование Хаффмана заменяет данные, представленные словами, на данные, представленные битами.

С помощью таблиц Хаффмана, представленных в протоколе SCP-ECG, можно использовать полное кодирование методом Хаффмана и исходное кодирование. Если распределение длин слов в данных меняется, то можно использовать более одной таблицы Хаффмана, а также переключать разные таблицы во время кодирования в целях более эффективного сжатия.

С.3.7.2 Полное кодирование Хаффмана

При полном кодировании Хаффмана одно слово данных представляется в таблице Хаффмана «полным кодом», который хранится как «базовый код» или «префикс». Префикс должен использоваться для кодирования, а для декодирования должен использоваться базовое значение, взятое из таблицы. Длина полного кода в битах после кодирования равна длине префикса.

Пример — В таблице Хаффмана № 1 (см. таблицу С.4) код значения «0» равен 0_b в префиксе. Вся длина кода составляет 1 бит, что равносильно длине префикса. Для значения «1» префикс равен 100_b , а длина битового кода равна 3, т. е. длине префикса.

С.3.7.3 Исходное кодирование

Если значение не содержится в таблице Хаффмана, то оно должно иметь исходный код. Базовое значение в этом случае не содержит никакого приемлемого или полезного значения (должно быть «0»). Но таблица содержит информацию о числе битов «остатка» в потоке битов, который следует за префиксом. Из этого остатка должно вычисляться восстанавливаемое слово данных. Число этих битов равно разности между числом битов всего случая и префикса.

Пример — Битовый поток: 111000000101_b .

1) Сравнение битового потока с таблицей Хаффмана № 1 (см. таблицу С.4) указывает на структуру 6 для декодирования. Поэтому используются первые 4 бита, которые служат переключателем на таблицу Хаффмана № 2.

2) Для декодирования должен использоваться метод исходного кодирования, так как в таблице № 2 число битов префикса 1 (префикс 0_b) меньше длины всего кода (9 битов — 1 бит = 8 битов > 0).

3) Длина остатка равна разности между числом битов всего кода и префикса. В данном случае это 8 битов (00000101_b), используемых для восстановления слова данных.

4) Чтобы завершить слово данных (2 байта), недостающие биты должны быть заполнены значением старшего значащего бита остатка.

Пример — Восстановленное слово данных: $00000000000101_b = 5h$.

С.3.7.4 Таблицы Хаффмана, используемые в SCP-ECG

С.3.7.4.1 Общие положения

Таблицы С.4 и С.5 используются в примерах кодирования данных ЭКГ.

С.3.7.4.2 Структура таблиц Хаффмана

Таблица Хаффмана № 1 содержит семь структур. Из них пять структур используются для полного кодирования Хаффмана, одна — для 8-битового исходного кодирования и одна — для смены таблицы на таблицу № 2. Значения не более 2 кодируются с помощью полного кодирования Хаффмана. Значения более 2 кодируются с помощью исходного кодирования. В этом случае первые 4 бита из 12 битов полного кода являются префиксом (1111₂). Следующие 8 битов являются остатком.

Если третий байт (переключатель таблиц) структуры (в данном случае номер 6) равен 0, то это указывает, что текущую таблицу Хаффмана необходимо сменить на таблицу, номер которой указан в базовом значении. В данном случае префикс смены таблиц равен 1110₂, а номер новой таблицы равен 2.

Таблица С.4 — Таблица Хаффмана № 1

Номер кодовой структуры	Число битов		Режим таблицы	Базовое значение	Код префикса (в битах)
	Полный код	Префикс			
1	1	1	1	0	0
2	3	3	1	1	100
3	3	3	1	- 1	101
4	4	4	1	2	1100
5	4	4	1	- 2	1101
6	4	4	0	2 (перейти к таблице № 2)	1110
7	12	4	1	Запись отсутствует (0), 8-битовый оригинал	1111

Таблица Хаффмана № 2 содержит пять структур. Из них три структуры используются для полного кодирования Хаффмана, одна — для 8-битового исходного кодирования и одна — для смены таблицы на таблицу № 1. Значения не более 1 кодируются с помощью полного кодирования Хаффмана. Значения более 1 кодируются с помощью исходного кодирования. Первый бит 9-битового кода является префиксом.

Если третье поле (переключатель таблиц) структуры (в данном случае номер 5) равно 0, то это означает, что фактическую таблицу Хаффмана необходимо сменить на таблицу, номер которой указан в базовом значении. В данном случае префикс для смены таблиц равен 111₂, а номер новой таблицы равен 1.

Таблица С.5 — Таблица Хаффмана № 2

Номер кодовой структуры	Число битов		Режим таблицы	Базовое значение	Код префикса (в битах)
	Полный код	Префикс			
1	9	1	1	Запись отсутствует (0), 8-битовый оригинал	0
2	3	3	1	0	100
3	3	3	1	1	101
4	3	3	1	- 1	110
5	3	3	0	1 (перейти к таблице № 1)	111

С.3.7.4.3 Таблицы Хаффмана без переключателя таблиц

Рассмотрим пример следующей последовательности байт-ориентированных данных:

1, 2, - 1, 0, 3, 0, 4, 1, 0, - 2,

0, 15, - 1, 0, 13, 0, 1, - 2, - 1, 1.

Эти данные должны кодироваться с помощью таблицы Хаффмана № 1. Для каждого значения данных выбирается соответствующий битовый код из таблицы Хаффмана и соединяется с битовым потоком. Если значение не обнаружено в таблице, то оно должно кодироваться с помощью исходного кодирования, как описано выше.

Таблица С.6 — Соответствие значений байтовых данных и битов кода Хаффмана

Номер	Значение	Полный код	Комментарии
1	1	100	3-битовый префикс, без остатка
2	2	1100	4-битовый префикс, без остатка
3	- 1	101	3-битовый префикс, без остатка
4	0	0	1-битовый префикс, без остатка
5	3	111100000011	4-битовый префикс, 8-битовый остаток
6	0	0	1-битовый префикс, без остатка
7	4	111100000100	4-битовый префикс, 8-битовый остаток
8	1	100	3-битовый префикс, без остатка
9	0	0	1-битовый префикс, без остатка
10	- 2	1101	4-битовый префикс, без остатка
11	0	0	1-битовый префикс, без остатка
12	15	111100001111	4-битовый префикс, 8-битовый остаток
13	- 1	101	3-битовый префикс, без остатка
14	0	0	1-битовый префикс, без остатка
15	13	111100001101	4-битовый префикс, 8-битовый остаток
16	0	0	1-битовый префикс, без остатка
17	1	100	3-битовый префикс, без остатка
18	- 2	1101	4-битовый префикс, без остатка
19	- 1	101	3-битовый префикс, без остатка
20	1	100	3-битовый префикс, без остатка

Полученный поток битов:

100110010101111000000110111100000100100011010111100001111101011110000110101001101101100

С.3.7.4.4 Таблицы Хаффмана с переключением таблиц

Для более эффективного сжатия можно кодировать данные с помощью нескольких таблиц Хаффмана. Например, разумным является кодирование эталонного цикла и остаточной записи с помощью разных таблиц или переключаться на другую таблицу в процессе кодирования, если вероятность появления значений данных со временем изменилась.

Пусть, например, извлечена следующая последовательность байт-ориентированных значений данных (включая объявления переключения):

1, 2, - 1, 0, 3, 0, 4, 1, 0, - 2, переключение на таблицу 2,

0, 15, - 1, 0, 13, переключение на таблицу 1, 0, 1, - 2, - 1, 1.

Кодирование начинается с таблицы Хаффмана № 1. После 10-го значения для кодирования используется таблица Хаффмана № 2, а после кодирования 16-го значения снова используется таблица № 1.

Соответствие байт-ориентированных значений данных и битовых кодов Хаффмана см. в таблице С.7.

Таблица С.7 — Соответствие значений байтовых данных и битов кода Хаффмана

Номер	Значение	Полный код	Таблица	Переключатель таблиц (ПТ)	Комментарии
1	1	100	1	1	3-битовый префикс, без остатка
2	2	1100	1	1	4-битовый префикс, без остатка
3	- 1	101	1	1	3-битовый префикс, без остатка
4	0	0	1	1	1-битовый префикс, без остатка
5	3	111100000011	1	1	4-битовый префикс, 8-битовый остаток
6	0	0	1	1	1-битовый префикс, без остатка
7	4	111100000100	1	1	4-битовый префикс, 8-битовый остаток
8	1	100	1	1	3-битовый префикс, без остатка
9	0	0	1	1	1-битовый префикс, без остатка
10	- 2	1101	1	1	4-битовый префикс, без остатка
11	(2)	1110	1	0	4-битовый префикс → таблица № 2
12	0	100	2	1	3-битовый префикс, без остатка
13	15	000001111	2	1	1-битовый префикс, 8-битовый остаток
14	- 1	110	2	1	3-битовый префикс, без остатка
15	0	100	2	1	3-битовый префикс, без остатка
16	13	000001101	2	1	1-битовый префикс, 8-битовый остаток
17	(1)	111	2	0	3-битовый префикс → таблица № 1
18	0	0	1	1	1-битовый префикс, без остатка
19	1	100	1	1	3-битовый префикс, без остатка
20	- 2	1101	1	1	4-битовый префикс, без остатка
21	- 1	101	1	1	3-битовый префикс, без остатка
22	1	100	1	1	3-битовый префикс, без остатка

Обозначения
«→ таблица №» — переключение на таблицу №;
() означают, что число не будет перемещено из базового значения в поле восстановленных данных.

Результирующий поток битов:

100110010101111000000110111100000100100011011110

1000000011111010000000110111101001101101100

С.3.7.5 Определение и хранение таблиц Хаффмана в разделе 2

В целях объяснения того, как таблицы Хаффмана (для базового кода/префикса см. примечание 1) должны храниться в разделе 2, в таблицах С.6 и С.7 представлен общий вид их расположения в стиле, использованном в основном документе протокола SCP-ECG. См. таблицу С.8.

Таблица С.8 — Пример хранения двух таблиц Хаффмана в разделе 2

Заголовок раздела:	CRC	ID	Длина	Зарезервировано
	2 ^{a)}	2	4	8

Число таблиц:

2

2

Число структур:

7 (в первой таблице)

2

Структура 1	1	1	1	0	0
Структура 2	3	3	1	1	1
Структура 3	3	3	1	- 1	5
Структура 4	4	4	1	2	3
Структура 5	4	4	1	- 2	11
Структура 6	4	4	0	2	7
Структура 7	4	12	1	0	15

а) для каждой структуры

1	1	1	2	4
---	---	---	---	---

Число структур:

5 (во второй таблице)

2

Структура 1	1	9	1	0	0
Структура 2	3	3	1	0	1
Структура 3	3	3	1	1	5
Структура 4	3	3	1	- 1	3
Структура 5	3	3	0	1	7

а) для каждой структуры

1	1	1	2	4
---	---	---	---	---

Примечания

1 Первый бит базового кода/префикса в коде представлен младшим значащим битом 4-байтовой области. Это означает, что код хранится в 4-байтовом поле с обратным порядком битов. Таким образом, код 100_b (десятичное 4) хранится как 1_b (десятичное 1), код 1100_b (десятичное 12) как 0011_b (десятичное 3) и т. д. Для понимания необходимо сравнить два последних столбца в таблице Хаффмана по умолчанию (таблица С.9 — см. С.3.7.6).

2 Числа, выделенные курсивом, указывают длину соответствующих полей в байтах.

С.3.7.6 Определение таблицы Хаффмана по умолчанию в SCP-ECG

Теоретически для разных наборов данных ЭКГ могут требоваться разные кодовые таблицы Хаффмана. Однако в результате широких экспериментов с различными наборами данных было выявлено, что следующая таблица Хаффмана может использоваться практически для всех типов данных ЭКГ без особых потерь в эффективности сжатия.

Если, с другой стороны, производитель хочет применять разные таблицы к разным ЭКГ (наборам данных ЭКГ), то он может определить свои таблицы в разделе 2 протокола SCP-ECG.

Таблица С.9 является таблицей Хаффмана по умолчанию в SCP-ECG, упомянутой в 5.5.4, байты 1, 2. Она использовалась для кодирования данных, приведенных в примерах 1 и 2 соответственно в С.4.1 и С.4.2.

Таблица С.9 — Таблица Хаффмана по умолчанию в SCP-ECG

Номер кодовых структур	Число битов		Переключе- ние таблицы	Базовое значение	Код префикса (в битах)	Хранится в двоичном виде как
	Полный код	Префикс				
1	1	1	1	0	0	0d
2	3	3	1	1	100	1d
3	3	3	1	-1	101	5d
4	4	4	1	2	1100	3d
5	4	4	1	-2	1101	11d
6	5	5	1	3	11100	7d
7	5	5	1	-3	11101	23d
8	6	6	1	4	111100	15d
9	6	6	1	-4	111101	47d
10	7	7	1	5	1111100	31d
11	7	7	1	-5	1111101	95d
12	8	8	1	6	11111100	63d
13	8	8	1	-6	11111101	191d
14	9	9	1	7	111111100	127d
15	9	9	1	-7	111111101	383d
16	10	10	1	8	1111111100	255d
17	10	10	1	-8	1111111101	767d
18	18	10	1	8-битовый оригинал	1111111110	511d
19	26	10	1	16-битовый оригинал	1111111111	1023d

Чтобы идентифицировать переключение на другую таблицу Хаффмана, следует использовать ПТ (см. в основном документе пункт 5.6.4, байт 7). Этот переключатель должен быть вставлен в поток данных, кодируемый по Хаффману. Он идентифицирует смену таблицы Хаффмана. Новая таблица Хаффмана, которая должна использоваться для декодирования данных, идентифицирована в соответствующей структуре (см. 5.6.4, байты 8, 9 в основном документе).

С.3.8 Декодирование сжатых ЭКГ данных

С.3.8.1 Общие положения

Для логически согласованного описания сжатия и распаковки используется одинаковая нотация для переменных и индексов. Имена переменных и индексов, используемых в алгоритме распаковки, дополнены знаком штриха (').

Пример — Сжатие: $X(m,n)$, $Z(m,q)$, $\Delta 1(m,q)$ и т. д.; распаковка: $X'(m,n)$, $Z'(m,q)$, $\Delta 1'(m,q)$ и т. д.

С.3.8.2 Декодирование с помощью таблиц Хаффмана

Декодирование данных, закодированных методом Хаффмана, осуществляется следующим образом.

Выбирается первый бит из битового потока каждого закодированного отведения и сравнивается с первой таблицей Хаффмана (или с таблицей по умолчанию). Если найден совпадающий префикс, то соответствующее значение должно быть введено в поле декодированных данных. При использовании полного кодирования Хаффмана оно является соответствующим базовым значением, а при использовании исходного кодирования — значением данных, восстановленным из остатка. Длина остатка равна разнице длины всего кода и префикса. Если не обнаружено никакого совпадающего кода префикса, то выбираются первые два бита и сравниваются, если необходимо, с первыми тремя и т. д. Если код найден и значение данных введено в поле, то сравнение продолжается со следующим битом.

Если найден префикс структуры переключателя таблиц Хаффмана, то из текущей таблицы необходимо выйти. На это указывает значение переключателя, равное 0. Номер новой таблицы считывается из базового значения данной структуры. После переключения на новую таблицу декодирование может продолжаться в соответствии с данным описанием.

С.3.8.3 Восстановление из разностей первого и второго порядков

С.3.8.3.1 Общие положения

Протокол SCP-ECG оставляет на усмотрение пользователя, будет ли он хранить/передавать разности первого или второго порядка либо даже исходные данные. Тип данных указан в байте 5 заголовка раздела 5 (для эталонного цикла) и заголовка раздела 6 (для остаточной записи). Предполагается, что остаточная запись, являющаяся результатом декодирования Хаффмана, содержит всего Q значений.

С.3.8.3.2 Разности первого порядка

Обозначим считывания, декодированные по Хаффману для отведения m , следующим образом:

$$\Delta 1'(m,1), \Delta 1'(m,2), \dots, \Delta 1'(m,q), \dots, \Delta 1'(m,Q).$$

«Исходные» данные $Z'(m,n)$ могут быть вычислены по следующей формуле:

$$Z'(m,q) = Z'(m,q-1) + \Delta 1'(m,q); \quad q = 2 \text{ по } Q.$$

Восстановление «исходных» данных из разностей первого порядка требует хранения/передачи одного (первого) исходного значения данных:

$$Z'(m,1) = \Delta 1'(m,1),$$

$$Z'(m,2) = Z'(m,1) + \Delta 1'(m,2),$$

где $\Delta 1'(m,1)$ является необходимым «исходным» значением.

С.3.8.3.3 Разности второго порядка

Обозначим считывания, декодированные по Хаффману для отведения m , следующим образом:

$$\Delta 2'(m,1), \Delta 2'(m,2), \dots, \Delta 2'(m,q), \dots, \Delta 2'(m,Q).$$

«Исходные» данные $Z'(m,n)$ могут быть вычислены по следующей формуле:

$$Z'(m,q) = 2Z'(m,q-1) - Z'(m,q-2) + \Delta 2'(m,q); \quad q = 3 \text{ по } Q.$$

Восстановление «исходных» данных из разностей второго порядка требует хранения и передачи двух исходных значений:

$$Z'(m,1) = \Delta 2'(m,1),$$

$$Z'(m,2) = \Delta 2'(m,2),$$

$$Z'(m,3) = 2Z'(m,2) - Z'(m,1) + \Delta 2'(m,3),$$

где $\Delta 2'(m,1)$ и $\Delta 2'(m,2)$ являются необходимыми «исходными» значениями.

Таким же образом данные эталонного цикла $Y(m,p)$ могут быть вычислены из разностей первого и/или второго порядка эталонного цикла.

Соответствующие исходные значения должны храниться в начале кодированных данных (см. 5.8.3).

С.3.8.4 Восстановление прореженных считываний

К «медленно меняющимся» данным может применяться прореживание считываний (до максимального интервала между считываниями 8 мс, что равносильно частоте 125 считываний/с). Использование прореживания считываний называется бимодальным сжатием, его признаком служит байт 6, указанный в 5.9.3.

Не существует алгоритма для точного восстановления прореженных считываний. Лучшие результаты прореживания считываний получаются, если алгоритмы сжатия и распаковки согласованы между собой.

Следующий усредняющий алгоритм сжатия дает удовлетворительные результаты:

первое среднее значение:

$$Z_{av}(m,1) = \frac{X(m,1) + X(m,2) + X(m,3) + X(m,4)}{4},$$

второе среднее значение:

$$Z_{av}(m,2) = \frac{X(m,5) + X(m,6) + X(m,7) + X(m,8)}{4}$$

...

и для распаковки:

$$X'(m,i) = \frac{Z'_{av}(m,2) \cdot Z'_{av}(m,1)}{4} \cdot (i-1) + Z'_{av}(m,1),$$

где $1 \leq i \leq 4$.

Величина $Z'_{av}(m,1)$ является левосторонним средним значением [равна $X'(m,1)$], а величина $Z'_{av}(m,2)$ является правосторонним средним значением четырех повторно вычисленных значений интервала. Это восстановление целиком покрывает незащищенную область, a , b ($b - a$ равно числу непрореженных считываний). Первые два восстановленных считывания данной области полагаются равными первому среднему значению, а два последних считывания полагаются равными последнему среднему значению.

Интервал a , b :

$$X'(m,a) = Z'_{av}(m,a),$$

$$X'(m,a+1) = Z'_{av}(m,a).$$

Интерполяция в интервалах $(b - a - 1)/4$:

$$X'(m, b - 1) = Z'_{av}(m, (b - a)/4),$$

$$X'(m,b) = Z'_{av}(m, (b - a)/4).$$

Пример — В таблице С.10 приведен пример прореживания и восстановления 100 считываний. Для более простого представления шаги вычисления разностей и кодирования Хаффмана были опущены. Значения Z'_{av} вычисляются так, как описано выше.

Таблица С.10 — Пример прореживания и восстановления 100 считываний

Номер	Оригинал	После прореживания	Реконструкция
1	$X'(m,1)$	$Z'_{av}(m,1)$	$Z'_{av}(m,1)$
2	$X'(m,2)$		$Z'_{av}(m,1)$
3	$X'(m,3)$		$Z'_{av}(m,1)$
4	$X'(m,4)$		$Z'_{av}(m,1) + 1[Z'_{av}(m,2) - Z'_{av}(m,1)]/4$
5	$X'(m,5)$	$Z'_{av}(m,2)$	$Z'_{av}(m,1) + 2[Z'_{av}(m,2) - Z'_{av}(m,1)]/4$
6	$X'(m,6)$		$Z'_{av}(m,1) + 3[Z'_{av}(m,2) - Z'_{av}(m,1)]/4$
7	$X'(m,7)$		$Z'_{av}(m,2)$
8	$X'(m,8)$		$Z'_{av}(m,2) + 1[Z'_{av}(m,3) - Z'_{av}(m,2)]/4$
9	$X'(m,9)$	$Z'_{av}(m,3)$	$Z'_{av}(m,2) + 2[Z'_{av}(m,3) - Z'_{av}(m,2)]/4$
10	$X'(m,10)$		$Z'_{av}(m,2) + 3[Z'_{av}(m,3) - Z'_{av}(m,2)]/4$
11	$X'(m,11)$		$Z'_{av}(m,3)$
12	$X'(m,12)$		$Z'_{av}(m,3) + 1[Z'_{av}(m,4) - Z'_{av}(m,3)]/4$
.....			
93	$X'(m,93)$	$Z'_{av}(m,24)$	$Z'_{av}(m,23) + 2[Z'_{av}(m,24) - Z'_{av}(m,23)]/4$
94	$X'(m,94)$		$Z'_{av}(m,23) + 3[Z'_{av}(m,24) - Z'_{av}(m,23)]/4$
95	$X'(m,95)$		$Z'_{av}(m,24)$
96	$X'(m,96)$		$Z'_{av}(m,24) + 1[Z'_{av}(m,25) - Z'_{av}(m,24)]/4$
97	$X'(m,97)$	$Z'_{av}(m,25)$	$Z'_{av}(m,24) + 2[Z'_{av}(m,25) - Z'_{av}(m,24)]/4$
98	$X'(m,98)$		$Z'_{av}(m,24) + 3[Z'_{av}(m,25) - Z'_{av}(m,24)]/4$
99	$X'(m,99)$		$Z'_{av}(m,25)$
100	$X'(m,100)$		$Z'_{av}(m,25)$

С.3.8.5 Низкочастотная фильтрация восстановленной остаточной записи

Низкочастотная фильтрация остаточной записи, выполненная за пределами защищенных областей после восстановления прореженных считываний, «сглаживает» шум, возникший во время восстановления. Простой не-рекурсивный фильтр «скользящего среднего» дает удовлетворительную низкочастотную фильтрацию остаточной записи.

Длина фильтра составляет три считывания. Значения фильтра вычисляются следующим образом:

$$F'(m, a) = X'(m, a),$$

$$F'(m, a+1) = \frac{X'(m, a) + X'(m, a+1) + X'(m, a+2) + 1}{3},$$

$$F'(m, a+2) = \frac{X'(m, a+1) + X'(m, a+2) + X'(m, a+3) + 1}{3},$$

...

$$F'(m, n) = \frac{X'(m, n-1) + X'(m, n) + X'(m, n+1) + 1}{3},$$

...

$$F'(m, b-1) = \frac{X'(m, b-2) + X'(m, b-1) + X'(m, b) + 1}{3},$$

$$F'(m, b) = X'(m, b).$$

от $k = 0$ до K ,

$$a = QE(k) + 1, QE(0) = 0,$$

$$b = QB(k+1) - 1, QB(K+1) = N + 1,$$

$$a + 1 \leq n \leq b - 1.$$

Примечание — Методы округления определены в С.3.2.2 и С.3.2.3. Константа округления «1» в предыдущем уравнении должна быть сделана отрицательной, если фильтруемые значения отрицательны.

С.3.8.6 Умножение необработанных данных на AVM

С.3.8.6.1 Общие положения

Этот шаг означает калибровку. С этой целью данные умножаются на AVM для получения необработанных данных, а в случае высокой степени сжатия на него также умножаются остаточная запись и эталонный цикл, имеющие одинаковое разрешение.

С.3.8.6.2 Необработанные данные

$$X'_i(m, n) = X(m, n) \cdot AVM, 1 \leq n \leq N, \\ 1 \leq m \leq M.$$

С.3.8.6.3 Данные эталонного цикла

$$Y'_i(m, p) = Y(m, p) \cdot AVM, 1 \leq p \leq P, \\ 1 \leq m \leq M.$$

С.3.8.7 Добавление эталонного цикла к остаточной записи

Протокол SCP-ECG спроектирован для обработки данных, которые можно сжимать и кодировать различными методами:

- только сокращение избыточности;
- «высокое сжатие SCP-ECG».

В случае «высокого» сжатия необходимо снова добавить эталонный цикл к остаточной записи во всех тех местах, где он был вычтен во время сжатия. Поэтому эталонный цикл должен быть синхронизирован с остаточной записью в опорных точках $fc(k)$ и fcM , хранящихся в записи SCP-ECG. Указатели на защищенные зоны QRS вычисляются из хранящихся указателей. Область для добавления эталонного цикла в цикл k вычисляется по указателям $SB(k)$ (начало добавления) и $SE(k)$ (конец добавления).

Примечания

1 В разделе 4 протокола SCP-ECG (см. 5.7.4) байты с 3 по 6 зарезервированы для хранения указателей на начало добавления данных эталонного цикла $[SB(k)]$. Байты с 7 по 10 зарезервированы для хранения опорной точки цикла k $[fc(k)]$, а байты с 11 по 14 зарезервированы для хранения конца добавления данных эталонного цикла к циклу k $[SE(k)]$ для всех циклов. Добавление данных эталонного цикла в остаточную запись (по принципу считывания за считыванием) в соответствующем месте цикла $fc(k)$ позволит восстановить исходные данные считываний.

2 Если QRS имеет ненулевой тип (в байтах 1, 2, см. 5.7.4), то эталонный цикл 0 не был вычтен из цикла (см. сноску 3 5.7.4).

С.3.8.8 Параметры распаковки записи SCP-ECG по умолчанию

В алгоритме распаковки записи SCP-ECG по умолчанию используются следующие параметры:

- использование вычитания эталонного цикла (раздел 3, байт 2, бит 0 = 1);
- AVM для данных эталонного цикла = 5 мкВ (раздел 5, байты 1 + 2 = 5000);
- интервал между считываниями в данных эталонного цикла = 2 мс (раздел 5, байты 3 + 4 = 2000);
- для представления данных эталонного цикла используются разности второго порядка (раздел 5, байт 5 = 2);
- AVM для остаточной записи = 20 мкВ (раздел 6, байты 1 + 2 = 20 000);

- интервал между считываниями в остаточной записи за пределами защищенных зон (QRS) = 8 мс (раздел 6, байты 3 + 4 = 8000);
- для представления данных остаточной записи используются разности второго порядка (раздел 6, байт 5 = 2);
- интерполяция считываний осуществляется для интервала между считываниями 2 мс (алгоритм см. С.3.8.9);
- низкочастотная фильтрация, осуществляемая после интерполяции считываний, имеет длину фильтра три считывания (алгоритм см. С.3.8.10);
- для декодирования данных эталонного цикла и остаточной записи используется таблица Хаффмана (см. таблицу С.9).

С.3.8.9 Метод для интерполяции прореженных считываний по умолчанию

В сжатых данных только защищенные области имеют исходный интервал между считываниями. Чтобы восстановить исходный интервал между считываниями, области сигнала, находящиеся между защищенными областями, а также части сигнала перед первой и после последней защищенной области должны быть развернуты с помощью алгоритма интерполяции.

Удовлетворительные результаты интерполяции считываний в интервале a , b можно получить с помощью следующего алгоритма:

$Z'(m, a')$ — прореженные считывания;

$X'(m, a)$ — считывания, прошедшие интерполяцию;

m — номер отведения;

$X'(m, a) = Z'(m, a')$;

$X'(m, a + 1) = Z'(m, a')$;

$X'(m, a + 2) = Z'(m, a') \Delta = [Z'(m, a' + 1) - Z'(m, a')] / 4$;

$X'(m, a + 3) = Z'(m, a') + 1\Delta$;

$X'(m, a + 4) = Z'(m, a') + 2\Delta$;

$X'(m, a + 5) = Z'(m, a') + 3\Delta$;

$X'(m, a + 6) = Z'(m, a' + 1) \Delta = [Z'(m, a' + 2) - Z'(m, a' + 1)] / 4$;

...

$X'(m, a + 9) = Z'(m, a' + 1) + 3^* \Delta$;

...

...

...

$X'(m, b - 1) = Z'(m, b')$;

$X'(m, b) = Z'(m, b')$.

Следующие вычисления выполняются для всех сегментов данных $K + 1$, находящихся за пределами защищенных областей:

от $k = 0$ до K

$a = QE(k) + 1$ $QE(0) = 0$,

$b = QB(k + 1) - 1$ $QB(K + 1) = N + 1$.

С.3.8.10 Метод трехточечного скользящего среднего по умолчанию

Низкочастотная фильтрация восстановленной остаточной записи выполняется для сглаживания результатов округления. Она может выполняться только за пределами защищенных областей, так как внутри QRS ошибка восстановления строго ограничена 15 мкВ. Особое внимание следует уделять границам областей вычитания. После вычитания данных эталонного цикла к этим границам могли применяться смещения, которые должны быть учтены после добавления данных эталонного цикла. Поэтому они не могут быть устранены при фильтрации. Для низкочастотной фильтрации восстановленной остаточной записи достаточно эффективен описанный ниже нерекурсивный фильтр «скользящего среднего».

Длина фильтра L должна составлять три считывания. Значения фильтра для нечетной длины фильтра L вычисляются следующим образом:

$F'(m, a) = X'(m, a)$,

$F'(m, a + 1) = \frac{X'(m, a) + X'(m, a + 1) + X'(m, a + 2) + 1}{3}$,

...

$$F(m, n) = \frac{X^{(m, n - \frac{L-1}{2})} + \dots + X^{(m, n)} + \dots + X^{(m, n + \frac{L-1}{2})}}{L},$$

...

$$F'(m, b-1) = \frac{X^{(m, b-2)} + X^{(m, b-1)} + X^{(m, b)} + 1}{3},$$

$$F'(m, b) = X^{(m, b)}.$$

Существует три интервала фильтрации, a и b для каждого комплекса k и один дополнительный от конца комплекса K до конца потока данных.

1) От конца вычитания эталонного цикла типа 0 из предшествующего комплекса ($k-1$) до начала вычитания из текущего комплекса k .

$$a = SE(k-1) + 1, SE(0) = 0,$$

$$b = SB(k) - 1.$$

2) От начала вычитания эталонного цикла типа 0 из текущего комплекса k до начала QRS текущего комплекса k .

$$a = SB(k),$$

$$b = SB(k-1).$$

3) От начала QRS текущего комплекса k до конца вычитания эталонного цикла типа 0 из текущего комплекса k .

$$a = QE(k) + 1,$$

$$b = SE(k).$$

4) Интервал фильтрации для остающихся считываний до конца данных:

$$a = SE(K) + 1,$$

$$b = N,$$

где m — номер отведения;

n — номер считывания;

K — число комплексов QRS;

N — номер последнего считывания;

k — номер комплекса QRS;

указатель на начало вычитания эталонного цикла типа 0 для цикла (k) в необработанных данных: $SB(k)$;

указатель на конец вычитания эталонного цикла типа 0 для цикла (k) в необработанных данных: $SE(k)$;

указатель на начало защищенной области комплекса (k) в необработанных и в остаточных данных: $QB(k)$;

указатель на конец защищенной области комплекса (k) в необработанных и в остаточных данных: $QE(k)$.

Примечание — Методы округления определены в С.3.2.2 и С.3.2.3. Константы округления 1, 2, ..., $(L-1)/2$ в предыдущих уравнениях должны браться отрицательными, если фильтруемые значения отрицательны.

С.4 Численные примеры для сжатия данных SCP-ECG

С.4.1 Пример 1

В настоящем примере показаны разные данные, полученные при высоком сжатии SCP-ECG для первых 28 считываний записи ЭКГ.

RAW — необработанные данные 1 мкВ/LSB, интервал между считываниями 2 мс (500 считываний/с);

TRU — огрубленные необработанные данные 1 мкВ/LSB → 5 мкВ/LSB;

RES — остаточная запись после вычитаний эталонного цикла;

FIL — нерекурсивный фильтр «скользящего среднего» по девяти считываниям;

DEC — прореживание до интервала между считываниями 8 мс с усреднением (125 считываний/с);

2D — разности второго порядка, первые два значения исходные;

HUF — кодирование Хаффмана (код по умолчанию, таблица С.9).

Таблица С.11 — Данные, получаемые при высоком сжатии записи SCP-ECG

Номер считывания	RAW	TRU	RES	FIL	DEC	2D	HUF
1	63	13	13	13	14	14	111111111000001110
2	70	14	14	14			
3	74	15	15	14			

Окончание таблицы С.11

Номер считывания	RAW	TRU	RES	FIL	DEC	2D	HUF
4	71	14	14	15			
5	79	16	16	16	18	18	11111111000010010
6	89	18	18	17			
7	96	19	19	19			
8	102	20	20	20			
9	108	22	22	21	22	0	0
10	112	22	22	22			
11	114	23	23	22			
12	116	23	23	23			
13	116	23	23	23	22	- 4	111101
14	112	22	22	22			
15	110	22	22	21			
16	100	20	20	19			
17	87	17	17	18	13	- 9	11111111011110111
18	74	15	15	14			
19	59	12	12	12			
20	42	8	8	9			
21	28	6	6	6	3	- 1	101
22	13	3	3	4			
23	5	1	1	2			
24	- 1	0	0	0			
25	- 8	- 2	- 2	- 1	- 2	5	1111100
26	- 11	- 2	- 2	- 2			
27	- 13	- 3	- 3	- 3			
28	- 17	- 3	- 3	- 3			
...

56 байтов = 448 битов → сокращены до 71 бита.

Первые 28 считываний необработанных данных отведения сжимаются в битовый поток

1111111100000111011111111100001001001111011111111101111011111011111100....

имеющий следующее шестнадцатеричное представление:

FF 83 BF E1 27 BF F7 BD ...

С.4.2 Пример 2

В этом примере показаны разные данные, получаемые при полном сокращении избыточности по методу SCP-ECG для первых 28 считываний записи ЭКГ.

RAW — необработанные данные 1 мкВ/LSB, интервал между считываниями 2 мс (500 считываний/с);

TRU — округленные необработанные данные 1 мкВ/LSB → 5 мкВ/LSB;

RES — остаточная запись после вычитаний эталонного цикла;

2D — разности второго порядка, первые два значения исходные;

HUF — кодирование Хаффмана (код по умолчанию, таблица С.9).

Таблица С.12 — Полное сокращение избыточности по методу SCP-ECG

Номер считывания	RAW	TRU	RES	2D	HUF
1	63	13	13	13	11111111000001101
2	70	14	14	14	11111111000001110
3	74	15	15	0	0

Окончание таблицы С.12

Номер считывания	RAW	TRU	RES	2D	HUF
4	71	14	14	- 2	1101
5	79	16	16	3	11100
6	89	18	18	0	0
7	96	19	19	- 1	101
8	102	20	20	0	0
9	108	22	22	1	100
10	112	22	22	- 2	1101
11	114	23	23	1	100
12	116	23	23	- 1	101
13	116	23	23	0	0
14	112	22	22	- 1	101
15	110	22	22	1	100
16	100	20	20	- 2	1101
17	87	17	17	- 1	101
18	74	15	15	1	100
19	59	12	12	- 1	101
20	42	8	8	- 1	101
21	28	6	6	2	1100
22	13	3	3	- 1	101
23	5	1	1	1	100
24	- 1	0	0	1	100
25	- 8	- 2	- 2	- 1	101
26	- 11	- 2	- 2	2	1100
27	- 13	- 3	- 3	- 1	101
28	- 17	- 3	- 3	1	100
...

56 байтов = 448 битов → сокращены до 113 битов.

Первые 28 считываний необработанных данных отведения сжимаются в битовый поток

1111111100001101111111110000111001101111010101010011011001

010101100110110110010110111001011001001011100101100...

имеющий следующее шестнадцатеричное представление:

FF 83 7F E0 E6 F5 53 65 59 B6 5B 96 4B 96 ...

С.5 Тестовый набор ЭКГ для испытания соответствия

В таблице С.13 представлены ЭКГ, выбранные для тестирования ошибок сжатия и распаковки SCP-ECG. Данные предоставлены в виде 10-секундных цифровых записей с частотой 500 считываний/с и уровнем дискретизации 5 мкВ/LSB. В этот набор включены ЭКГ с синусовым ритмом, фибрилляцией предсердий, трепетанием предсердий, полиформными и моноформными желудочковыми экстрасистолами, а также с суправентрикулярной экстрасистолой. Включены два случая со значительными нарушениями внутрисердечной проводимости. Для верификации абсолютной калибровки в набор включена искусственная ЭКГ с низким уровнем шума и частотой сердечных сокращений 120 ударов в минуту с синусовым ритмом.

Эти данные взяты из эталонной базы данных CSE, содержащей многие отведения и предназначенной для тестирования распознавания зубцов, а также из диагностической эталонной базы CSE. Некоторые данные были слегка «сглажены», чтобы избавиться от определенного уровня шума. Все эти записи ЭКГ подверглись сжатию и распаковке в соответствии со стандартами, предложенными рабочей группой SCP-ECG. Среднеквадратичные ошибки (RMS) и абсолютные максимальные ошибки, выявленные после восстановления, приведены в таблице С.13.

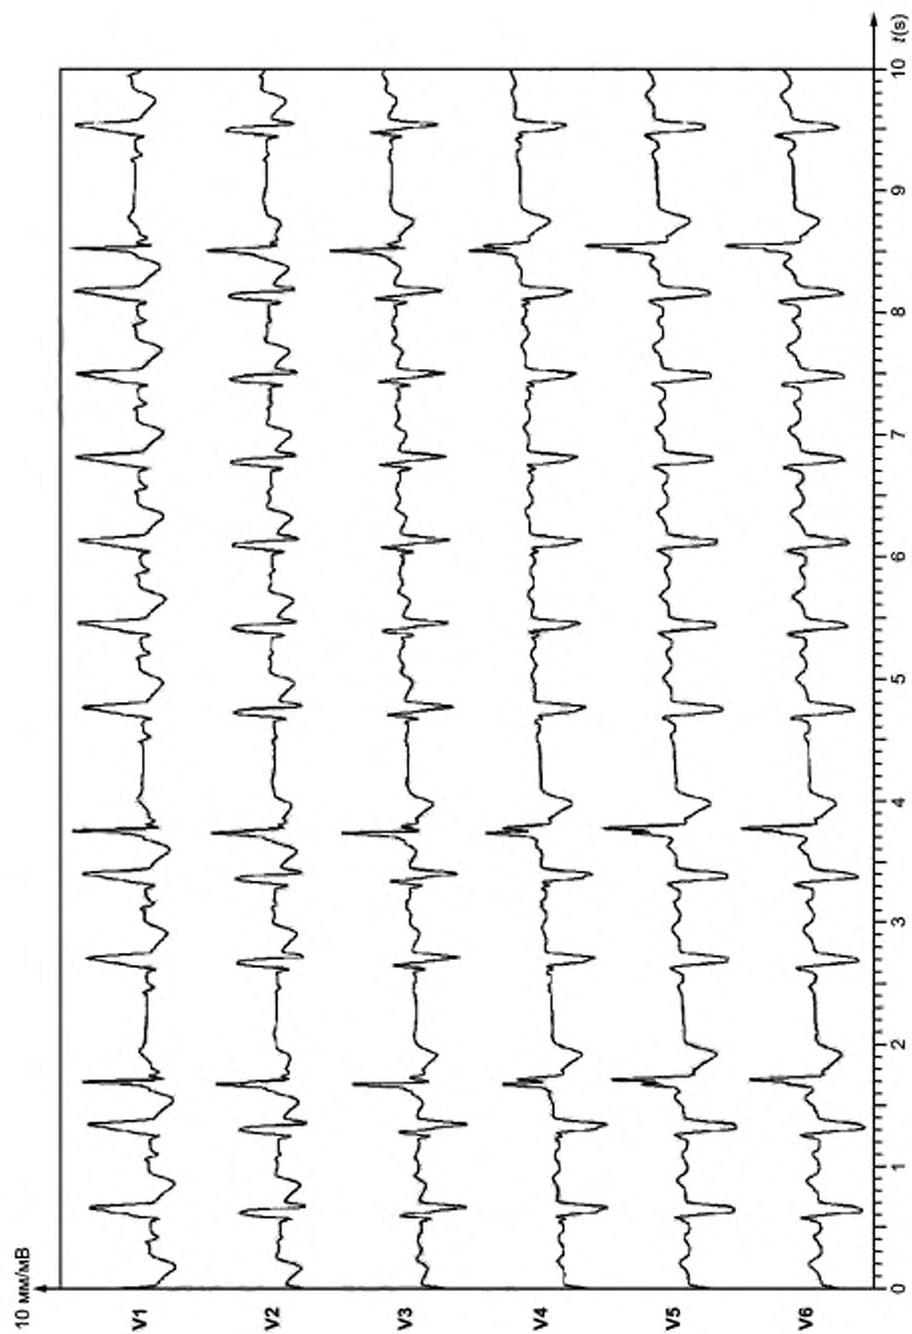


Рисунок С.7 — ЭКГ для данных примера (отведения с V1 по V6)

Таблица С.13 — Тестовый набор для верификации ошибок сжатия в соответствии со стандартом SCP-ECG

Пациент	Ритм, морфология QRS	Шум
PD2-003 Распакована	Синусовый ритм, передний инфаркт, QRS с зубцом Абсолютная максимальная ошибка: 64 мкВ; RMS: 7,9 мкВ	5 мкВ
PD2-010 Распакована	Синусовая тахикардия; Абсолютная максимальная ошибка: 67 мкВ; RMS: 8,1 мкВ	6 мкВ
PD2-051 Распакована	Синусовый ритм, инфаркт Абсолютная максимальная ошибка: 44 мкВ; RMS: 7,6 мкВ	3 мкВ
PD2-078 PF2-078 Распакована	Предсердное трепетание, мышечный тремор в отведениях I и II, большие амплитуды (с предварительной фильтрацией). Абсолютная максимальная ошибка: 43 мкВ; RMS: 8,8 мкВ	16 мкВ 10 мкВ
PD2-217 Распакована	Синусовый ритм, нарушения внутрижелудочковой проводимости, передний инфаркт Абсолютная максимальная ошибка: 39 мкВ; RMS: 7,5 мкВ	3 мкВ
PD2-313 Распакована	Трепетание/мерцание предсердий Абсолютная максимальная ошибка: 62 мкВ; RMS: 8,8 мкВ	8 мкВ
PD3-145 PF3-145 Распакована	Полиморфные желудочковые экстрасистолы (с предварительной фильтрацией) Абсолютная максимальная ошибка: 77 мкВ; RMS: 8,6 мкВ	18 мкВ 8 мкВ
PD3-471 Распакована	Трепетание предсердий Абсолютная максимальная ошибка: 52 мкВ; RMS: 8,1 мкВ	4 мкВ
PD3-1207 PF3-1207 Распакована	Суправентрикулярные экстрасистолы (с предварительной фильтрацией) Абсолютная максимальная ошибка: 89 мкВ; RMS: 7,7 мкВ	6 мкВ 4 мкВ
PWE-103 PFE-103 Распакована	Полиморфные желудочковые экстрасистолы (с предварительной фильтрацией) Абсолютная максимальная ошибка: 41 мкВ; RMS: 8,6 мкВ	26 мкВ 8 мкВ
PWE-105 PFE-105 Распакована	Желудочковые экстрасистолы, полная блокада правой ножки пучка Гиса (с предварительной фильтрацией) Абсолютная максимальная ошибка: 54 мкВ; RMS: 7,7 мкВ	19 мкВ 12 мкВ
P120-N00 Распакована	Синусовая тахикардия, нормальный, математически сконструированный комплекс QRS Абсолютная максимальная ошибка: 16 мкВ; RMS: 5,0 мкВ	0 мкВ 3 мкВ

Приложение D
(справочное)

**Определение минимального набора управляющих сообщений и запросов
для обмена данными электрокардиограммы**

D.1 Общие положения

Часть стандарта SCP-ECG, посвященная обмену сообщениями, описывает тип информации, который можно запрашивать и передавать на прикладном уровне между устройствами, а также формат заголовков сообщений. Настоящий стандарт определяет структуры сообщений данных и указывает последовательности обменов сообщениями, необходимые для передачи данных и запросов, требуемых протоколом, вместе с форматом каждого типа сообщений. Описано также использование информационных сообщений. Содержание данных описано ранее в разделе 5. Знание содержания данных протокола необходимо для понимания части, описывающей обмен сообщениями.

D.2 Форматы сообщений**D.2.1 Общие положения**

Длина каждого блока сообщения составляет 256 байтов. Первый байт каждого блока сообщения является символом ASCII, идентифицирующим тип сообщения. В настоящий момент определены следующие типы (минимальный набор): I, R, S, A и D. Двоичные данные по умолчанию и зарезервированные поля должны заполняться нулями. Строки текстовых символов должны завершаться байтом NULL. Разработчик должен следить за тем, чтобы все сообщения имели длину 256 байтов или меньше. Для выполнения этого требования может потребоваться усечение полей данных свободного текста (например, раздел 1, тег 14). Сообщения с длиной больше 256 байтов будут восприниматься как неправильно форматированные.

Все сноски в таблицах D.1—D.8 ссылаются на примечания [a)—l)], приведенные в D.2.7.

D.2.2 Обмен идентификационными данными (тип сообщения — «I»)

Таблица D.1 — Обмен идентификационными данными (тип сообщения — «I»)

	Номера байтов
Тип сообщения — «I» (ASCII, 1 байт)	1
Идентификационный номер организации ^{a)} (двоичный)	2, 3
Идентификационный номер отделения ^{a)} (двоичный)	4, 5
Идентификационный номер устройства (ID) ^{a)} (двоичный)	6, 7
Тип устройства ^{a)} (0 — устройство картирования, 1 — система) (двоичный)	8
Код производителя ^{b)} (двоичный)	9
Описание модели ^{b)} (до 5 символов ASCII, например, «0107B», «MAC15», «4760A» + NULL)	C 10 по 15
Номер версии протокола SCP-ECG (двоичный)	16
Уровень совместимости с протоколом SCP-ECG (двоичный)	17
Код языковой поддержки ^{c)} (1-байтовое побитовое отображение)	18
Функциональные возможности ^{d)} (двоичный)	19
Частота основных внешних источников питания (двоичный)	20
Зарезервированы	C 21 по 128
Идентификатор программного обеспечения реализации SCP устройства снятия. Максимум 24 символа плюс терминатор NULL из 5.4.5, тег 14	C 129 по 153
Производитель устройства снятия. Содержит зарегистрированное торговое наименование производителя. Максимум 24 символа плюс терминатор NULL из 5.4.5, тег 14	C 154 по 178
Запасное поле ^{l)}	C 179 по 256

D.2.3 Запрос (тип сообщения — «R»)

Таблица D.2 — Запрос (тип сообщения — «R»)

	Номера байтов
Общее содержание запросов (байты с 1 по 14)	
Тип сообщения — «R» (ASCII, 1 байт)	1
Запрос обработки ^{e)} (ASCII, 1 байт)	2
Подзапрос ^{f)} (1 двоичный байт)	3
Номер последовательности запроса (1 целочисленное без знака; 1 — 65 535)	4, 5
Пароль, 9 символов ASCII (необязательный) ^{g)}	С 6 по 14
[См. примечания с а) по l) в D.2.7 и определения в подразделах с D.2.3.1 по D.2.3.3]	С 15 по 256
<p>Примечания</p> <p>1 Из соображений безопасности любой запрос должен подвергаться обработке только в том случае, когда между двумя взаимодействующими системами (устройством картирования и сервером) произошел успешный обмен идентифицирующими сообщениями.</p> <p>2 Неизвестные поля или те, значения которых безразличны, должны иметь значение NULL.</p> <p>3 Каждое сообщение запроса начинается с поля «Общее содержание запросов» длиной в 14 байт, за которым следует поле, содержащее данные пациента длиной в 242 байта (байты с 15 по 256) в соответствии с D.2.2.1—D.2.2.3. Каждый параметр должен храниться в отдельном поле и идентифицироваться ведущим специфицирующим байтом, называемым «тегом». За этим байтом следует длина (целое без знака), которую именуют «длиной», а за ней следует нуль или более байтов параметров, именуемых «значением» (см. D.2.2.1—D.2.2.3).</p> <p>4 Счетчик номеров последовательности запросов должен увеличиваться с каждым сообщением «запроса» и может возвращаться к 1 (один). Сбрасывается до 1 (один) при получении каждого идентифицирующего сообщения от машины-получателя. Значение 0 (нуль) не допускается.</p> <p>5 Номера последовательности запросов предназначены для использования процедурой обнаружения избыточных и/или потерянных сообщений «запроса».</p>	

D.2.3.1 Правила поиска для подзапросов типа «E» или «L»

Таблица D.3 — Запрос списка ЭКГ (подзапрос типа «E» или «L»)

	Длина поля в байтах
Общее содержание запросов (см. D.2.2)	14
Номер организации (1 двоичное целое)	2
Номер отдела (1 двоичное целое)	2
Идентификатор пациента, тег = 2 (двоичное)	1
Длина идентификатора пациента (двоичное)	1
Текст идентификатора пациента (текстовые символы)	Переменная
Фамилия пациента, тег = 0 (двоичное)	1
Длина фамилии пациента (двоичное)	1
Фамилия пациента (текстовые символы)	Переменная
Имя пациента, тег = 1 (двоичное)	1
Длина имени пациента (двоичное)	1
Имя пациента (текстовые символы)	Переменная

Окончание таблицы D.3

	Длина поля в байтах
Пол пациента, тег = 8 (двоичное)	1
Длина пола пациента = 1 (двоичное)	1
Пол пациента (байт)	1
Дата рождения пациента (ДРП), тег = 5 (двоичное)	1
Длина ДРП пациента — 4 (двоичное)	1
ДРП пациента (двоичное, 4 байта) ^{h)}	4
Запасное поле ^{l)}	Переменная
	Всего 256 байтов

D.2.3.2 Правила поиска для подзапросов типа «I» или «P»

Таблица D.4 — Запрос списка пациентов (подзапрос типа «I» или «P»)

	Длина поля в байтах
Общее содержание запросов (см. D.2.2)	14
Номер организации (двоичное)	2
Номер отдела (двоичное)	2
Идентификатор пациента, тег = 2 (двоичное)	1
Длина идентификатора пациента (двоичное)	1
Текст идентификатора пациента (текстовые символы)	Переменная
Фамилия пациента, тег = 0 (двоичное)	1
Длина фамилии пациента (двоичное)	1
Фамилия пациента (текстовые символы)	Переменная
Имя пациента, тег = 1 (двоичное)	1
Длина имени пациента (двоичное)	1
Имя пациента (текстовые символы)	Переменная
Запасное поле ^{l)}	Переменная
	Всего 256 байтов

D.2.3.3 Правила поиска для подзапроса типа «R» или «S»

Таблица D.5 — Запрос тестирования (подзапрос типа «R» или «S»)

	Длина поля в байтах
Общий запрос (см. D.2.2)	14
Номер организации (учреждения?) (двоичное)	2
Номер отделения (двоичное)	2

Окончание таблицы D.5

	Длина поля в байтах
ID пациента, тег = 2 (двоичное)	1
Длина ID пациента (двоичное)	1
ID пациента (текстовые символы)	Переменная
Фамилия пациента, тег = 0 (двоичное)	1
Длина фамилии пациента (двоичное)	1
Фамилия пациента (текстовые символы)	Переменная
Имя пациента, тег = 1 (двоичное)	1
Длина имени пациента (двоичное)	1
Имя пациента (текстовые символы)	Переменная
Пол пациента, тег = 8 (двоичный)	1
Длина пола пациента = 1 (двоичный)	1
Пол пациента (двоичный)	1
Дата рождения пациента (ДРП), тег = 5 (двоичное)	1
Длина ДРП пациента = 4 (двоичное)	1
ДРП пациента (двоичная в 4 байта)	4
Дата снятия, тег = 25 (двоичное)	1
Длина даты снятия = 4 (двоичное)	1
Дата снятия (двоичная в 4 байта, формат, как у ДРП)	4
Время снятия, тег = 26 (двоичное)	1
Длина времени снятия = 3 (двоичное)	1
Время снятия (двоичное в 3 байта) ³⁾	3
Запасное поле ¹⁾	Переменная
	Всего 256 байтов

Данные, отправленный в ответ на запросы типов «L» и «P» (для каждого отчета или пациента, соответствующего критериям поиска), состоят из последовательности разделов заголовков SCP-ECG, состоящей только из разделов 0 и 1.

D.2.3.4 Правила поиска для типов подзапросов «L» и «P»

1) При запросе списка ЭКГ (тип подзапроса «L») или списка пациентов (подзапрос типа «P») применимы следующие правила поиска:

i) любое поле может быть указано или не указано;

ii) если поле не указано, то предполагается, что оно «безразлично» и не используется как часть критериев поиска;

iii) если поле указано без символов подстановки [см. перечисление iv)], то необходимо точное совпадение;

iv) поля идентификатора пациента и его именованья могут включать в себя «символы подстановки», они определяются следующим образом:

? — совпадает ровно с одним символом в данном месте,

* — совпадает с нулем или несколькими символами в данном месте.

символы «*» и «?» могут интерпретироваться буквально, если им предшествуют символ обратной косой черты «\».

v) любой поиск является нечувствительным к регистру (символы в верхнем и нижнем регистрах эквивалентны).

Примеры

1 Идентификатор пациента = 123, фамилия и имя не указаны, совпадает со всеми фамилиями и именами пациентов, имеющих идентификатор = 123.

2 Фамилия пациента — «M*CFARL*» соответствует «MCFARLEY», «MacFarlane», «Macfarlane», «Mcfarlane» и т. д.

3 ID пациента — «!FAR?» соответствует «*FAR1», «*FAR2», но не «*FAR99».

2) Эти правила поиска применяются только к запросам списков и не применимы к запросам ЭКГ (тип подзапроса «R»), в которых критерии поиска являются точными для обязательных параметров (организация, отделение, идентификатор пациента, дата и время снятия).

3) Тег типа 255 длиной 0 применяется для маркировки конца тегированных данных в сообщении «запроса списка».

D.2.4 Сообщение статуса (тип сообщения — «S»)

Формат сообщения статуса показан в таблице D.6.

Таблица D.6 — Сообщение статуса (тип сообщения — «S»)

	Номер байта
Тип сообщения — «S» (символ ASCII)	1
Флаг статуса ¹⁾ (символ ASCII)	2
Код причины ошибки ^{к)} (двоичное)	3
Порядковый номер запроса (двоичное): с 1 по 65 535	4, 5
Запасное поле ¹⁾	С 6 по 256

Порядковый номер запроса в этом сообщении совпадает с порядковым номером того сообщения «запроса», чей статус возвращается.

Ложные сообщения «STATUS OK» (нормальный статус), полученные до ожидаемого сообщения типа «D» (запрос выполнен), будут игнорироваться.

D.2.5 Информационное сообщение (тип сообщения — «A»)

Формат информационного сообщения показан в таблице D.7.

Таблица D.7 — Информационное сообщение (тип сообщения — «A»)

	Номер байта
Тип сообщения — «A» (символ ASCII)	1
Зарезервировано	2, 3
Информационное сообщение (текстовая строка символов, завершаемая байтом NULL)	С 4 по 256

Руководство по использованию информационных сообщений приведено в D.5.

D.2.6 Сообщение о выполнении (тип сообщения — «D»)

Сообщение о выполнении («DONE») означает завершение выполнения команды. Сообщение «выполнено» имеет следующий формат.

Таблица D.8 — Сообщение о выполнении (тип сообщения — «D»)

	Номер байта
Тип сообщения — «D» (символ ASCII)	1
Зарезервировано	2, 3
Запасное поле ¹⁾	С 4 по 256

Информация к сообщению о выполнении:

- каждое устройство управляет флагом «ожидание завершения» (PT — pending termination);
- посылая сообщение типа «D» и устанавливая свой флаг PT, ведущее устройство изменяет свой статус на ведомое;
- приняв сообщение типа «D», ведомое устройство изменяет свой статус на ведущее и устанавливает свой флаг PT;
- если у ведомого устройства флаг PT установлен, то при приеме сообщения типа «D» (без предшествующего сообщения типа «R»), оно должно завершить сеанс и прекратить связь;
- если у ведомого устройства флаг PT не установлен, то оно может отправить сообщение типа «D», не меняя свой статус на ведущее устройство. При этом состояния флагов PT ведущего и ведомого устройства не изменяются;
- если у ведущего устройства флаг PT не установлен, то при приеме сообщения типа «D» оно устанавливает свой флаг PT;
- если у ведущего устройства флаг PT установлен, то при приеме сообщения типа «D» оно прекращает связь.

D.2.7 Примечания к D.2.2—D.2.6

- a) Эти поля уникально идентифицируют запрашивающее устройство и его местоположение.
- b) Коды производителя и обозначение модели устройства записи ЭКГ определены в полях демографических данных пациента и полях данных снятия ЭКГ раздела 1 (см. 5.4.3.1 и 5.4.5).
- c) Код поддержки языка определен в 5.4.5, раздел 1, тег 14, байт 17.
- d) Функциональные возможности устройства кодируются битами:
- 1 — (LSB) запасной;
 - 2 — запасной;
 - 4 — запасной;
 - 8 — запасной;
 - 16 — печать ECG;
 - 32 — интерпретация ECG;
 - 64 — хранение ECG;
 - 128 (MSB) — снятие ECG.
- e) Запрос обработки кодируется одним символом ASCII:
- «E» — запрос на отправку списка ЭКГ, снятых для заданного пациента;
 - «I» — запрос на отправку списка пациентов с заданными именем и фамилией;
 - «L» — запрос на получение списка ЭКГ, снятых для заданного пациента;
 - «P» — запрос на получение списка пациента с заданными именем и фамилией;
 - «R» — запрос на получение ЭКГ;
 - «S» — запрос на отправку ЭКГ;
 - «X» — переход на запрос, специфичный для поставщика.
- f) Данное поле используется только для запросов типа «R» и «X». Для этих типов запроса получатель извлекает из этого поля дополнительный код запроса.
- В запросах типа «R» с помощью этого поля можно запросить несколько тестов. При этом нет необходимости использовать несколько запросов или обязательно знать дату и время проведения теста. Это поле является битовым массивом. Его значения определены следующим образом:
- 0 (ни один бит не установлен) — маска запроса не нужна: передать все ЭКГ;
 - 1 (LSB) — запрошенная ЭКГ будет иметь дату и время;
 - 2 — самая последняя ЭКГ;
 - 4 — первая предыдущая ЭКГ;
 - 8 — вторая предыдущая ЭКГ;
 - 16 — базовая ЭКГ, если имеется, иначе самая ранняя ЭКГ;
 - 32 — все с определенного срока, будет дополнен датой и временем.
- В запросах типа «X» коды подзапросов являются расширениями, специфичными для поставщика, и здесь не определены.
- g) Если система-получатель требует пароль, данное поле содержит пароль в кодировке ASCII, состоящий из девяти символов и заканчивающийся байтом NULL.
- h) Даты имеют следующий формат (см. 5.4.5, раздел 1, теги 5 и 25):
- Байты с 1 по 2 — двоичное: год.
 - Байт 3 — двоичное: месяц (с 01 по 12).
 - Байт 4 — двоичное: день месяца (с 01 по 31).
- i) Время имеет следующий формат (см. 5.4.5, раздел 1, тег 26):
- Байт 1 — двоичное: часы (с 00 по 23).

Байт 2 — двоичное: минуты (с 00 по 59).

Байт 3 — двоичное: секунды (с 00 по 59).

j) Флаг статуса — один символ (ASCII) определен как:

«G» — ОК (можно продолжать); код ошибки не используется. Приемник должен возобновить работу и отправить следующее сообщение.

«E» — Не ОК, ошибка:

- если ошибка идентификации, то вызов сразу завершается;

- в случае ошибки в запросе или в данных ЭКГ получатель может отправить другой запрос или сообщение «выполнено».

k) Для флага статуса «E» (статус ошибки) данное поле содержит следующий двоичный код, указывающий причину ошибки:

0 — неспецифичная ошибка;

1 — тип последнего сообщения не распознан;

2 — последнее сообщение недействительно;

3 — недействительный код местоположения; отправленное местоположение (т. е. номер организации или отдела) не определено;

4 — недействительный пароль;

5 — запрос на обработку не распознан: обрабатывающее устройство не понимает запрос;

6 — запрос на обработку не поддерживается: обрабатывающее устройство не поддерживает запрос;

7 — запрос на обработку не поддерживается: обрабатывающему устройству не хватает памяти;

10 — идентификация пациента недействительна;

11 — фамилия и имя пациента недействительны;

12 — демографические данные пациента недействительны; данные, не являющиеся идентификацией, фамилией или именем, имеют недействительный тип или диапазон;

13 — демографические данные пациента являются противоречивыми; данные не согласуются с уже хранящейся информацией о пациенте.

Следующие коды относятся к данным сигнала и к их поддержке принимающим устройством:

20 — неправильная частота считываний;

21 — неправильная комбинация отведений;

22 — ошибочная длительность отведения;

23 — неправильное сжатие данных;

24 — другая ошибка данных ЭКГ;

30 — измерения недействительны; одно или несколько измерений недействительны;

31 — недействительный диагноз;

40 — устройство вывода не готово;

41 — устройство хранения не готово;

42 — ошибка базы данных;

43 — другая системная ошибка;

44 — ошибка нехватки памяти;

50 — ЭКГ для данного местоположения отсутствуют;

60 — нет данных, соответствующих запросу.

Коды в диапазоне с 128 по 255 зарезервированы для кодов ошибок, специфичных для производителя.

l) Области, определенные в блоках данных сообщения как «ЗАПАСНЫЕ», доступны реализациям, специфичным для производителя.

D.2.8 Минимальные функциональные возможности

Чтобы соответствовать спецификациям данного раздела, система, состоящая из устройства картирования и сервера, должна быть способна:

1) обмениваться идентифицирующими сообщениями;

2) отвечать на запрос типа «R» с дополнительным кодом 0 в соответствии с D.2.7, перечисление f);

3) передавать «все» ЭКГ в соответствии с D.2.7, перечисления e) или f).

D.3 Диаграммы перехода состояний

D.3.1 Диаграмма перехода состояний установления сеанса

На рисунке D.1 описан процесс обмена идентифицирующими сообщениями между устройством картирования и сервером, обеспечивающего установление сеанса взаимодействия по стандарту SCP-ECG. Необходимо отметить, что сеанс не переходит в состояние «соединения», пока не произошел успешный обмен идентифицирующими сообщениями (см. D.2.2). Описание функционирования после установления сеанса см. в D.3.2.

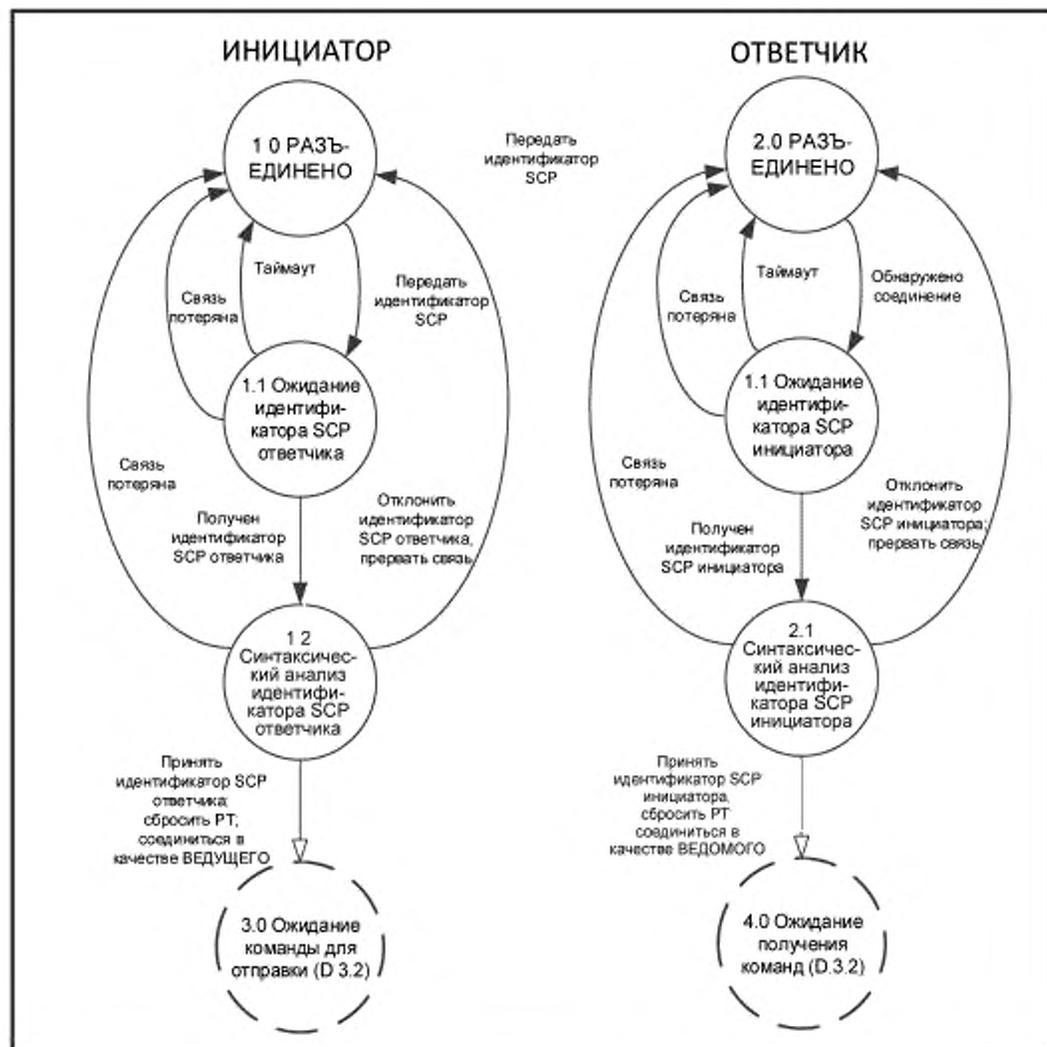


Рисунок D.1 — Диаграмма переходов состояния сеанса

D.3.2 Диаграмма перехода состояний системы обмена сообщениями запросов

На диаграмме состояний, приведенной на рисунке D.2, показаны операции системы обмена сообщениями запросов, выполняемые после обмена идентифицирующими сообщениями в соответствии с D.3.1. В процессе работы устройство системы существует в одном из двух состояний: ведущее или ведомое. Ведущему устройству разрешено отправлять команды. Ведомое устройство может только отвечать на команды.

Сообщения и ответы, специфичные для производителя, не обязаны следовать этой диаграмме.

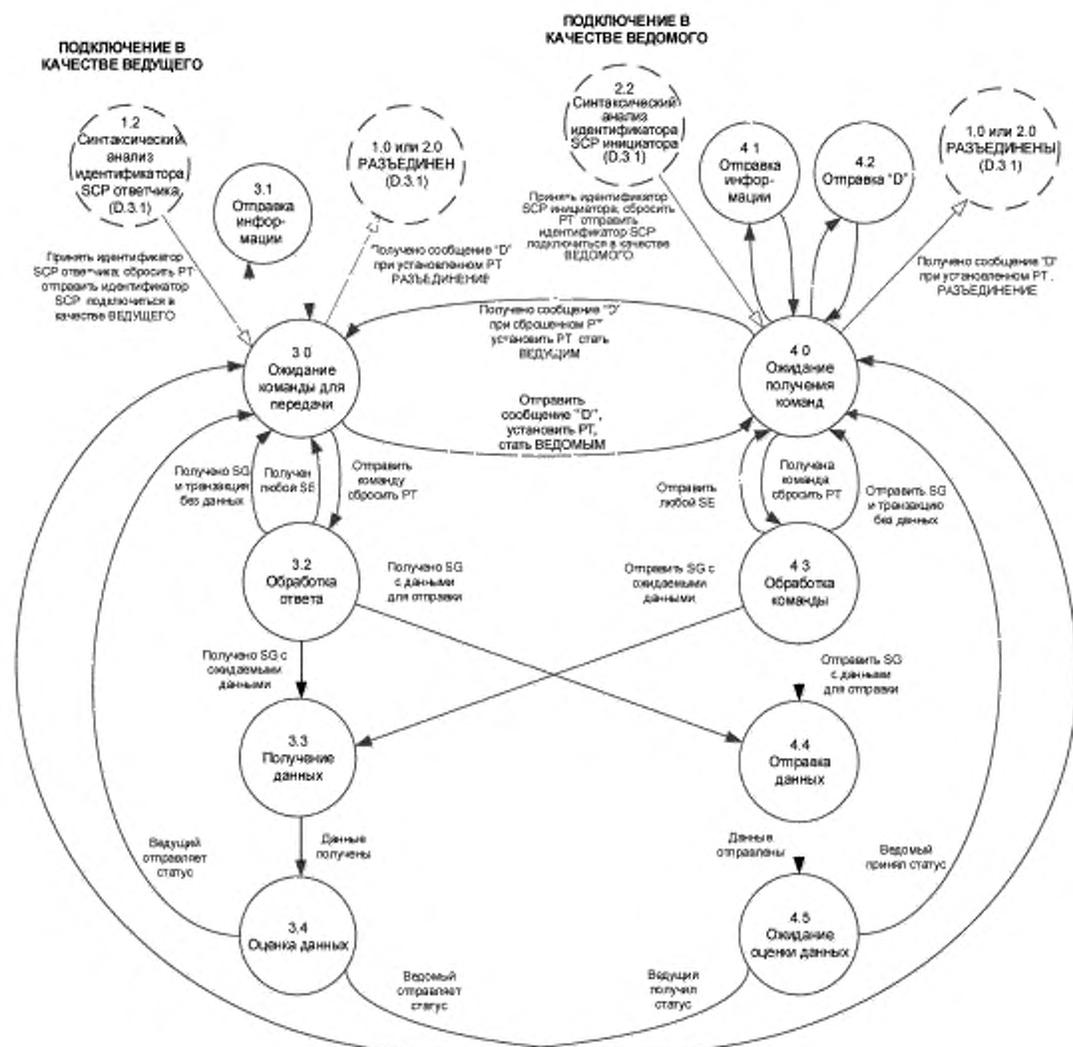


Рисунок D.2 — Диаграмма перехода состояний системы обмена сообщениями запросов

D.4 Примеры последовательности сообщений

D.4.1 Общие положения

В следующих примерах под «Данными ЭКГ» подразумевается файл данных, отформатированный в соответствии с SCP-ECG, а «Идентификационное», «Запрос», «Статус», «Выполнено» и «Информационное» означают сообщения SCP-ECG, определенные в D.2.

D.4.2 Передача ЭКГ

Нормальная последовательность сообщений для отправки инициатором ЭКГ ответчику имеет следующий вид:

	Инициатор	Ответчик	Комментарий
a)	Идентификационное		Начало сеанса: обмен идентифицирующими данными с помощью сообщения типа «I».
b)		Идентификационное	
c)	Запрос		Инициатор запрашивает отправку ЭКГ (сообщение типа «R»).
d)		Статус	Ответчик отвечает: готов принять (тип сообщения «S»).
e)	Данные ЭКГ		Инициатор отправляет данные.
f)		Статус	Ответчик отвечает: принятые данные пригодны (см. примечание 1, подраздел D.4.5).
g)	Запрос		Инициатор отправляет другой запрос (см. примечание 2 подраздел D.4.5) [перейти к d) или к D.4.3—D.4.5]
	или		или
	Выполнено		сообщает, что «данных больше нет» (тип сообщения «D»).
h)		Запрос или (выполнено)	Ответчик отправляет свой собственный запрос (перейти к D.4.5) или прекращает вызов.

D.4.3 Запрос списка пациентов

Нормальная последовательность сообщений для запроса списка пациентов, соответствующих маске запроса, имеет следующий вид:

	Инициатор	Ответчик	Комментарий
a)	Идентификационное		Начало сеанса: обмен идентифицирующими данными.
b)		Идентификационное	
c)	Запрос		Инициатор запрашивает список пациентов.
d)		Статус	Ответчик возвращает ОК. Ответчик поддерживает соединение, пока запрос не будет обработан.
e)		Запрос	Ответчик запрашивает отправку списка пациентов.
f)	Статус		Инициатор отвечает «готов принять».
g)		Данные	Ответчик отправляет список пациентов.
h)	Статус		Инициатор отвечает, что полученные данные пригодны (см. примечание 1 к D.4.5).
i)		Выполнено	Ответчик сообщает «данных больше нет».
j)	Запрос		Инициатор отправляет еще один запрос (см. примечание 2 к D.4.5) [перейти к d) или к D.4.3—D.4.5]
	или		или
	Выполнено		сообщает «данных больше нет».
k)		Запрос или (выполнено)	Ответчик отправляет свой собственный запрос (перейти к D.4.5) или завершает вызов.

D.4.4 Запрос списка ЭКГ

Последовательность сообщений запроса у ответчика списка отчетов по ЭКГ, снятых для заданного пациента, имеет следующий вид:

	Инициатор	Ответчик	Комментарий
a)	Идентификационное		Начало сеанса: обмен идентифицирующими данными.
b)		Идентификационное	
c)	Запрос		Инициатор запрашивает список ЭКГ.
d)		Статус	Ответчик возвращает ОК. Ответчик поддерживает соединение, пока запрос не будет обработан.
e)		Запрос	Ответчик запрашивает отправку списка ЭКГ.

f)	Статус		Инициатор отвечает «готов принять данные».
g)		Данные	Ответчик отправляет данные.
h)	Статус		Инициатор отвечает, что полученные данные пригодны (см. примечание 1 к D.4.5).
i)		Выполнено	Ответчик сообщает «данных больше нет».
j)	Запрос		Инициатор отправляет еще один запрос [перейти к d) или к D.4.3—D.4.5] (см. примечание 2 к D.4.5)
	или		или
	Выполнено		сообщает «данных больше нет».
k)	Запрос	Запрос	Ответчик отправляет свой собственный запрос (перейти к D.4.5)
	или	или	или
	(выполнено)	(выполнено)	завершает вызов.

D.4.5 Запрос отчета ЭКГ

Последовательность сообщений запроса у ответчика конкретного отчета или отчетов по ЭКГ, снятых для заданного пациента, имеет следующий вид:

a)	Инициатор Идентификационное	Ответчик	Комментарий Начало сеанса: обмен идентифицирующими данными.
b)		Идентификационное	
c)	Запрос		Инициатор запрашивает получение ЭКГ.
d)		Статус или Запрос	Ответчик возвращает статус «ошибка», если у него нет ЭКГ для отправки, или запрос на отправку ЭКГ.
e)	Статус		Инициатор отвечает «готов принять».
f)		Данные ЭКГ	Ответчик отправляет данные.
g)	Статус		Инициатор отвечает, что полученные данные пригодны (см. примечание 1).
h)		Запрос или Выполнено	Ответчик отправляет еще один запрос [перейти к e)] (см. примечание 2) или сообщает «данных больше нет».
i)	Запрос или (выполнено)		Инициатор отправляет свой собственный запрос (перейти к D.4.2—D.4.4) или завершает вызов.

Примечания

1 Если принятые данные непригодны, то ответчик возвращает код ошибки (см. D.2.4). Затем инициатор переходит к g), чтобы повторно передать те же данные, другие (новые) данные или отправить статус «Выполнено».

2 С помощью этого механизма может быть передан «пакет» ЭКГ или «набор списков пациентов». См. также пример 2 в D.5.

D.5 Использование информационных сообщений

В любой точке приведенной выше последовательности, где может быть отправлено сообщение управления (идентификация, запрос, статус или «Выполнено»), могут быть дополнительно отправлены одно или несколько информационных сообщений. Информационное сообщение не оказывает никакого влияния на последовательности обработки. Оно позволяет предоставить дополнительную информацию оператору-человеку.

Передача информационного сообщения не приводит к смене ведущего и ведомого. По получении информационного сообщения вместо очередного сообщения управления получатель обрабатывает информационное сообщение (обычно отображая его оператору) и продолжает находиться в том же состоянии, ожидая сообщения управления, которое он рассчитывал получить до этого.

Ниже рассмотрены примеры использования информационных сообщений.

Пример 1

a)	Инициатор Идентификационное	Ответчик	Комментарий Начало сеанса: обмен идентифицирующими данными.
b)		Идентификационное	
c)	Запрос		Инициатор запрашивает отправку ЭКГ.
d)		Статус	Ответчик возвращает статус готовности к приему.

e)	Данные ЭКГ	Инициатор отправляет данные. «Значение по умолчанию для возраста пациента».
	Информационное	«Пожалуйста, подождите 30 секунд».
f)	Статус	Ответчик сообщает, что полученные данные пригодны.
g)	Выполнено	Инициатор отвечает «данных больше нет».
h)	(выполнено)	Ответчик завершает вызов.
Пример 2		
	Инициатор	Ответчик
a)	Идентификационное	Комментарий Начало сеанса: обмен идентифицирующими данными.
b)	Идентификационное	
c)	Запрос	Инициатор запрашивает получение ЭКГ. «Отправка ЭКГ № 1 из 1 найденной».
	Информационное	
d)	Запрос	Ответчик запрашивает отправку ЭКГ.
e)	Статус	Инициатор возвращает статус готовности к приему.
f)	Данные ЭКГ	Ответчик отправляет данные.
g)	Статус	Инициатор сообщает, что полученные данные пригодны.
h)	Выполнено	Ответчик отвечает «запросов больше нет».
i)	(выполнено)	Инициатор завершает вызов.

Приложение Е
(справочное)**Стандартный протокол низкого уровня для взаимодействия устройства картирования электрокардиограммы с сервером****Е.1 Общие положения**

Низкоуровневый транспортный протокол, предназначенный для обмена ЭКГ между цифровыми устройствами картирования ЭКГ и компьютеризированными системами управления (хранения) ЭКГ, состоит из двух функциональных уровней:

- канальный уровень;
- физический уровень.

Коммуникации между двумя системами управления ЭКГ и коммуникации между этими системами и другими серверами не входят в рамки данной спецификации.

Е.2 Функциональный канальный и физический уровни

В разделе Е.3 приведено краткое описание минимальных требований для локального и дистанционного соединения и передачи данных, связанных с ЭКГ, позволяющих использовать малозатратные, высокоскоростные асинхронные модемы или простые локальные каналы RS-232-C. Выполнение этих требований должно гарантировать, что устройства, использующие данный стандартный протокол, способны взаимодействовать.

В разделе Е.5 описаны методы, обеспечивающие синхронизацию двух взаимодействующих устройств и отсутствие искажений данных в процессе передачи. Настоящий стандарт описывает состояния, необходимые для обработки исключительных ситуаций.

При обмене данными между устройствами, в особенности сжатыми двоичными данными, которые особенно подвержены искажению из-за ошибок передачи, важно использовать некоторые устройства или программное обеспечение, позволяющие обеспечивать целостность данных и канала передачи данных. Такие устройства или программное обеспечение доступны во многих форматах, например, низкоуровневые сетевые протоколы, модемы с коррекцией ошибок и т. д. В данном приложении описан низкоуровневый протокол, который можно использовать в отсутствие какого-либо другого доступного или пригодного адекватного протокола.

Для облегчения понимания данного уровня в настоящее приложение включены диаграммы перехода состояний, алгоритм вычисления контрольной суммы каждого пакета данных и формат каждого определяемого блока данных. В целом этот канальный уровень является улучшением протокола XMODEM.

Е.3 Функциональный физический уровень**Е.3.1 Общее описание**

В данном разделе дано описание физического уровня стандартного протокола передачи ЭКГ. Приведены минимальные требования как для «локального», так и для «дистанционного» соединения. Локальные соединения определены как прямые соединения «точка-точка». Дистанционными являются те соединения, которые задействуют публичные коммутируемые телефонные сети или их эквивалент.

Отдельные производители могут принять решение о расширении приведенных здесь требований или об использовании других физических уровней. Описанные в данном приложении стандарты не усложняют разработку будущих систем и не приводят к деградации их производительности. Они предлагают общий интерфейс, обеспечивающий достаточные показатели эффективности при минимальной стоимости реализации и предоставляющий общий метод передачи ЭКГ между поставщиками.

Е.3.2 Локальные соединения

Локальное соединение представляет собой канал RS-232-C, способный обеспечить следующие параметры:
9600 бод;
8 битов данных;
1 стоповый бит;
без бита четности.

Е.4 Дистанционное соединение

Минимальным требованием для дистанционного соединения является модем V.22bis, официально разрешенный в стране использования. Стандарт V.22bis реализуется полнодуплексным асинхронным модемом 2400 бод. Функция обнаружения и коррекции ошибок по протоколу MNP level 5 не требуется, так как уровень обработки ошибок спроектирован для ее выполнения. Другие требования те же, что и для локальных соединений.

Е.5 Функциональный канальный уровень

Е.5.1 Общее описание

Е.5.1.1 В данном разделе определен уровень коррекции ошибок и линии арбитража стандартного протокола передачи ЭКГ. Целью данного раздела является определение минимального стандарта, обеспечивающего коммуникации устройств картирования и систем разных производителей. Он не предназначен для определения или предложения метода коммуникаций между системами. Данный уровень протокола называется канальным уровнем.

Описанный здесь канальный уровень является модифицированной (расширенной) версией протокола XMODEM. Он легко реализуется с помощью «стандартных» асинхронных коммуникационных устройств и адекватен требованиям к производительности при передаче ЭКГ.

Эти требования отдельно рассмотрены в Е.5.1.2—Е.5.1.6.

Е.5.1.2 Таймауты были сокращены с 10 до 2,5 с (t_1) и 3,5 с (t_2), тем самым снижая время выполнения, когда производительность машины ниже оптимальной.

Е.5.1.3 Временная задержка текста была введена, чтобы машина могла поддерживать соединение в отсутствие данных для отправки. Это обеспечивает поддержку ситуаций, в которых передающее устройство ожидает передачу блока данных, но данные не готовы из-за задержек обработки. При обычном протоколе XMODEM получатель, ожидающий данные, несколько раз прервется по таймауту, а затем отключит соединение.

Е.5.1.4 Была добавлена способность передающего устройства запрашивать повторную передачу сообщения подтверждения самого последнего блока данных, чтобы учесть ситуацию, в которой управляющие символы ACK или NAK получателя были искажены. В стандартном протоколе XMODEM передающая станция просто повторно передает свой блок данных, что является потенциально долгим процессом.

Е.5.1.5 Размер блока больше 256 байтов.

Е.5.1.6 Протокол позволяет «реверс канала», чтобы данные можно было передавать в обоих направлениях во время одного сеанса.

Ниже для идентификации участвующей станции два устройства именуется «передатчиком» и «приемником». Устройство, передающее данные или передавшее данные последним, является ведущим. Эти роли могут меняться во время сеанса коммуникации (см. также рисунок Е.2).

Во время пребывания в каждом описанного ниже состоянии, за исключением TRANSMIT WAKE-UP и RECEIVE WAKE-UP, обе станции могут получать или передавать код завершения EOT. Возможность передачи и получения EOT в любой момент времени является необходимой для обработки аварийных завершений. Этот же механизм может использоваться для нормального завершения, поскольку на канальном уровне между этими двумя ситуациями нет различий.

Е.5.2 Передатчик

Е.5.2.1 Графическое представление передатчика см. на рисунках Е.3—Е.5.

Е.5.2.2 Передатчик имеет три состояния: TRANSMIT WAKE-UP (пробуждение для передачи), NO DATA WAIT (нет данных, ожидание) и WAIT FOR ACKNOWLEDGE (ожидание подтверждения).

Е.5.2.2.1 Состояние TRANSMIT WAKE-UP является начальным для вызывающего устройства. Предполагается, что отвечающее устройство отправит управляющий код ASCII «ENQ». По получении ENQ, если данные готовы к отправке, вызывающее устройство отправляет данные и переходит в состояние WAIT FOR ACK. Если по получении ENQ у этого устройства нет данных, готовых к передаче, то его текущим состоянием становится NO DATA WAIT. Если в течение одной минуты не получено ни одного управляющего кода ENQ, то процесс прекращается.

Е.5.2.2.2 Состояние NO DATA WAIT. В данном состоянии передатчик ожидает данные для отправки. Это случается, когда станция передачи ждет блок данных для его передачи, но этот блок еще не был подготовлен приложением более высокого уровня. Данное состояние имеет таймаут, длящийся только 2,5 с.

Если таймер сработал через 2,5 с, то передатчик проверяет наличие данных. Если они существуют, то данные отправляются и текущим состоянием становится WAIT FOR ACK. Если данных нет, то отправляется временная задержка текста, чтобы предотвратить отключение принимающей станции по таймауту, а управление передатчиком сохраняется в состоянии NO DATA WAIT. Если данные становятся доступными до истечения 2,5 с, то они могут быть отправлены в соответствии с представленным выше описанием.

Е.5.2.2.3 Состояние WAIT FOR ACK. В этом состоянии передатчик ожидает ответа от приемника на последний отправленный блок данных. Надлежащими ответами являются управляющие коды ACK или NAK.

Е.5.2.2.3.1 Если получен управляющий код ACK и передатчик получил от прикладного уровня указание выполнить реверс канала, то он передает управляющий код ENQ и управление передатчиком переходит в состояние получения WAIT FOR TURNAROUND.

Е.5.2.2.3.2 Если получен управляющий код ACK и передатчик не ожидает реверса, то он проверяет наличие данных для отправки. Если данные имеются, то они отправляются и передатчик остается в состоянии WAIT FOR ACK. Если доступных данных нет, то текущим состоянием становится NO DATA WAIT.

Е.5.2.2.3.3 Если получен управляющий код NAK, то происходит повторная передача последнего блока данных. Состояние WAIT FOR ACK сохраняется. Если было последовательно получено 10 кодов NAK, то будет отправлен код завершения EOT с номером ошибки 006, и соединение прекращается.

Е.5.2.2.3.4 Если ответ не пришел в течение 2,5 с, то происходит повторная передача последнего пакета. После десяти передач того же пакета без ответа отправляется код завершения EOT с номером ошибки 001, и соединение прекращается.

Е.5.3 Приемник

Е.5.3.1 Графическое представление приемника см. на рисунках Е.6—Е.9.

Е.5.3.2 Приемник имеет четыре состояния: RECEIVE WAKE-UP (пробуждение для приема), WAIT FOR TURNAROUND (ожидание реверса канала), WAIT ON DATA (ожидание данных) и BAD DATA (плохие данные).

Е.5.3.2.1 RECEIVE WAKE-UP. Это начальное состояние приемника. При пробуждении устройство передает управляющий код ENQ и переходит в состояние WAIT FOR TURNAROUND.

Е.5.3.2.2 WAIT FOR TURNAROUND. В этом состоянии приемник ждет от передатчика передачи первого блока данных. Допустимы два варианта входной информации: блок данных или управляющий код TTD.

Е.5.3.2.2.1 Если данные получены, то проводится проверка их правильности, основанная на номере блока и контрольной сумме. Если данные хорошие, то отправляется управляющий код ACK и текущим состоянием становится WAIT ON DATA. Если данные плохие, то отправляется NAK и приемник переходит в состояние BAD DATA.

Е.5.3.2.2.2 Если принят управляющий код TTD, то не выполняется никаких действий (кроме перезапуска часов таймаута).

Е.5.3.2.2.3 Если за 3,5 с не принято никаких данных, то осуществляется повторная передача управляющего кода ENQ. Если после отправки десяти кодов ENQ ответа нет, то соединение прерывается и отправляется управляющий код EOT с номером ошибки 002.

Е.5.3.2.3 WAIT ON DATA. Это нормальное состояние приема. Приемник ждет получения блока данных от передатчика. Допустимы четыре вида входной информации: данные, управляющие коды TTD, SYN и ENQ. Недействительная входная информация отбрасывается.

Е.5.3.2.3.1 Если получены данные, то проводится проверка их правильности, основанная на номере блока и контрольной сумме. Если данные хорошие, то отправляется управляющий код ACK, а машина остается в состоянии WAIT ON DATA. Если данные плохие, то отправляется управляющий код NAK и текущим состоянием становится BAD DATA.

Е.5.3.2.3.2 Если только что полученный пакет совпадает с предыдущим, то отправляется управляющий код ACK, а полученный пакет отбрасывается. После приема десяти последовательных копий одного и того же пакета отправляется управляющий код EOT с номером ошибки 005 и соединение прекращается.

Е.5.3.2.3.3 Если получен управляющий код TTD, то не предпринимается никаких действий (кроме перезапуска часов таймаута).

Е.5.3.2.3.4 Если получен управляющий код SYN, то осуществляется повторная передача управляющего кода ACK и состояние WAIT ON DATA остается действительным.

Е.5.3.2.3.5 Если получен управляющий код ENQ, то приемник готов стать передатчиком. Проверяется наличие данных для отправки. Если данных нет, то приемник становится передатчиком в состоянии NO DATA WAIT. Если данные имеются, то они отправляются и управление передается состоянию передачи WAIT FOR ACK.

Е.5.3.2.3.6 Если в течение 3,5 с никакие данные не получены, то передается управляющий код NAK. Это гарантирует, что передатчик перешлет последний блок данных, если он был потерян. Код NAK отправляется вместо кода ACK, поскольку передача ACK может привести к потере данных, если передатчик отправил блок данных, который приемник не смог принять. Приемник переходит в состояние BAD DATA.

Е.5.3.2.4 BAD DATA. После отправки управляющего кода NAK приемник ожидает в состоянии BAD DATA. Допустимой входной информацией являются данные, а также управляющие коды SYN и ENQ.

Е.5.3.2.4.1 Если получены хорошие данные, то приемник отправляет управляющий код ACK и переходит в состояние WAIT ON DATA. Если данные плохие, то приемник отправляет управляющий код NAK. После отправки десяти кодов NAK подряд и получения еще одного блока плохих данных отправляется управляющий код EOT с номером ошибки 003 и соединение прекращается.

Е.5.3.2.4.2 Если получен управляющий код SYN, то последний управляющий код NAK передается повторно. Состояние BAD DATA сохраняется.

Е.5.3.2.4.3 Если за 3,5 с не приняты никакие данные, то передается управляющий код NAK. Если десять NACK были отправлены в связи с отсутствием входной информации, а не из-за плохих данных, то соединение прекращается и отправляется управляющий код EOT с кодом ошибки 004.

Е.5.3.2.4.4 Если получен управляющий код ENQ, то приемник скоро станет передатчиком. Проверяется наличие данных для отправки. Если данных нет, то приемник становится передатчиком в состоянии NO DATA WAIT. Если данные имеются, то они отправляются и управление передается состоянию передачи WAIT FOR ACK.

Е.5.4 Формат блоков данных

Е.5.4.1 Управляющие коды должны передаваться следующим образом:

ENQ: ENQ DC2,
ACK: ACK DC2,
NAK: NAK DC2,
SYN: SYN DC2,

TTD: CAN DC2,
EOT: EOT \$\$\$ CHAR CHAR CHAR DC2,

где три символа (CHAR) являются цифрами в кодировке ASCII, означающими коды завершения, т. е. коды ошибок с 001 по 006, упомянутые в E.5.2 и E.5.3. При нормальном завершении должен отправляться код ошибки 000.

E.5.4.2 Блоки данных имеют следующий формат:

а) Сообщение: SOH

Номер блока (последовательно возрастает от 1 до 255, затем сбрасывается до 1)
255 — номер блока (дополнение номера блока до единицы)
данные (256 байтов данных)
CRCHI
CRCLO

б) Данные: STX

Номер блока (последовательно возрастает от 1 до 255, затем сбрасывается до 1)
255 — номер блока (дополнение номера блока до единицы)
данные (256 байтов данных)
CRCHI
CRCLO

Примечание — Для сообщений и блоков данных используется один и тот же счетчик номеров. Он должен прирастать для каждого экземпляра блока любого типа.

E.5.5 Алгоритм обнаружения ошибок CRC

Алгоритм вычисления контрольной суммы CRC основан на полиноме CRC-CCITT ($X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$). Контрольная сумма CRC является 16-битовым числом, которому должно быть присвоено двоичное значение из всех единиц (FFFF hex) перед началом вычисления для каждого блока данных. CRC вычисляется для всего блока данных вплоть до самого значения CRC, как показано на рисунке E.1.

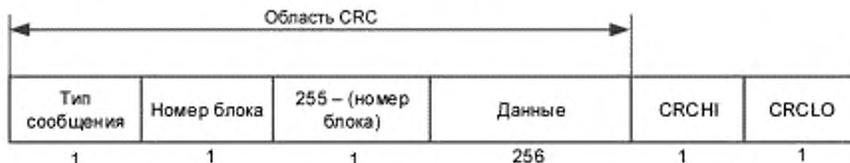


Рисунок E.1 — Обнаружение ошибок в соответствии с CRC-CCITT

Алгоритм CRC-CCITT описан ниже. Учтите, что все операции осуществляются над байтами.

A — новый байт;

B — временный байт;

CRCHI — старший байт (старший значащий) 16-битовой CRC;

CRCLO — младший байт (младший значащий) 16-битовой CRC.

START:

FOR A = FIRST_BYTE TO LAST_BYTE IN BLOCK DO:

A = A XOR CRCHI

CRCHI = A

SHIFT A RIGHT FOUR TIMES (ЗАПОЛНЕНИЕ НУЛЯМИ)

A = A XOR CRCHI { I J K L M N O P }

CRCHI = CRCLO { перестановка CRCHI, CRCLO }

CRCLO = A

ROTATE A LEFT 4 TIMES { M N O P I J K L }

B = A { сохранить во временном байте }

ROTATE A LEFT ONCE { N O P I J K L M }

A = A AND \$1F { 0 0 0 1 J L L M }

CRCHI = A XOR CRCHI

A = B AND \$F0 { M N O P 0 0 0 0 }

CRCHI = A XOR CRCHI { завершить вычисление CRCHI }

ROTATE B LEFT ONCE { N O P 0 0 0 0 M }

B = B AND \$E0 { N O P 0 0 0 0 0 }

CRCLO = B XOR CRCLO { завершить вычисление CRCLO }

DOEND;

FINISH

Последняя проверка CRC осуществляется с помощью добавления (конкатенации) CRCHI и CRCLO к концу потока данных. Контрольная сумма CRC, вычисленная для дополненного потока данных, должна быть нулевой, если данные были получены правильно.

E.5.6 Диаграммы переходов состояний (STD — State transition diagram)

E.5.6.1 Схема потоков данных (не STD)

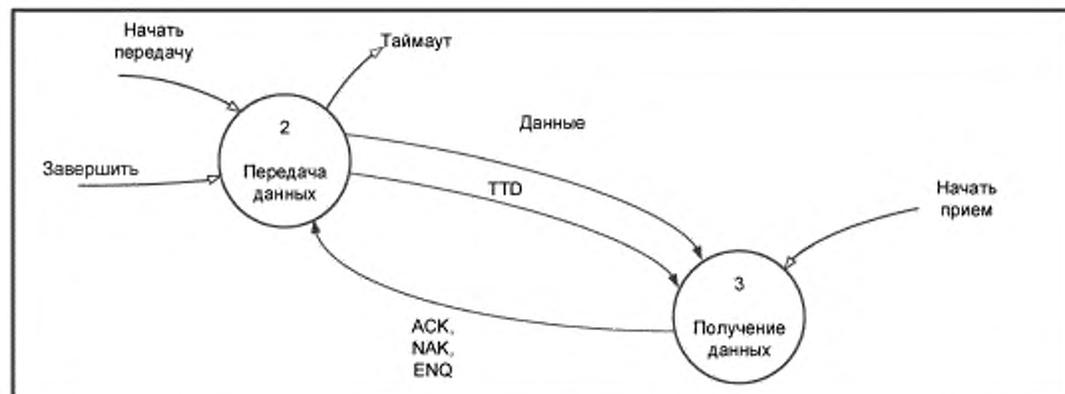


Рисунок E.2 — Схема потоков данных

E.5.6.2 Диаграмма переходов состояний передатчика

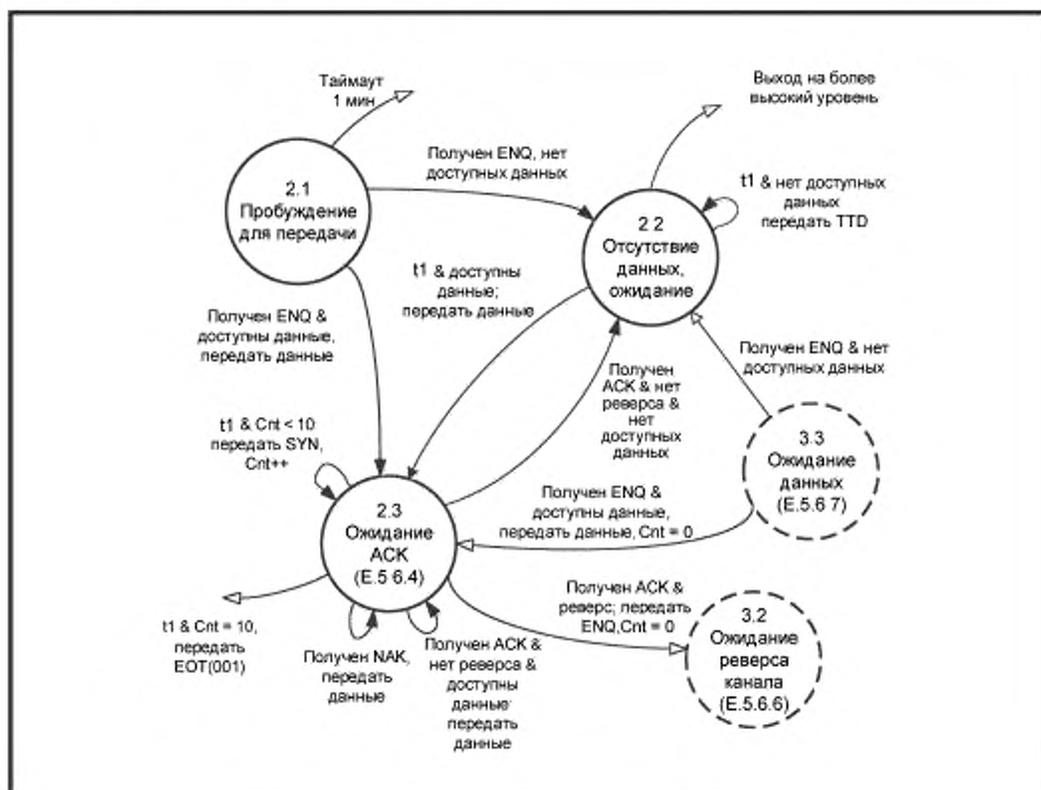


Рисунок E.3 — Диаграмма перехода состояний передатчика

E.5.6.3 Диаграмма переходов для состояния «Отсутствие данных, Ожидание»

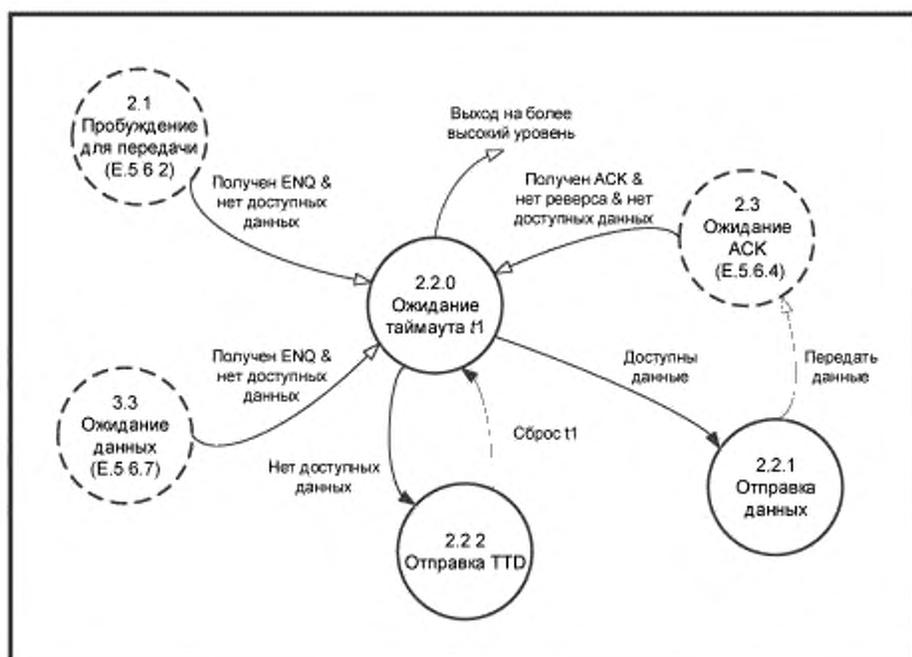


Рисунок E.4 — Диаграмма переходов для состояния «Отсутствие данных, Ожидание»

E.5.6.4 Диаграмма переходов для состояния «Ожидание ACK»

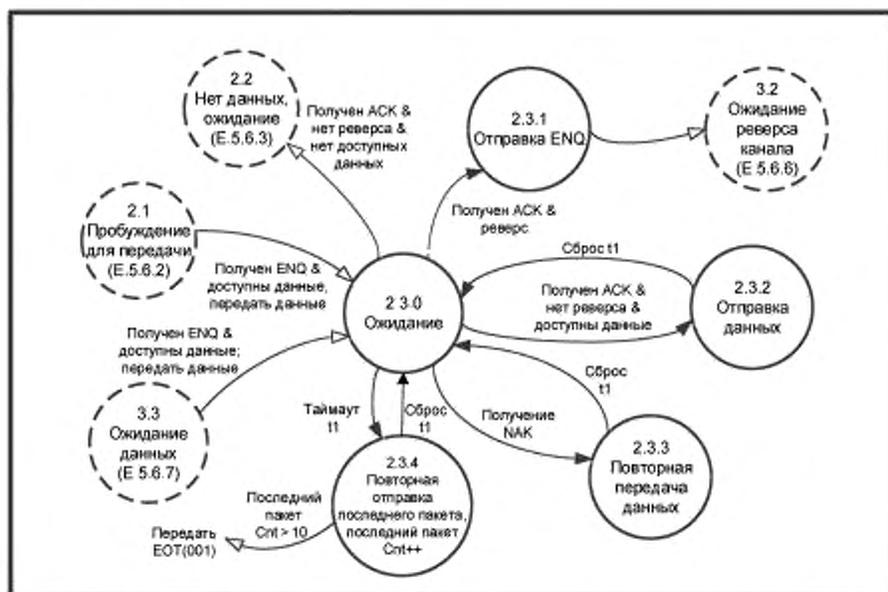


Рисунок E.5 — Диаграмма переходов для состояния «Ожидание ACK»

E.5.6.5 Диаграмма переходов состояний приемника

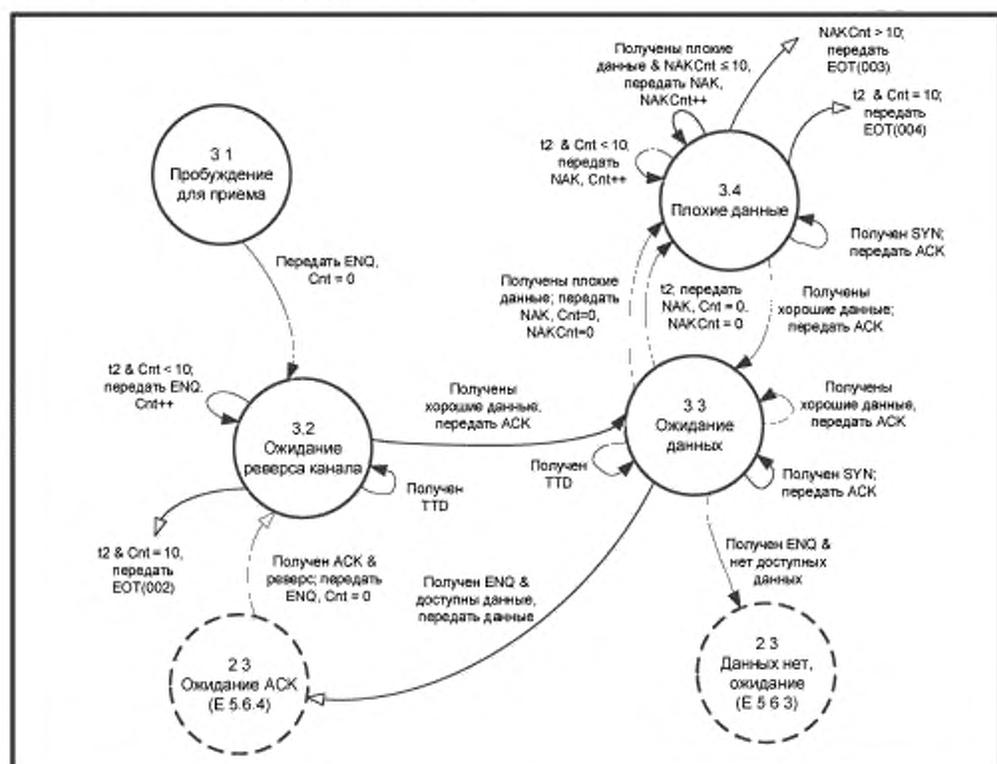


Рисунок E.6 — Диаграмма перехода состояний приемника

E.5.6.6 Диаграмма переходов для состояния «Ожидание реверса канала»

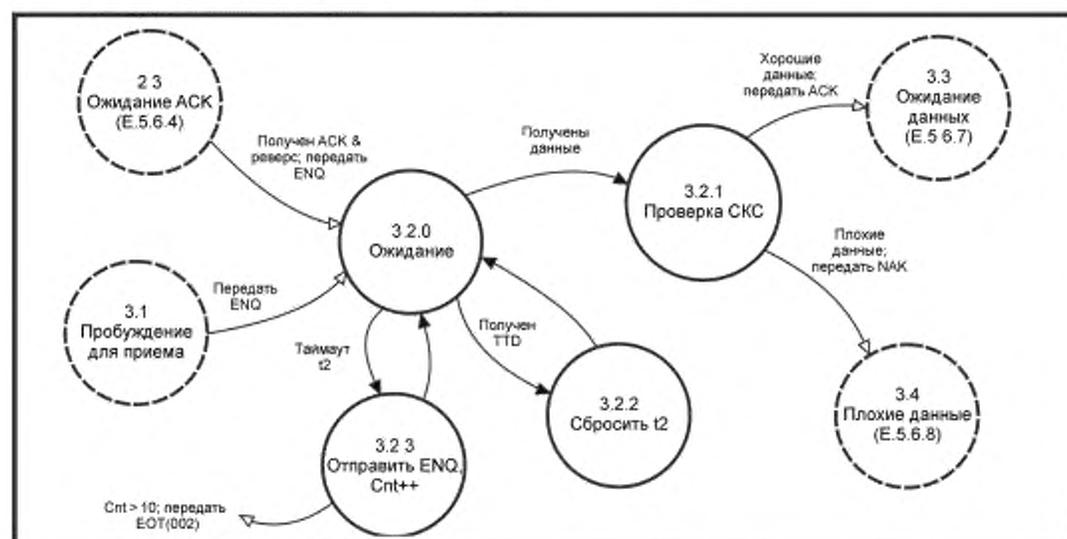


Рисунок E.7 — Диаграмма переходов для состояния «Ожидание реверса канала»

E.5.6.7 Диаграмма переходов для состояния «Ожидание данных»

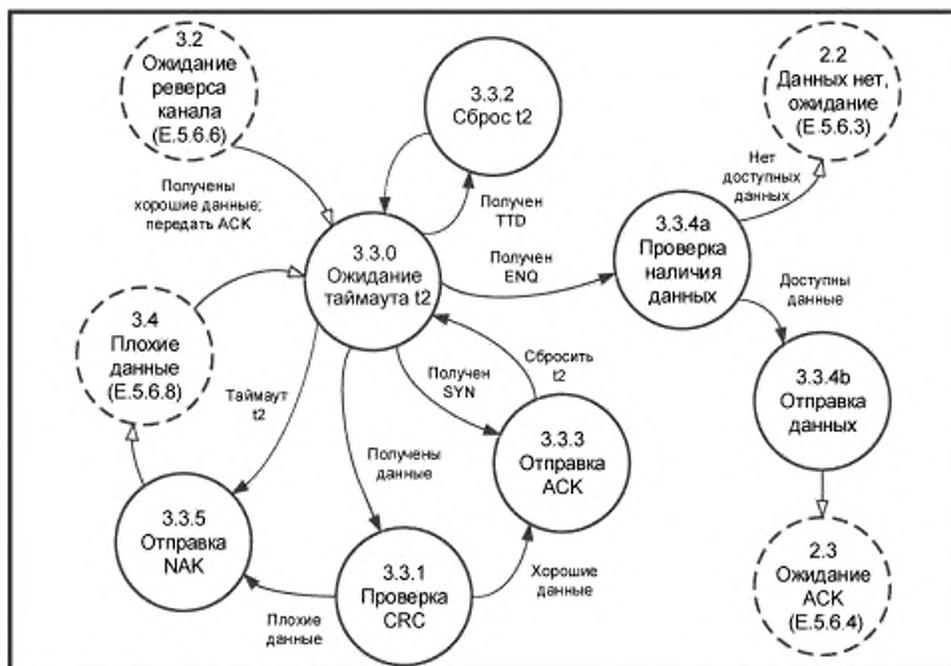


Рисунок E.8 — Диаграмма переходов для состояния «Ожидание данных»

E.5.6.8 Диаграмма переходов для состояния «Плохие данные»

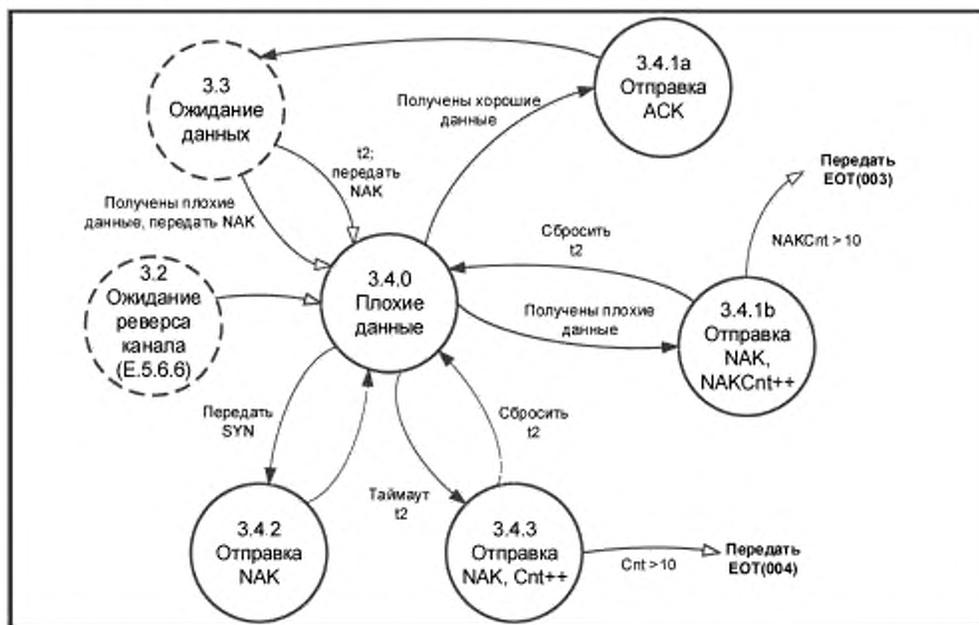


Рисунок E.9 — Диаграмма переходов для состояния «Плохие данные»

E.5.7 Сценарий коммуникаций

Сценарий, в котором электрокардиограф отправляет ЭКГ центральной системе управления ЭКГ.

	Устройство картирования (инициатор)	Система (ответчик)	Комментарий
a)		ENQ	Готовность к приему.
b)	SOH		Идентификация (вход в сеанс).
c)		ACK	Подтверждение.
d)	ENQ		Реверс канала.
e)		SOH	Идентификация (завершение входа в сеанс).
f)	ACK		Подтверждение.
g)		ENQ	Реверс канала.
h)	SOH		Устройство картирования запрашивает отправку ЭКГ.
i)		ACK	Подтверждение.
j)	ENQ		Реверс канала.
k)		SOH	Статус (система получила данные успешно).
l)	ACK		Подтверждение.
m)		ENQ	Реверс канала.
n)	STX		Передача ЭКГ.
o)		ACK	Подтверждение.
p)	STX		Данные ЭКГ.
...			
q)		Запись ЭКГ передана.
...			
r)		ACK	Подтверждение.
s)	ENQ		Реверс канала (выполняется после получения ЭКГ).
t)		SOH	Статус (система получила данные успешно).
u)	ACK		Подтверждение.
v)		ENQ	Реверс канала.
w)	SOH		Выполнено (больше данных нет).
x)		ACK	Подтверждение.
y)	ENQ		Реверс канала.
z)		SOH или EOT	Запрос (система может отправить свой собственный запрос) или прекратить вызов (см. E.5.1.5).

Приложение F
(справочное)

Универсальные коды интерпретирующих описаний электрокардиограммы

F.1 Общие положения

Универсальные коды интерпретации ЭКГ могут использоваться в дополнение к свободному тексту для обмена интерпретирующими описаниями между различными системами анализа ЭКГ, а также между такими системами и клиническими рабочими станциями и больничными информационными системами.

Общий набор кодов описаний является крайне важным для обмена сообщениями, интерпретирующими ЭКГ, в многоязычной среде. Он также является важным ресурсом для сжатия данных.

Эти коды могут использоваться в том числе для хранения предыдущих расшифровок, важного в силу юридических аспектов. Изменения, внесенные кардиологом в компьютерную интерпретацию, необходимо хранить. Они должны быть доступны врачам общей практики или другим специалистам, а также третьим сторонам.

F.2 Ограничения

Представленная ниже схема кодирования демонстрирует «прагматичный» подход к решению проблемы отображения компьютерных описаний на общепринятый и понятный лексикон. Предлагаются простые, базовые мнемокоды, их модификаторы и союзы, которые можно использовать для создания и отображения как простых, так и достаточно сложных интерпретирующих описаний ЭКГ.

Необходимо ясно понимать, что не предполагается, что компьютерные программы будут пытаться интерпретировать ЭКГ, используя все описания, перечисленные в данном приложении. Это выходит за рамки существующей технологии и даже желаний кардиологов. На самом деле, если используется только ЭКГ, то некоторые из описаний, перечисленных в данном приложении, трудно сделать объективными. При разработке настоящего стандарта не было желания давать оценку полезности или ограничений стандартной электрокардиографии. Тем не менее в данном приложении предпринята попытка дать достоверное представление о терминологии электрокардиографии и описаний ЭКГ, используемой в современной практике.

F.3 Создание кода и общие синтаксические правила

F.3.1 Общий принцип

Используются мнемокоды, которые широко используются в литературе и которые, вероятно, могут запомнить врачи, выполняющие расшифровку ЭКГ. Эти мнемокоды могут быть преобразованы в числовые коды для «внутреннего» использования в программе. Нельзя ожидать, что специалист по электрокардиографии, который лишь иногда имеет дело с компьютерными интерпретациями ЭКГ, запомнит шифры кодов или порой достаточно сложные мнемокоды, используемые в программах различных производителей.

Используя гибкую, но уникальную структуру кодов, можно добиться того, чтобы компьютер был способен получить хотя бы общее представление об изменениях, выполняемых читателями, не заставляя их оперировать числами. С другой стороны, довольно сложные конструкции, встречающиеся в свободном тексте описаний, интерпретируемых компьютером, могут быть с помощью акронимов и простых синтаксических правил преобразованы в универсально понимаемые коды описаний.

F.3.2 Базовая композиция кода

Универсальный код интерпретации SCP-ECG состоит из одного или нескольких полей. Принципиальных ограничений числа различных полей нет, разве что синтаксический анализ и формулировка интерпретирующего описания могут оказаться слишком долгими.

Первое поле (5 байтов) определяет базовую диагностическую интерпретацию или описательное утверждение.

Второе поле (1 или 2 байта) в основном используется для указания предполагаемой вероятности того, что описание правильное, или для определения степени вероятности.

Например,

A или DE — определено;

B или PR — вероятно;

C или PS — возможно;

U или UN — неизвестно;

D или CE — исключено/нельзя исключить;

SS — убедительный признак;

CO — рассмотреть возможность;

CW — согласуется.

Второе поле может также использоваться для других целей.

Третье и другие поля (по 2 байта) используются для других модификаторов.

F.3.3 Модификаторы

Могут использоваться следующие модификаторы:

1) стадия развития инфаркта или ишемических изменений ST-T:

OL — рубцевание (old);	EV — развивающийся (evolving);
RE — острейший (recent);	XO — вероятно, рубцевание (probably old);
AC — острый (acute);	XA — вероятно, острый (острейший) [probably acute (recent)];
SU — подострый (subacute);	YO — предположительно рубцевание (possibly old);
AI — стадия не определена (age indeterminate);	YA — предположительно острый (possibly acute);
AU — вопрос о стадии открыт (age undeterminate).	

2) локализация ST-T и других патологических изменений:

AN — передний (anterior);	BA — базальный (basal);
AS — переднеперегородочный (anteroseptal);	AF — передне-нижний (anteroinferior);
AL — передне-боковой (anterolateral);	SE — септальный (septal);
IN — нижний (inferior);	PL — задне-боковой (posterolateral);
IL — ниже-боковой (inferolateral);	SN — субэндокардиальный (subendocardial);
LA — боковой (lateral);	SP — субэпикардиальный (subepicardial);
HL — высокий латеральный (high lateral);	EX — обширный (extensive);
IP — ниже-задний (inferoposterior);	WI — распространенный (widespread);
DI — диффузный (diffuse);	

3) степень тяжести патологического изменения, например, гипертрофии, нарушения проводимости или депрессии сегмента ST:

MA — значительная (major), MO — умеренная (moderate) и MI — легкая (minor).

Может использоваться другая схема кодирования, например, с S1 по S5, где степень S1 используется для указания легкой тяжести, а степень S5 представляет собой очень значительную тяжесть;

4) развивающийся характер или период действия некоторых патологических изменений:

SE — последовательные изменения, согласующиеся с... (serial changes consistent with...);

CC — продолжающиеся изменения... (continuing changes of...);

OC — редкие (occasional);

TR — кратковременные (transient);

UF — унифокальные (unifocal);

IM — интермиттирующие (intermittent);

FR — частые (frequent);

MF — мультифокальные (multifocal);

TE — временные (temporagary);

EV — развивающиеся (evolving);

NE — новые (new);

MU — множественные (multiple);

5) патофизиологический характер изменений ST-T:

LV — совместим с напряжением левого желудочка (compatible with left ventricular strain);

MD — совместим с ишемическим поражением миокарда (compatible with myocardial ischemic damage);

PE — совместим с перикардитом (compatible with pericarditis);

EL — совместим с электролитными аномалиями (compatible with electrolyte abnormalities);

6) нормальное или аномальное состояние:

NO — в пределах нормы (within normal limits);

NX — может быть вариантом нормы (may be normal variant);

BO — пограничное (borderline);

AB — аномальное (abnormal);

BN — пограничное нормальное (borderline normal);

BA — пограничное аномальное (borderline abnormal);

7) модификаторы ритма/анатомические локализации:

SI — синусовый (sinus);

AT — предсердный (atrial);

SV — суправентрикулярный (supraventricular);

ND — узловой (nodal);

VE — вентрикулярный (ventricular);

8) прочие термины:

IC — неполный (incomplete);

CP — полный (complete);

TY — типичный (typical);

YT — атипичный (atypical).

Примечание — AT означает «предсердный», см. перечисление 7) выше.

F.3.4 Разделители

1) Разные поля в описаниях кода разделяются с помощью нижнего подчеркивания, например, LVH_PR.

2) Основной диагностический код ставится первым. Модификатор достоверности или вероятности кода ставится вторым (как это показано в перечислении 1) (LVH_PR). Если программа или читатель не уверены в

модификаторе, например касающемся стадии инфаркта или ишемических изменений ST-T, то к этому модификатору следует добавить модификатор достоверности, как это показано в следующих примерах:

AMI_PR_AC — вероятный острый передний инфаркт.

AMI_AC_PR — передний инфаркт, вероятно, острый.

AMI_PR_AC_PR — вероятный передний инфаркт, вероятно, острый.

Во втором случае предполагается (определенная) уверенность возникновения инфаркта, но неуверенность в его стадии.

3) Различные коды описаний отделяются друг от друга с помощью точки с запятой. Во время передачи данных перед описаниями идут порядковые номера (см. протокол SCP-ECG). Эти порядковые номера могут использоваться для соединения различных описаний, но для этой цели могут также использоваться термины связи.

Ф.3.5 Термы связи

Термы связи могут использоваться для связи описаний или для создания составных описаний.

1) Классические булевы операторы могут применяться как союзы, т. е.: AND, OR, NOT, XOR, EOR.

Союз NOT может использоваться для указания на то, что основное описание является истинным «в отсутствие» или «без» следующего описания;

2) Приведенные ниже арифметические операторы и операторы отношений могут использоваться как союзы:

ADD — сложить (+);

SUB — вычесть (-);

MPY — умножить (*);

DIV — разделить (/);

EXP — экспонента;

SQR — квадратный корень;

ABS — абсолютное значение;

MAX — максимальное значение;

MIN — минимальное значение;

EQU — равно;

ILT — меньше чем;

IGT — больше чем;

INE — равно;

IGE — больше или равно;

ILE — меньше или равно;

3) Термы связи для последовательного сравнения, например:

SER — последовательные изменения;

DEC — снижено (по сравнению с предыдущей записью);

INC — повышено (по сравнению с предыдущей записью);

UNC — неизменное/не изменилось (по сравнению с предыдущей записью);

CHG — измененное/было изменено (по сравнению с предыдущей записью);

DIS — (теперь) исчезло (по сравнению с предыдущей записью);

REP — (теперь) заменено [(описание) было представлено ранее];

IMP — улучшено (по сравнению с);

WRS — ухудшено (по сравнению с);

4) Могут также использоваться другие термины связи, например:

RES — чтобы указать на то, что основное описание «приводит к» к (или «вызывает») следующее описание (results);

SEC — чтобы указать на то, что основное описание является «вторичным» по отношению к последующему описанию (secondary);

ASS — связано с (associated);

EXC — исключить, отклонить или учесть также следующее описание (exclude);

WTH — с (with);

ALT — является альтернативой для (alternating with).

Термы связи могут иметь максимальный размер 3 байта и ставятся между двумя точками с запятой для связи двух отдельных описаний.

Связывание термов связи в рамках составного описания выполняется с помощью нижнего подчеркивания (_).

Ф.4 Акронимы в интерпретирующих описаниях ЭКГ

Ф.4.1 Ссылки, используемые при детальной разработке этого предложения

Чтобы детально разработать данное предложение, рассматривались списки акронимов, встречающихся в интерпретирующих описаниях ЭКГ, выдаваемых различными компьютерными программами. Эти списки можно найти в пятом и восьмом Докладах о работе CSE (Canadian Society of Echocardiography — Канадское общество по электрокардиографии), а также в руководствах для врачей от нескольких производителей.

Кроме того, часто используются два отчета по «Стандартизации терминологии и интерпретации» и по «Определениям и классификации сердечной аритмии». Эти отчеты опубликованы в Amer. J. Cardiology (1978, 41, pp. 130—145) и в Amer. Heart J. (1978, 95, pp. 796—806) соответственно.

F.4.2 Акронимы**F.4.2.1 Нормальное/аномальное состояние**

NORM	нормальная ЭКГ;
NLECG	нормальная ЭКГ;
NLQRS	нормальная QRS;
NLP	нормальный P-зубец;
NLSTT	нормальный ST-T;
WHNOR	ЭКГ в рамках половозрастной нормы;
POSNL	вероятно, нормальное ЭКГ;
VOECG	пограничная ЭКГ;
ABECG	анормальная ЭКГ;
POSAV	вероятно, анормальная ЭКГ;
ABQRS	анормальная QRS;
ABSTT	анормальная ST-T;
NFA	норма для возраста;
NFB	норма для телосложения;
ABFA	ненормально для возраста;
ABFB	ненормально для телосложения;
UFB	необычно для телосложения.

F.4.2.2 Гипертрофия желудочка

LVH	гипертрофия левого желудочка (left ventricular hypertrophy);
VCLVH	критерии вольтажа (QRS) для гипертрофии левого желудочка [voltage criteria (QRS) for left ventricular hypertrophy];
RVH	гипертрофия правого желудочка (right ventricular hypertrophy);
VCRVH	критерии вольтажа (QRS) для гипертрофии правого желудочка [voltage criteria (QRS) for right ventricular hypertrophy];
BVH	бивентрикулярная гипертрофия (biventricular hypertrophy);
SEHYP	септальная гипертрофия;
PRANT	высокий зубец R в отведении V1 (prominent anterior forces).

F.4.2.3 Инфаркт миокарда

(Локализация инфаркта преимущественно определяется базовым акронимом, но может также определяться с помощью модификатора локализации.)

MI	инфаркт миокарда (myocardial infarction);
AMI	передний инфаркт миокарда (anterior myocardial infarction);
ASMI	переднелатеральный инфаркт миокарда (anteroseptal myocardial infarction);
ALMI	инфаркт миокарда передне-боковой (anterolateral myocardial infarction);
LMI	инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка (lateral myocardial infarction);
HLMI	верхне-боковой инфаркт миокарда высокого отдела боковой стенки левого желудочка (high-lateral myocardial infarction);
APMI	инфаркт миокарда верхушки левого желудочка (apical myocardial infarction);
IMI	нижний диафрагмальный инфаркт миокарда (inferior myocardial infarction);
ILMI	инфаркт миокарда задней и боковой стенок левого желудочка (inferolateral myocardial infarction);
IPMI	заднедиафрагмальный инфаркт миокарда (inferoposterior myocardial infarction);
IPLMI	инфаркт ниже-задне-боковой стенки левого желудочка (inferoposterolateral myocardial infarction);
PMI	нижний инфаркт миокарда (posterior myocardial infarction).

F.4.2.4 Нарушения проводимости

(Определения см. в J. Amer. Coll. Cardiol., 5, pp. 1261—1275, 1985.)

BBB	неуточненная блокада ножки пучка Гиса (unspecified bundle branch block);
CLBBB	полная блокада ножки пучка Гиса (complete left bundle branch block);
ILBBB	полная блокада ножки пучка Гиса (incomplete left bundle branch block);
ALBBB	атипичная блокада ножки пучка Гиса (atypical left bundle branch block);
CRBBB	полная блокада правой ножки пучка Гиса (complete right bundle branch block);
IRBBB	неполная блокада правой ножки пучка Гиса (incomplete right bundle branch block);
IVCD	неспецифическое нарушение внутрижелудочковой проводимости (блокада) [non-specific intraventricular conduction disturbance (block)];
IVCD>	нарушение внутрижелудочковой проводимости (QRS > 120 мс) [intraventricular conduction disturbance (QRS > 120 ms)];
IVCD<	незначительное нарушение внутрижелудочковой проводимости (QRS < 120 мс) [minor intraventricular conduction disturbance (QRS < 120 ms)];
WPW	синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта (Wolf — Parkinson — White syndrome);
WPWA	синдром Вольфа — Паркинсона тип A (Wolf — Parkinson type A);

WPWB	синдром Вольфа — Паркинсона тип В (Wolf — Parkinson type B);
PREEX	преждевременное возбуждение (pre-excitation);
LAFB	блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса (left anterior fascicular block);
LPFB	блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса (left posterior fascicular block);
BIFAS	бифасцикулярная блокада (два компонента этой блокады всегда должны приводиться раздельно) [bifascicular block (its two components shall always be listed separately)];
TRFAS	трифасцикулярная блокада.

F.4.2.5 Другая морфология QRS или обобщающие описания

COPD	ЭКГ, указывающая на хроническое обструктивное заболевание легких (ECG consistent with chronic obstructive pulmonary disease);
PE	эмфизема легких (pulmonary emphysema);
QWAVE	наличие Q-зубцов (Q waves present);
POORR	малый прирост зубца R в грудных отведениях (poor R-wave progression in precordial leads);
ABRPR	аномальный прирост зубца R (abnormal R-wave progression);
PROMR	высокий зубец R в правых грудных отведениях (prominent R waves in right precordial leads);
DXTRO	декстрокardia (dextrocardia);
LVOLT	низкий вольтаж QRS в отведениях, расположенных во фронтальной и горизонтальной плоскости (low QRS voltages in the frontal and horizontal leads);
HVOLT	высокий вольтаж QRS (high QRS voltage);
LVOLF	низкий вольтаж в отведениях, расположенных во фронтальной плоскости (low voltage in frontal leads);
LVOLH	низкий вольтаж QRS в отведениях, расположенных в горизонтальной плоскости (low QRS voltages in the horizontal leads);
HVOLF	высокий вольтаж QRS в отведениях, расположенных во фронтальной плоскости (high voltage in frontal leads);
HVOLH	высокий вольтаж QRS в отведениях, расположенных в горизонтальной плоскости (high QRS voltages in the horizontal leads);
S1S23	электрическая ось сердца по типу S1-S2-S3 (S1 S2 S3 type QRS pattern);
RSR1	комплекс типа rSr' в V1 или V2 (rSr' type in V1 or V2);
TRNZL	смещение переходной области в грудных отведениях влево (transition zone in precordial leads displaced to the left);
TRNZR	смещение переходной области в грудных отведениях вправо (transition zone in precordial leads displaced to the right);
MYOPA	указывает на кардиомиопатию (compatible with cardiomyopathy);
MYOCA	указывает на миокардит (compatible with myocarditis);
CRIMA	критерии для (criteria for);
CRIMO	умеренные критерии для (moderate criteria for);
CRIMI	минимальные критерии для (minimal criteria for).

F.4.2.6 Описания ритма

(Определения описаний ритма см. в Amer. Heart J., 95, pp. 796—806, 1978.)

Описания, связанные с формированием импульса (аномалиями):

SR	синусовый ритм (sinus rhythm);
NSR	нормальный синусовый ритм (normal sinus rhythm);
SARRH	синусовая аритмия (sinus arrhythmia);
MSAR	выраженная синусовая аритмия (marked sinus arrhythmia);
SVARR	суправентрикулярная аритмия (supraventricular arrhythmia);
STACH	синусовая тахикардия (sinus tachycardia);
ETACH	экстремальная тахикардия (extreme tachycardia);
SBRAD	синусовая брадикардия (sinus bradycardia);
EBRAD	экстремальная брадикардия (extreme bradycardia);
JTACH	узловая тахикардия (junctional tachycardia);
SVTAC	суправентрикулярная тахикардия (supraventricular tachycardia);
JBRAD	узловая брадикардия (junctional bradycardia);
SVBRA	суправентрикулярная брадикардия (supraventricular bradycardia);
WQTAC	тахикардия с широкими комплексами QRS (wide QRS tachycardia);
NQTAC	тахикардия с узкими комплексами QRS (narrow QRS tachycardia);
TACHO	тахикардия, происхождение неизвестно или не указано (tachycardia, origin unknown or not specified);
BRADO	брадикардия, происхождение неизвестно или не указано (bradycardia, origin unknown or not specified);
ARRHY	аритмия, происхождение неизвестно (arrhythmia, origin unknown);
IRREG	нерегулярный ритм (irregular rhythm);
REGRH	регулярный ритм (regular rhythm);
JESCR	замещающий узловой ритм (junctional escape rhythm);
VESCR	замещающий желудочковый ритм (ventricular escape rhythm);

ACAR	ускоренный предсердный ритм (accelerated atrial rhythm);
ACVR	ускоренный желудочковый ритм (accelerated ventricular rhythm);
ACJR	ускоренный узловой ритм (accelerated junctional rhythm);
AVJR	атриовентрикулярный узловой ритм (AV-junctional rhythm);
ARHYT	предсердный ритм (atrial rhythm);
SVRHY	суправентрикулярный ритм (supraventricular rhythm);
JRHYT	узловой ритм (junctional rhythm);
VRHYT	желудочковый ритм (ventricular rhythm);
UNRHY	неустановленный ритм (undetermined rhythm);
EAR	эктопический предсердный ритм (ectopic atrial rhythm);
LAR	левопредсердный ритм (left atrial rhythm);
MAR	мультифокальный предсердный ритм (multifocal atrial rhythm);
NODRH	атриовентрикулярный ритм (nodal rhythm);
RAR	нижний правопредсердный ритм (low right atrial rhythm);
LGL	синдром Лауна — Ганонга — Левина (Lown — Ganong — Levine syndrome);
SHTPR	короткий PR-интервал (short PR-interval);
AFIB	предсердная фибрилляция (atrial fibrillation);
AFLT	трепетание предсердий (atrial flutter);
ATACH	предсердная тахикардия (atrial tachycardia);
PSVT	пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия (paroxysmal supraventricular tachycardia);
PAT	пароксизмальная предсердная тахикардия (paroxysmal atrial tachycardia);
MFAT	мультифокальная предсердная тахикардия (multifocal atrial tachycardia);
RATAC	пробежка предсердной тахикардии (run of atrial tachycardia);
RJTAC	пробежка узловой тахикардии (run of junctional tachycardia);
AVNRT	атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia);
AVRT	атриовентрикулярная реципрокная тахикардия (atrioventricular reciprocating tachycardia);
IDIOR	идиовентрикулярный ритм (idioventricular rhythm);
VFIB	фибрилляция желудочков (ventricular fibrillation);
VTACH	желудочковая тахикардия (ventricular tachycardia);
RVTAC	пробежка желудочковой тахикардии (run of ventricular tachycardia);
SVT	стойкая желудочковая тахикардия (sustained ventricular tachycardia);
NSVT	стойкая желудочковая тахикардия (non-sustained ventricular tachycardia);
TORSA	полиморфная желудочковая тахикардия типа «пируэт» (torsade des pointes ventricular tachycardia);
MTACH	мультифокальная тахикардия (полиморфная), суправентрикулярная или желудочковая [multifocal tachycardia (multiform), supraventricular or ventricular];
VFLT	трепетание желудочков (ventricular flutter);
ASYST	асистолия.
Дисфункция синусового узла, предсердные и атриовентрикулярные нарушения проводимости:	
1AVB	AV-блокада первой степени (first degree AV block);
2AVB	AV-блокада второй степени (second degree AV block);
3AVB	AV-блокада третьей степени (third degree AV block);
I2AVB	интермиттирующая AV-блокада второй степени (intermittent second degree AV block);
A2AVB	чередующаяся AV-блокада второй степени (alternating second degree AV block);
AVDIS	AV-диссоциация (AV-dissociation);
WENCK	периоды Венкебаха (Wenckebach phenomenon);
MOB12	AV блокада второй степени типа Мобитц 2 (Mobitz type 2 second degree AV block);
SAR	остановка синусового узла (sinus arrest);
SARA	остановка синусового узла с замещением на предсердный ритм (sinus arrest with atrial escape);
SARSV	остановка синусового узла с замещением на суправентрикулярный ритм (sinus arrest with supraventricular escape);
SARJ	остановка синусового узла с замещением на узловой ритм (sinus arrest with junctional escape);
SARV	остановка синусового узла с замещением на желудочковый ритм (sinus arrest with ventricular escape);
SABLK	синоаурикулярная блокада (sino-atrial block);
SPAUS	синусовая пауза (sinus pause);
WANDP	миграция водителя ритма (wandering pacemaker);
LRR	длинный измеренный интервал R-R (long R-R interval measured);
OCAP	периодический захват (occasional capture).
Описания, связанные с аномалиями эктопического ритма:	
PRC(S)	экстрасистола(ы) [premature complex(es)];
PAC или APC (APB)	предсердная экстрасистола (импульс) (не рекомендуется использовать APB) [atrial premature complex (beat) (use of APB is not recommended)];

BPAC	блокированное раннее предсердное сокращение (blocked premature atrial contraction);
MAPCS	множественные ранние предсердные экстрасистолы (blocked premature atrial contraction);
PVC или VPC (VPB)	желудочковая экстрасистола (импульс) (не рекомендуется использование VPB) [ventricular premature complex (beat) (use of VPB is not recommended)];
MVPCS	множественные желудочковые экстрасистолы (multiple premature ventricular complexes);
RVPCS или RPVCS	пробежка желудочковых экстрасистол (run of ventricular premature complexes);
RAPCS	пробежка предсердных экстрасистол (run of atrial premature complexes);
RJPCS	пробежка узловых экстрасистол (run of junctional premature complexes);
VIC	интерполированные желудочковые экстрасистолы (ventricular interpolated complexes);
MVICS	множественные интерполированные желудочковые экстрасистолы (multiple interpolated complexes);
MICS	множественные желудочковые экстрасистолы (multiple interpolated complexes);
SVPC	суправентрикулярная экстрасистола (supraventricular premature complex);
SVPCS	(множественные) суправентрикулярные экстрасистолы [(multiple) supraventricular premature complexes];
SVIC(S)	интерполированная суправентрикулярная экстрасистола(ы) [supraventricular interpolated complex(es)];
ABER(S)	аберрантная проводимость (aberrantly conducted complex);
ABPCS	аберрантные экстрасистолы, источник неизвестен (aberrant premature complexes, origin unknown);
ABSVC	аберрантный комплекс, вероятно, суправентрикулярного происхождения (aberrant complex, possibly supraventricular origin);
ABSVS	аберрантные комплексы, вероятно, суправентрикулярного происхождения (aberrant complexes, possibly supraventricular origin);
ABASH	аберрантные суправентрикулярные комплексы типа Ашмана (aberrant supraventricular complexes of the Ashman type);
JPC(S)	узловая экстрасистола(ы) [junctional premature complex(es)];
MJPCS	множественные узловые экстрасистолы (multiple junctional premature complexes);
PVPCS или PPVCS	парные желудочковые экстрасистолы (paired ventricular premature complexes);
PAPCS	парные предсердные экстрасистолы (paired atrial premature complexes);
RJPCS	парные узловые экстрасистолы (paired junctional premature complexes);
OVPAC	периодические желудочковые комплексы, инициируемые кардиостимулятором (occasional ventricular paced complexes);
ONPAC	периодические комплексы, не инициируемые кардиостимулятором (occasional non-paced complexes);
VBIG	желудочковая бигеминия (ventricular bigeminy);
ABIG	предсердная бигеминия (atrial bigeminy);
SVBIG	суправентрикулярная бигеминия (supraventricular bigeminy);
BIGU	бигеминальная картина (источник неизвестен, суправентрикулярная или желудочковая) [bigeminal pattern (unknown origin, SV or ventricular)];
FUSC(S)	сливной комплекс(ы) [fusion complex(es)];
CAPT(S)	комплекс(ы) захвата [capture complex(es)];
VEC(S)	замещающий желудочковый комплекс(ы) [ventricular escape complex(es)];
AEC(S)	замещающий предсердный комплекс(ы) [atrial escape complex(es)];
SVEC(S)	замещающий суправентрикулярный комплекс(ы) [supraventricular escape complex(es)];
JEC(S)	замещающий узловой комплекс(ы) [junctional escape complex(es)];
ESCUN	замещающий комплекс, источник неизвестен (escape complex, origin unknown);
VPARA	желудочковая парасистолия (ventricular parasystole);
APARA	предсердная парасистолия (atrial parasystole);
VTRIG	желудочковая тригеминия (ventricular trigeminy);
ATRIG	предсердная тригеминия (atrial trigeminy);
SVTRI	суправентрикулярная тригеминия (supraventricular trigeminy);
TRIGU	тригеминальная картина (источник неизвестен, суправентрикулярная или желудочковая) [trigeminal pattern (unknown origin, SV or ventricular)];
VQUAG	желудочковая квадригеминия (ventricular quadrigeminy);
RECIP	реципрокный или возвратный импульс (reciprocal or re-entrant impulse).
Описания, связанные с (предоминирующей) проводимостью и блокадой:	
B2T1	(предоминирующая) блокада типа 2:1 [(predominant) 2:1 block];
B3T1	(предоминирующая) блокада типа 3:1 [(predominant) 3:1 block];
B4T1	(предоминирующая) блокада типа 4:1 [(predominant) 4:1 block];
B5T1	(предоминирующая) блокада типа 5:1 [(predominant) 5:1 block];

VARBL	вариабельная блокада (variable block);
EXIBL	блокада выхода (exit block);
ENTBL	блокада входа (entrance block);
VABL	атриовентрикулярная блокада (ventriculo-atrial block);
BLOCK	не специфицированная задержка или нарушение распространения импульса (unspecified delay or failure of impulse propagation);
C2T1	(преимущественная) проводимость типа 2:1 [(predominant) 2:1 conduction];
C3T1	(преимущественная) проводимость типа 3:1 [(predominant) 3:1 conduction];
C4T1	(преимущественная) проводимость типа 4:1 [(predominant) 4:1 conduction];
C5T1	(преимущественная) проводимость типа 5:1 [(predominant) 5:1 conduction];
VARCO	вариабельная проводимость (variable conduction);
SVR	медленный желудочковый ответ (slow ventricular response);
IVR	иррегулярный желудочковый ответ (irregular ventricular response);
RVR	быстрый желудочковый ответ (rapid ventricular response);
WRV	значительная вариация желудочкового ответа (wide rate variation);
AAVCO	ускоренная AV-проводимость (accelerated AV conduction);
RETCO	ретроградная проводимость (retrograde conduction);
ANTCO	антероградная проводимость (anterograde conduction);
ORTCO	ортоградная проводимость (orthograde conduction);
ABBCO	абберрантная проводимость (aberrant conduction);
CONCO	скрытая проводимость (concealed conduction);
AVREN	атриовентрикулярная узловая циркуляция (AV nodal re-entry);
CONRE	внутренняя циркуляция возбуждения (concealed re-entry);
RENTR	феномен циркуляции возбуждения (re-entry phenomenon);
AECHO	возвращение импульса в камеру его возникновения: предсердие (return of impulse to its chamber of origin: the atrium);
VECHO	возвращение импульса в камеру его возникновения: желудочек (return of impulse to its chamber of origin: the ventricle);
FCOUP	фиксированный период между нормальным сокращением сердца и экстрасистолой (fixed coupling interval);
VCOUP	вариабельный период между нормальным сокращением сердца и экстрасистолой (variable coupling interval).

Типы кардиостимулятора и функция кардиостимулятора:

PACE	нормально функционирующий кардиостимулятор (normal functioning artificial pacemaker);
PACEA	ритм кардиостимулятора со стимуляцией 100 % (artificial pacemaker rhythm with 100 % capture);
PACEP	ритм кардиостимулятора с частичной стимуляцией (artificial pacemaker rhythm with partial capture);
PACEF	ритм кардиостимулятора при фибрилляции или трепетании предсердий (artificial pacemaker rhythm with underlying atrial fib or flutter);
PACED	ритм кардиостимулятора по требованию (demand pacemaker rhythm);
PACEM	неисправный кардиостимулятор (malfunctioning artificial pacemaker);
EPAVS	AV-последовательный электронный кардиостимулятор, нормальная стимуляция (electronic pacemaker AV sequential, normal capture);
EPVC	электронный кардиостимулятор, желудочковая стимуляция (electronic pacemaker, ventricular capture);
EPDM	электронный кардиостимулятор, режим работы по требованию (electronic pacemaker, demand mode);
EPFC	электронный кардиостимулятор, неэффективная стимуляция (electronic pacemaker, failure to capture);
EPFS	электрокардиостимулятор, нарушение управления (electronic pacemaker, failure to sense);
EPARV	биполярный электронный кардиостимулятор на верхушке правого желудочка (bipolar electronic pacemaker at the apex of the right ventricle);
EPU	однополярный электронный кардиостимулятор (unipolar electronic pacemaker);
EPURV	однополярный электронный кардиостимулятор на верхушке правого желудочка (unipolar electronic pacemaker at the apex of the right ventricle);
PAA	электронная предсердная кардиостимуляция (electronic atrial pacing);
PAD	двухкамерная электронная кардиостимуляция (dual chamber electronic pacing);
PAVA	электронная желудочковая кардиостимуляция с предсердным управлением (electronic ventricular pacing with atrial sensing);
PADEM	кардиостимуляция по требованию, анализ собственных сокращений сердца (demand pacing, analysis based upon intrinsic complexes);
OVPAC	периодические комплексы, инициированные желудочковой кардиостимуляцией (occasional ventricular paced complexes);
ONPAC	периодические комплексы, не связанные с кардиостимуляцией (occasional non-paced complexes).

Международная классификация типов кардиостимуляторов:

PAVVI	3-й байт — стимулируемая камера:
PAAAI	V — желудочек; A — предсердие; D — и то, и другое;
PAVAT	4-й байт — управляемая камера:
PAVDD	V, A, D — так же, как и для PAAAI; O — без управления;
PADVI	5-й байт — реакция кардиостимулятора на управляющий импульс:
PADDD	T — триггерный режим, I — ингибирование, D — двойное действие (триггерный режим стимуляции предсердия + ингибирование стимуляции желудочка или триггерный режим/ингибирование стимуляции предсердия + ингибирование стимуляции желудочка) [double (atrial triggered + ventricular inhibited or atrial triggered/inhibited + ventricular inhibited)].

Другие описания, связанные с ритмом:

ARATE	предсердный ритм (atrial rate);
VRATE	желудочковый ритм (ventricular rate);
RATE	ритм без указания, желудочковый или предсердный (но в основном желудочковый);
RHY(T)	ритм (rhythm).

F.4.2.7 Описание осей

LAD	отклонение электрической оси сердца влево во фронтальной плоскости (< -30) [left axis deviation of QRS in frontal plane (< -30)];
RAD	отклонение электрической оси сердца вправо, во фронтальной плоскости ($> +90$) [right axis deviation of QRS in frontal plane ($> +90$)];
AXL	ось отклонена влево (т. е. недостаточно существенно для классификации LAD) [leftward axis (i. e. not severe enough to be called LAD)];
AXR	ось отклонена вправо (т. е. недостаточно существенно для классификации RAD) [rightward axis (i. e. not severe enough to be called RAD)];
AXIND	ось QRS не определяется (QRS axis indeterminate);
AXSUP	отклонение оси вперед (axis shifted superiorly);
AXPOS	отклонение оси назад (axis shifted posteriorly);
AXVER	ось вертикальна во фронтальной плоскости (axis vertical in frontal plane);
AXHOR	ось горизонтальна во фронтальной плоскости (horizontal axis in frontal plane);
TRSLT	смещение переходной области в горизонтальных отведениях влево (transition in horizontal leads shifted leftward);
TRSRT	смещение переходной области в горизонтальных отведениях вправо (transition in horizontal leads shifted rightward);
CCWRT	вращение против часовой стрелки [counterclockwise (anticlockwise) rotation];
CWRT	вращение по часовой стрелке (clockwise rotation).

F.4.2.8 Описания ST-T

Предлагаются следующие базовые корни:

ISC_	ишемия (ischemic);
INJ_	субэндокардиальное повреждение (subendocardial injury);
EPI_	эпикардиальное повреждение (epicardial injury);
STT_	изменение ST-T (ST-T change);
NST_	неспецифические изменения ST (non-specific ST changes);
STE_	неспецифическое повышение ST (non-specific ST elevation);
STD_	неспецифическая депрессия ST (non-specific ST depression);
RST_	реципрокные изменения ST-T (reciprocal ST-T changes);
TAB_	аномалия зубца T (T-wave abnormality);
NT_	неспецифические изменения зубца T (non-specific T-wave changes).

Для указания локализации изменений ST-T могут использоваться два решения — добавить модификатор локализации либо расширить корень двумя дополнительными символами, указывающими область, что выполняется следующим образом:

ишемические изменения ST-T:

ISCAN	в передних отведениях (in anterior leads);
ISCAL	в передне-боковых отведениях (in anterolateral leads);
ISCIN	в нижних отведениях (in inferior leads);
ISCAS	в переднеперегородочных отведениях (in anteroseptal leads);
ISCLA	в боковых отведениях (in lateral leads);
ISCPO	в задней области (in posterior region);
ISCIP	в нижне-задней области (in inferoposterior region);
ISCIL	в нижне-боковых отведениях (in inferolateral leads);
ISCAF	в передне-нижних отведениях (in anteroinferior leads);

ISCWI	распространенные ишемические изменения ST-T (widespread ischemic ST-T changes);	
ISCDI	диффузные ишемические изменения ST-T (diffuse ischemic ST-T changes);	
	ишемические изменения ST-T, совместимые с субэндокардиальным повреждением:	
INJAN	в передних отведениях (in anterior leads);	
INJAL	в передне-боковых отведениях (in anterolateral leads);	
INJIN	в нижних отведениях (in inferior leads);	
INJAS	в переднеперегородочных отведениях (in anteroseptal leads);	
INJLA	в боковых отведениях (in lateral leads);	
INJPO	в задней области (in posterior region);	
INJIP	в нижне-задней области (in inferoposterior region);	
INJIL	в нижне-боковых отведениях (in inferolateral leads);	
INJAF	в передне-нижних отведениях (in anteroinferior leads);	
INJWI	распространенное субэндокардиальное повреждение (widespread subepicardial injury);	
INJDI	диффузное субэндокардиальное повреждение (diffuse subepicardial injury);	
	ST-T изменения, совместимые с субэпикардиальным повреждением:	
EPIAN	в передних отведениях (in anterior leads);	
EPIAL	в передне-боковых отведениях (in anterolateral leads);	
EPIIN	в нижних отведениях (in inferior leads);	
EPIAS	в переднеперегородочных отведениях (in anteroseptal leads);	
EPILA	в боковых отведениях (in lateral leads);	
EPIPO	в задней области (in posterior region);	
EPIIP	в нижне-задней области (in inferoposterior region);	
EPIIL	в нижне-боковых отведениях (in inferolateral leads);	
EPIAF	в передне-нижних отведениях (in anteroinferior leads);	
EPIWI	распространенное субэпикардиальное повреждение (widespread subepicardial injury);	
EPIDI	диффузное субэпикардиальное повреждение (diffuse subepicardial injury);	
	неспецифические изменения ST-T:	Альтернатива:
NSTAN	в передних отведениях (in anterior leads)	STNAN
NSTAL	в передне-боковых отведениях (in anterolateral leads)	STNAL
NSTIN	в нижних отведениях (in inferior leads)	STNIN
NSTAS	в переднеперегородочных отведениях (in anteroseptal leads)	STNAS
NSTLA	в боковых отведениях (in lateral leads)	STNLA
NSTPO	в задней области (in posterior region)	STNPO
NSTIL	в нижне-боковых отведениях (in inferolateral leads)	STNIL
NSTAF	в передне-нижних отведениях (in anteroinferior leads)	STNAF
NSTWI	распространенные неспецифические изменения ST-T (widespread non-specific ST-T changes)	STNWI
NSTDI	диффузные неспецифические изменения ST-T (diffuse non-specific ST-T changes)	STNDI
	неспецифический подъем ST:	
STExx	заменить xx на соответствующее отведение или локализацию, например, AN;	
	неспецифическое снижение ST:	
STDxx	заменить xx на соответствующее отведение или локализацию, например, AL;	
	другие описания ST-T:	
NDT	недиагностические аномалии T (non-diagnostic T abnormalities);	
TNOR	вариации нормального зубца T (normal T-wave variations);	
DIG	эффект дигиталиса (digitalis-effect);	
HTVOL	высокий вольтаж зубцов T (high T-voltages);	
QUIN ST-T	изменения ST-T, вызванные действием хинидина (ST-T changes due to quinidine-effect);	
PERIC ST-T	изменения ST-T, совместимые с перикардитом (ST-T changes compatible with pericarditis);	
STVAG	подъем ST в отведениях V1—V3, вероятно, связанный с повышенным тонусом блуждающего нерва (ST-elevation V1—V3 possibly due to enhanced vagal tone);	
LNGQT	длинный QT-интервал (long QT-interval);	
SHTQT	короткий QT-интервал (short QT-interval);	
HIGHT	высокая амплитуда зубцов T (high amplitude T-waves);	
LOWT	низкая амплитуда зубцов T (low amplitude T-waves);	
INVT	инвертированные зубцы T (inverted T-waves);	
HPOCA	предположительно гипокальцемия (consider hypocalcemia);	
HPOK	предположительно гипокалиемия (consider hypokalemia);	
HPRCA	предположительно гипокальцемия (consider hypocalcemia);	
HPRK	предположительно гипокалиемия (consider hypokalemia);	

STDJ	узловая депрессия ST (junctional ST depression);
REPOL	изменения ST-T, совместимые с ранней реполяризацией (ST-T changes compatible with early repolarization);
ANEUR	изменения ST-T, совместимые с аневризмой желудочка (ST-T changes compatible with ventricular aneurysm);
POSTO	послеоперационные изменения (post-operative changes);
PULM	совместимы с легочной эмболией (compatible with pulmonary embolism);
ACET	связано с работой кардиостимулятора (related to pacemaker activity);
NDOC	совместимы с эндокринным заболеванием (compatible with endocrine disease);
METAB	вероятно, связано с метаболическими изменениями (possibly due to metabolic changes);
IBP	совместимы с гипертонией (compatible with hypertension);
CONG	на фоне врожденного порока сердца (secondary to congenital heart disease);
VALV	на фоне порока клапана сердца (secondary to valvular heart disease);
RESP	на фоне заболевания органов дыхательной системы (secondary to respiratory disease);
JUV	ювенильные зубцы T (juvenile T waves);
CLIN	интерпретация с привлечением клинических данных (interpret with clinical data);
MYOIN	предположительно инфаркт миокарда (локализация не указана) [suggests myocardial infarction (no location specified)];
ISDIG	совместимы с ишемией/эффектом дигиталиса (compatible with ischemia/digitalis effect);
STNOR	вариация нормы (normal variant);
STPAC	проверить анализ ST-T на предмет эффектов кардиостимуляции (review ST-T analysis for the effects of pacing);
STPVC	постэкстрасистолические изменения зубца T (post-extrasystolic T-wave changes).
F.4.2.9 Описания, относящиеся к предсердиям	
LAO/LAE	перегрузка/расширение левого предсердия (left atrial overload/enlargement);
RAO/RAE	перегрузка/расширение правого предсердия (right atrial overload/enlargement);
BAO/BAE	перегрузка/расширение обоих предсердий (bi-atrial overload/enlargement);
IACD	задержка проведения в предсердии (intra-atrial conduction delay);
HPVOL	высокий вольтаж зубцов P (high P-voltages);
NSPEP	неспецифические аномалии зубца P (non-specific P wave abnormalities);
ABPAX	аномальная ось P (abnormal P-axis);
UNPAX	необычная ось P (unusual P-axis).
F.4.2.10 Описания, связанные с педиатрическим анализом ЭКГ	
PED	педиатрическая интерпретация (pediatric interpretation);
RVD	доминирование правого желудочка (right ventricular dominance);
ASD	изменения, совместимые с дефектом межпредсердной перегородки типа ostium secundum [changes compatible with atrial septal defect (ostium secundum)];
ECD	изменения, совместимые с атриовентрикулярным септальным дефектом (ASD ostium primum) [compatible endocardial cushion defect (ASD ostium primum)];
EBSTA	изменения, совместимые с аномалией Эбштейна;
TCA	изменения, совместимые с атрезией трехстворчатого клапана;
ACA	изменения, совместимые с аномальной локализацией коронарной артерии.
F.4.2.11 Описания, относящиеся к калибровке ЭКГ	
HSCAL	все отведения калибруются на половинном уровне от стандартного напряжения (т. е. 5 мм/мВ) [all leads half standard calibration (i. e. 5 mm/mV)];
HSPRE	грудные отведения калибруются на половинном уровне от стандартного напряжения (precordial leads half standard calibration);
HSLIM	калибровка отведений на конечностях на половинном уровне от стандартного напряжения (limb leads half standard calibration);
DSCAL	все отведения калибруются на двойном уровне стандартного напряжения (т. е. 20 мм/мВ) [all leads double standard calibration (i. e. 20 mm/mV)];
DSPRE	калибровка грудных отведений на двойном уровне стандартного напряжения (precordial leads double standard calibration);
DSLIM	калибровка отведений на конечностях на двойном уровне стандартного напряжения (limb leads double standard calibration);
NSCAL	нестандартная калибровка (non-standard calibration).
F.4.2.12 Технические проблемы	
ARMRE	вероятно, электроды рук перепутаны (suspect arm leads reversed);
LMISP	неправильное наложение электродов (lead misplacement);
QCERR	низкое качество данных, интерпретация может пострадать (poor data quality, interpretation may be adversely affected);

AHERR	ошибка снятия/аппаратных средств (acquisition/hardware error);
MEASE	возможна ошибка измерений (possibly measurement error);
NOISE	запись с шумами (noisy recording);
WANDR	волнистая изолиния (baseline wander);
FAULT	неисправный электрод (faulty lead);
ARTEF	артефакты (artifacts);
SIMUL	входная информация поступает от симулятора или тестового шаблона (input is from simulator or test pattern);
PINFO	несогласованные или ошибочные демографические данные пациента (inconsistent or erroneous patient demographic data);
INCAN	неполный анализ или отсутствие анализа (выполняемого программой) [incomplete or no analysis (by the program)];
NODAT	потеря или отсутствие данных (missing or no data).

F.4.3 Примеры

F.4.3.1 Описание «Вероятный старый передний инфаркт и фибрилляция предсердий» должно кодироваться следующим образом: AMI_OL_PR; AFIB. Описание AFIB не имеет прямой связи с AMI, поэтому союз AND не используется. В действительности имеется два независимых описания, одно — для контура QRS и одно — для сердечного ритма.

F.4.3.2 Описание «Вероятная гипертрофия левого желудочка с изменениями ST-T, совместимыми с напряжением левого желудочка» кодируется следующим образом: LVH_PR_AND_STT_LV. Знаки нижнего подчеркивания до и после союза AND указывают на то, что этот союз используется в одном описании.

F.4.3.3 Если такое же описание написано на двух отдельных строках и их необходимо логически связать, т. е.:

- вероятная гипертрофия левого желудочка,
 - изменения ST-T, указывающие на гипертрофию левого желудочка,
- то кодирование выполняется следующим образом: LVH_PR:AND:STT_LV.

F.5 Расшифровка результатов измерений

F.5.1 Обозначения зубцов и сегментов

P	зубец P;
P +	зубец P, положительный компонент;
P –	зубец P, отрицательный компонент;
PA	зубец реполяризации предсердий;
Q	зубец Q, т. е. первый отрицательный зубец комплекса QRS;
R	зубец R, т. е. первый положительный зубец комплекса QRS;
S	зубец S, т. е. первый отрицательный зубец после первого положительного зубца комплекса QRS;
R2	второй зубец R, т. е. первый положительный зубец комплекса QRS после зубца S;
S2	второй зубец S;
R3	третий зубец R в комплексе QRS;
S3	третий зубец S в комплексе QRS;
J	точка J;
ST	сегмент ST;
ST20	амплитуда ST 20 мс после точки J;
ST60	амплитуда ST 60 мс после точки J;
ST80	амплитуда ST 80 мс после точки J;
STO	амплитуда ST в начале ST, т. е. точка J;
STM	амплитуда ST в середине ST;
STE	амплитуда ST в конце ST, т. е. в начале зубца T;
T	зубец T;
T +	(максимальный) положительный компонент зубца T;
T –	(максимальный) отрицательный компонент зубца T;
U	зубец U;
QRS	комплекс QRS;
QR	комплекс QRS типа QR;
QS	комплекс QRS типа QS;
RS	комплекс QRS типа RS;
RSR	комплекс QRS типа RSR2;
PR	интервал PR;
PP	интервал PP;
RR	интервал RR;
QT	интервал QT;
JT	интервал между точкой J и концом зубца T;

TP	интервал между концом зубца T и следующего зубца P;
ARP	абсолютный рефракторный период;
ERP	эффективный рефракторный период;
RRP	относительный рефракторный период;
FRP	функциональный рефракторный период.

F.5.2 Обозначения отведений

a) Обозначения отведений см. в 5.6 «Определение отведения ЭКГ — раздел 3».

b) Приведенные ниже условные обозначения отведений должны использоваться наиболее часто:

D1	aVR	V1	V4	X
D2	aVL	V2	V5	Y
D3	aVF	V3	V6	Z

d) Дополнительные сокращения:

LEAD	отведение;
INN	указание локализации, например «в отведении D3», обозначается как INN_D3;
AXIS	ось.

Примечание — сокращение INN используется вместо сокращения IN, которое зарезервировано для «inferior» (нижний).

F.5.3 Единицы измерения

DUR	длительность;
MSEC	миллисекунды;
SEC	секунда(ы);
AMP	амплитуда;
MVOLT	милливольт;
MUVLT	микровольт;
DEGR	градусы;
RATIO	отношение, например, отношение амплитуд Q/R;
UNIT	единицы измерения без знака.

F.5.4 Примеры

В большинстве случаев используются достаточно простые единичные или составные интерпретирующие описания ЭКГ, например показанные в F.4.3, но могут создаваться и более сложные описания, подобные показанным ниже. Следует отметить, что эти сокращения и соглашения о создании описаний предназначены обеспечения взаимодействия разнородных систем, а каждый производитель систем может продолжать использование собственных сокращений для внутренних целей.

P_AMP_INN_LEAD_V1_EQU_120_MVOLT

Амплитуда зубца P в отведении V1 составляет 120 милливольт.

Q_DUR_INN_LEAD_D3_EQU_40_MSEC

Длительность зубца Q в отведении D3 составляет 40 миллисекунд.

RATIO_Q_AMP_DIV_R_AMP_INN_D2_IGT_0.5

Отношение Q/R в отведении D2 превышает 0,5.

(S_AMP_INN_V1_ADD_R_AMP_INN_V5)_IGT_3.5_MVOLT

Сумма амплитуды зубца S в отведении V1 и амплитуды зубца R в отведении V5 превышает 3,5 милливольт (т. е. индекс Соколова положительный).

(MAX_R_AMP_ADD_MAX_S_AMP)_INN_V_LEADS_IGT_4.5_MVOLT

Сумма максимальной амплитуды зубца R и максимальной амплитуды зубца S в прекардиальных отведениях превышает 4,5 милливольт.

Приложение G
(справочное)

Словарь

Необходимыми условиями для понимания читателем данного стандарта коммуникационного протокола компьютерной электрокардиографии являются базовые знания электрокардиографии и компьютерных технологий. Поэтому в данном словаре представлены только те термины, которые выходят за рамки базовых названий и определений, используемых в этих областях знаний.

Кодирование амплитуды

Последний из трех шагов преобразования аналогового сигнала в цифровой. Для экономии памяти последовательность целочисленных значений, создаваемая на шаге квантования, может кодироваться (например, методом Хаффмана, первая разность).

Квантование амплитуды

Второй из трех шагов преобразования сигнала из аналогового в цифровой. Амплитуда каждого считывания округляется до целого кратного фиксированному значению, которое выбирается достаточно «малым» по сравнению с представляемыми деталями исходного сигнала.

Аналого-цифровое преобразование

Процесс приближения, в котором непрерывный сигнал преобразуется в цифровое представление. Степень приближения должна гарантировать сохранность всей полезной информации исходного сигнала.

Фильтр артефактов

Фильтр, удаляющий артефакты из сигнала ЭКГ.

Фильтр изолинии

Фильтр, удаляющий низкочастотные колебания или дрейф из сигнала ЭКГ.

Данные цикла

Данные, относящиеся к морфологическим характеристикам одиночных циклов ЭКГ.

Коэффициент сжатия

Соотношение занимаемой памяти перед сжатием данных и после него.

Сжатие данных

Любой метод, удовлетворяющий общей цели сокращения размера заданного набора данных. Алгоритмы, как правило, используют особенности характеристик сжимаемого сигнала, например, алфавитно-цифровых данных, оцифрованных сигналов или оцифрованных изображений.

Прореживание

Процесс выбора меньшего количества считываний из упорядоченного набора (см. приложение С).

Опорная точка

Точка отсчета в сигнале ЭКГ.

Метод кодирования Хаффмана

Метод кодирования, в котором коды переменной длины используются таким образом, что наиболее часто возникающие данные получают самые короткие коды.

Необратимое сжатие данных

Сжатие данных необратимо, если возможность реконструкции исходного сигнала в тот вид, в котором он был до сжатия, потеряна.

Низкоуровневый транспортный протокол

Детально описанная процедура, используемая в отсутствие других методов обеспечения целостности данных и канала обмена данными во время коммуникаций между двумя цифровыми машинами.

Фильтр высоких частот

Фильтр, удаляющий компоненты входного сигнала, частота которых превышает заданную частоту.

Заграждающий фильтр

Фильтр, который должен удалять компонент входного сигнала, имеющий определенную частоту, как правило, 50 Гц или 60 Гц, т. е. частоту сети переменного тока.

Импульсы кардиостимулятора

Импульсы кардиостимулятора, наложенные на ЭКГ.

Тег

Число, используемое для идентификации определенного элемента данных.

Считывание по таймеру

Первый из трех шагов преобразования сигнала из аналогового в цифровой, т. е. дискретные считывания непрерывного сигнала с определенной частотой.

Преобразование/обратное преобразование

Сигнал может быть представлен в виде взвешенной суммы ортогональных функций. Этот набор весов или коэффициентов известен как отображение сигнала в заданную область. Взвешенная сумма этих сигналов известна как обратное преобразование. Нередко представление, обработка или сжатие сигналов упрощаются, если они осуществляются над их преобразованиями.

Другие специальные термины, используемые в настоящем стандарте, см. в разделе 3.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных документов
национальным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного документа	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO/IEC 646	NEQ	ГОСТ 27463—87 «Система обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов»
ISO/IEC 2022:1994	—	*
ISO/IEC 4873	—	*
ISO/IEC 8859-1	—	*
JIS X 0201-1976	—	*
JIS X 0208-1997	—	*
<p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - NEQ — неэквивалентный стандарт.</p>		

Библиография

Национальные и международные стандарты

- [1] ANSI-AAMI EC18-1982, American National Standard for Diagnostic Electrocardiographic Devices
- [2] ANSI-AAMI EC12-1983, American National Standard for Pregelled Disposable Electrodes
- [3] ANSI-AAMI SCL12-78, American National Standard for Safe Current Limits for Electromedical Apparatus
- [4] ANSI X3.4-1986, 7-bit American National Standard Code for Information Interchange
- [5] CCITT Blue Book, ed. 1988, Volume VIII.2, Recommendations for X.25 and Specifications for the CCITT-CRC Calculations
- [6] IEC 60601-1:2005, Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
- [7] HL7 aECG Implementation Guide, Final, March 21, 2005
- [8] IEC 60601-2-25, Medical electrical equipment — Part 2: Particular requirements for the safety of electrocardiographs
- [9] IEC 62D(CO)6, Performance Requirements for Single Channel and Multichannel Electrocardiographs
- [10] ISO/IEC 2375, Information technology — Procedure for registration of escape sequences and coded character sets
- [11] ISO/IEC 10646, Information technology — Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS)
- [12] ISO/IEC 6429, Information technology — Control functions for coded character sets
- [13] ISO/IEEE 11073-10101, Health informatics — Point-of-care medical device communication — Part 10101: Nomenclature
- [14] JIS X 0202, Code Extension Techniques for Use with the Code for Information Interchange
- [15] JIS X 0212-1990, Code of the Supplementary Japanese Graphic Character Set for Information Interchange
- [16] GB2312-80, Code of Chinese Graphic Character Set for Information Interchange — Primary Set References from the ECG standards literature
- Ссылки на литературу из библиографии стандартов по ЭКГ
- [17] BAILEY J.J., BERSON A.S., GARSON A. et al. Recommendations for standardization and specifications in automated electrocardiography: bandwidth and digital signal processing, *Circulation* 81, pp. 730—739, 1990
- [18] MACFARLANE P.W. and LAWRIE T.D.V. (Eds). *Comprehensive Electrocardiology. Theory and Practice in Health and Disease*, Volume 1—3, Pergamon Press, Oxford, 1989.
- [19] PIPBERGER H.V., ARZBAECHER B., BERSON A.S. et al. Recommendations for standardization of leads and of specifications for instruments in electrocardiography and vectorcardiography, *Circulation* 52 (August Suppl), pp. 11—31, 1975
- [20] ROBLES DE MEDINA E.O., BERNARD R., COUMEL P. et al. Definition of terms related to cardiac rhythm, A special report of the WHO/ISC Task Force ad Hoc. *Am. Heart J.*, 95, pp. 796—806, 1978
- [21] SURAWICZ B., UHLEY H., BORUN R. et al. Standardization of terminology and interpretation, Report of Task Force I on Optimal Electrocardiography, Bethesda Conference, 1977. *Am. J. Cardiol.*, 41, pp. 130—145, 1978
- [22] The CSE Working Party, Recommendations for measurement standards in quantitative electrocardiography. *Eur. Heart J.*, 6, pp. 815—825, 1985
- [23] VAN BEMMEL J.H. and WILLEMS J.L. Standardization and validation of medical support-systems: The CSE Project, *Meth. Inform. Med.* 29 (special issue), pp. 261—262, 1990
- [24] WILLEMS J.L. SCP-ECG Project Manager. Standard Communications Protocol for Computerized Electrocardiography. Final Specifications and Recommendations, Final Deliverable AIM Project # A1015. Leuven: ACCO Publ., Jan. 31, 1991 (ISBN-90-73402-01-7)
- [25] WILLEMS J.L., ABREU-LIMA C., ARNAUD P. et al. The diagnostic performance of computer programs for the interpretation of the electrocardiogram. *N. Engl. J. Med.* 325, pp. 1767—1773, 1991
- [26] WILLEMS J.L., ARNAUD P., VAN BEMMEL J.H. et al. A reference database for multilead electrocardiographic computer measurement programs, *JACC*, 6: pp. 1313—1321, 1987
- [27] WILLEMS J.L., ARNAUD P., VAN BEMMEL J.H. et al. Assessment of the performance of electrocardiographic computer programs with the use of a reference database, *Circulation* 71: pp. 523—5234, 1985
- [28] WILLEMS J.L., ARNAUD P., VAN BEMMEL J.H. et al. Establishment of a reference library for evaluating computer ECG measurement programs, *Comput. Biomed. Res.* 18, pp. 439—457, 1985
- [29] WILLEMS J.L., ROBLES DE MEDINA E.O., BERNARD R. et al. Criteria for intraventricular conduction disturbances and pre-excitation, *JACC*, 5, pp. 1261—1275, 1985
- [30] WILLEMS J.L., ZYWIETZ C., ARNAUD P. et al. Influence of noise on wave boundary recognition by ECG measurement programs. Recommendations for preprocessing, *Comput. Biomed. Res.*, 20, pp. 543—562, 1987
- [31] ZYWIETZ C., WILLEMS J.L., ARNAUD P. et al. Stability of computer ECG amplitude measurements in the presence of noise, *Comp. Biomed. Res.*, 23, pp. 10—31, 1990 Specific references with respect to ECG data compression
- Источники, посвященные сжатию данных ЭКГ
- [32] ABENSTEIN J. and TOMPKINS W. A new data reduction algorithm for real-time ECG analysis, *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 29/1, pp. 43—48, 1982
- [33] AHMED N., MILNE P.J. and HARRIS S.G. Electrocardiographic data compression via orthogonal transforms, *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 22, pp. 484—487, 1975

- [34] BEDINI R., FRANCHI D., GENERALI G.L. and SEVERI S. Performance evaluation and choice of criteria for data compression algorithms by extensive tests on the CSE database, *Computers in Cardiology*, MURRAY A. ed., IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 403—406, 1990
- [35] BERTINELLI M., CASTELLI A., COMBI C. and PINCIROLI F. Some experiments on ECG data compression in the presence of arrhythmias, *IEEE* 1988
- [36] CAPPELLINI V., DEL RE E., EVANGELISTI A. and PASTORELLI M. Application of digital filtering and data compression to ECG processing, *Digest of the 11th Internat. Conf. on Med. and Biol. Engineering*, Ottawa 1976, pp. 32—33
- [37] COX J.R., NOLLE F.M., FOZZARD H.A. and OLIVER G.G., AZTEC, a preprocessing program for realtime ECG rhythm analysis, *IEEE Transactions Biomed. Engin.*, 15, pp. 128—129, 1968
- [38] FURTH B. and PEREZ A. An adaptive real-time ECG compression algorithm with variable threshold, *IEEE Transact. on Biomed. Eng.*, 35/6, pp. 489—494, 1988
- [39] ISHIJAMAM., SHIN S., HOSTETTER G. and SKLANSKY J. Scan-along polygonal approximation for data compression of electrocardiograms, *IEEE Transact. Biomed. Engin.*, 30/11, pp. 723—729, 1983
- [40] JAYANT N.S. and NOLL P., eds. *Digital Coding of Waveforms*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1984
- [41] KARLSSON S. Representation of ECG records by Karhunen-Loève expansions, *Digest of the 7th Internat. Conf. on Med. and Biol. Engineering*, 1967, p. 105
- [42] KUKLINSKI W.S. Fast Walsh transform data-compression algorithm: ECG application, *Med. Biol. Eng. Comput.*, 21, pp. 465—472, 1983
- [43] HSU K., WOMBLE M.E., TOLAN G.D. and ZIED A.M. Simultaneous noise filtering and data compression of ECGs, *Proc. 18th Int. ISA Biomed. Sci. Instr. Symp.*, 1981, pp. 47—52
- [44] HUFFMAN D.A. A method for the construction of minimum-redundancy codes, *Proc. IRE*, 40, pp. 1098—1101, 1952
- [45] LAMBERTI C. and COCCIA P. ECG data compression for ambulatory device, in *Computers in Cardiology*, RIPLEY K.L., ed., IEEE Computer Society, Washington DC, pp. 171—178, 1988
- [46] LEEH., CHENG Q. and THAKOR N. ECG waveform analysis by significant point extraction, *Comp. Biomed. Research*, 20, pp. 410—427, 1987
- [47] MOODY G.B., SOROUSIAN K. and MARK R.G. ECG Data compression for tapeless ambulatory monitors, in *Computers in Cardiology*, RIPLEY K.L., ed. IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 467—470, 1987
- [48] MOODY G.B. and MARK R.G. QRS morphology representation and noise estimation using the Karhunen-Loève transform, in *Computers in Cardiology*, RIPLEY K.L., ed. IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 269—272, 1989
- [49] MUELLER W.C. Arrhythmia detection program for an ambulatory ECG monitor, *Biomed. Sci Instrum.*, 14, pp. 81—85, 1978
- [50] PAHLM O., BÖRJESSON P. and WERNER O. Compact digital storage of ECGs, *Comp. Programs Biomed.*, 9, pp. 293—300, 1979
- [51] PEDEN J. ECG data compression: Some practical considerations, in *Computing in Medicine*, PAUL J., JORDAN M., FERGUSON-PELL M. and ANDREWS, B. eds. pp. 62—67, 1982 (ISBN 0 333 31886 2)
- [52] REDDY B.R.S. and MURTHY I.S.N. ECG data compression using Fourier descriptors, *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 33, pp. 428—434, 1986
- [53] RUTTIMANN U.E. and PIPBERGER H.V. Data compression and the quality of the reconstructed ECG, in WOLF H.K. and MACFARLANE P.W., eds. *Optimization of Computer ECG Processing*, North Holland, Amsterdam, pp. 77—83, 1980
- [54] SHRIDAR M. and STEVENS M.F. Analysis of ECG data for data compression, *Int. J. Bio-Medical Computing*, 10, pp. 113—128, 1979
- [55] WOMBLE M.E., HALLIDAY J.S. MITTER S.K., LANCASTER M.C. and TRIEBWASSER J.H. Data compression for storing and transmitting ECGs/VCGs, *Proc. IEEE*, 65, pp. 702—706 KL, 1977
- [56] ZYWIETZ C., JOSEPH G. and DEGANI R. Data compression for computerized electrocardiography, in WILLEMS J.L., ed. *Digital ECG Data Communication, Encoding and Storage*, Proc of the 1st Working Conf of the SCP-ECG Project AIM 1015, Leuven ACCO Press, pp. 95—136, 1990
- Другие источники
- [57] *Amer. J. Cardiology* (1978, 41, pp. 130—145)
- [58] *Amer. Heart J.* (1978, 95, pp. 796—806)
- [59] *Amer. Heart J.* 95, pp. 796—806, 1978
- [60] *J. Amer. Coll. Cardiol.* 5, pp. 1261—75, 1985

Ключевые слова: здравоохранение, информатизация здоровья, электронная передача данных, персональные медицинские приборы, стандартный протокол коммуникаций, компьютерная электрокардиография

БЗ 10—2017/167

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Ю.В. Половой*

Сдано в набор 11.09.2017 Подписано в печать 22.11.2017. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 14,88. Уч.-изд. л. 13,47. Тираж 23 экз. Зак. 2334.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001, Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru