
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
ISO 24443—
2016

ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

Метод определения *in vitro* величины защитного фактора от ультрафиолетового излучения спектра А

(ISO 24443:2012, Determination of sunscreen UVA photoprotection *in vitro*, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2024

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от 27 июля 2016 г. № 89-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 января 2024 г. № 64-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 24443—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2025 г. с правом досрочного применения.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 24443:2012 «Определение *in vitro* степени фотозащиты от ультрафиолетовых лучей спектра А солнцезащитных средств» («Determination of sunscreen UVA photoprotection *in vitro*», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 217 «Косметика» Международной организации по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2001 (подраздел 3.6)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2012

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ПРОДУКЦИЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

Метод определения *in vitro* величины защитного фактора от ультрафиолетового излучения спектра А

Products cosmetic sun protection. Determination of value sunscreen UVA protection factor *in vitro*

Дата введения — 2025—01—01
с правом досрочного применения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод (*in vitro*) определения величины защитного фактора от ультрафиолетового излучения спектра А (UVA излучения) солнцезащитной продукции.

Метод настоящего стандарта позволяет получить кривую спектрального поглощения, с помощью которой можно провести ряд вычислений и оценок. Они включают определение защитного фактора от ультрафиолетовых лучей спектра А (UVAPF) [который коррелируется с UVAPF, полученным методом (*in vivo*) «стойкого потемнения пигмента» (PPD)], критической длины волны и линейной зависимости UVA поглощения. Определение данных показателей требуется в том случае, если это предусмотрено национальным законодательством по маркировке солнцезащитной продукции.

Метод настоящего стандарта основывается на использовании результатов *in vivo* определения солнцезащитного фактора (SPF) для масштабирования кривой поглощения ультрафиолетового (UV) излучения.

Настоящий стандарт не распространяется на порошкообразную продукцию, такую как компактная и рассыпчатая пудра.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

2.1 защитный фактор от ультрафиолетового излучения спектра А, определенный методом *in vitro* (*in vitro* UVA protection factor, UVAPF): Коэффициент защиты солнцезащитной продукции от UVA излучения, который может быть получен математически при *in vitro* спектральном моделировании.

2.2 численное значение SPF, определенное методом *in vitro* (*in vitro* calculation of SPF, SPF *in vitro*): Коэффициент защиты солнцезащитной продукции от солнечного излучения, вызывающего появление эритемы (покраснения кожи), вычисленный при спектральном моделировании.

2.3 спектр эритемного действия [action spectrum for erythema, $E(\lambda)$]: Относительные воздействия источника излучения в отдельных спектральных диапазонах, приводящие к появлению эритемы.

Примечание — См. библиографические ссылки [1] и [2].

2.4 спектр действия PPD (стойкое потемнение пигмента) [action spectrum for PPD, $P(\lambda)$]: Относительные воздействия источника излучения в отдельных спектральных диапазонах, приводящие к стойкому потемнению пигмента.

Примечание — См. библиографические ссылки [3] и [4].

2.5 монохроматическое поглощение [monochromatic absorbance, $A(\lambda)$]: Поглощение солнцезащитной продукцией при длине волны λ , обусловленное коэффициентом пропускания T_γ солнцезащитной продукции, вычисляемое по формуле

$$A_\lambda = -\log (T_\lambda),$$

где коэффициент пропускания T_λ — это доля интенсивности падающего излучения, пропускаемого слоем солнцезащитной продукции.

2.6 интенсивность излучения (irradiance, I): Плотность потока излучения, приходящаяся на единицу площади, для определенного диапазона длин волн, выраженная в Вт/м².

Пример — От 290 до 400 нм — интенсивность UVA+UVB излучения; от 320 до 400 нм — интенсивность UVA излучения.

2.7 спектральная плотность интенсивности падающего излучения при определении SPF или PPD [spectral irradiance for SPF testing or PPD testing], $I(\lambda)$: Плотность потока излучения на единицу длины волны $I(\lambda)$, выраженная в Вт/м²/нм.

2.8 спектрофотометр (spectrophotometer): Прибор, который измеряет свойства поглощения (или пропускания) испытуемой среды в зависимости от длины волны

2.9 спектрорадиометр (spectroradiometer): Прибор, который измеряет спектральную плотность интенсивности падающего излучения (интенсивности в ваттах на единицу площади на нанометр) электромагнитных источников.

Примечание — В настоящем стандарте спектр ограничивается ультрафиолетовым, видимым и коротким инфракрасным диапазонами.

2.10 радиометр (radiometer): Прибор, который измеряет интенсивность излучения в широком диапазоне частот (интенсивность в ваттах на единицу площади) электромагнитных источников.

Примечание — В настоящем стандарте спектр ограничивается ультрафиолетовым, видимым и коротким инфракрасным диапазонами.

3 Сущность метода

Метод основан на оценке коэффициента пропускания UV излучения тонким слоем солнцезащитной продукции, распределенной по шероховатой подложке, до и после воздействия регулируемой дозой излучения, генерируемой определенным источником UV излучения. Из-за некоторых параметров, которые нельзя контролировать с помощью обычных тонкопленочных спектроскопических методов, каждый набор данных о коэффициенте пропускания солнцезащитной продукции математически коррелируется таким образом, чтобы данные *in vitro* определения SPF были такими же, как и при измерении значения SPF методом *in vivo*. Затем образцы подвергаются воздействию определенной измеренной дозы UV излучения для определения характеристик фотостабильности исследуемой продукции. Получающиеся в результате данные спектрального поглощения показывают, что они являются полезными для представления о защитных свойствах тестируемой солнцезащитной продукции от UVA излучения. Процедура математического моделирования была получена эмпирическим путем, чтобы установить соотношение с результатами, получаемыми методом *in vivo* (стойкое потемнение пигмента) с участием человека.

4 Аппаратура

4.1 Технические требования к UV спектрофотометру

Диапазон длин волн UV спектрофотометра должен охватывать диапазон 290 нм — 400 нм. Шаг увеличения длины волны должен составлять 1 нм.

UV спектрофотометр, не оснащенный монохроматором, позади испытуемого образца должен быть оборудован фильтром, подавляющим флуоресценцию.

Входные оптические компоненты UV-спектрофотометра должны быть рассчитаны для рассеянного света и/или концентрирования рассеянного пропущенного излучения, проходящего через шероховатую подложку из полиметилметакрилата (PMMA), с нанесенным и без нанесенного слоя солнцезащитной продукции на ее поверхности. Размер диаметра входного порта UV спектрофотометра должен быть меньше размера светового пятна, измеряемого на уровне пробы (чтобы учесть рассеянный свет). Площадь каждого места считывания должна быть не менее 0,5 см² в целях уменьшения расхождений

показаний и компенсации неоднородности слоя продукции. Длина волны должна быть установлена с точностью до 1 нм, что проверяется с помощью гольмий содержащего фильтра (см. приложение А). Способность точно измерять поглощение ограничена чувствительностью прибора. В соответствии с приложением А минимальный требуемый динамический диапазон для данного метода составляет 2,2 единицы поглощения. Максимальное измеряемое поглощение должно быть в пределах динамического диапазона применяемого устройства. Если при проведении измерений получают кривую поглощения, которая выходит за верхний предел UV спектрофотометра, продукция должна пройти испытания повторно на приборе, обладающем более высокими чувствительностью и динамическим диапазоном.

Лампа UV спектрофотометра, применяемая при измерении коэффициента поглощения, должна испускать излучение с непрерывным спектром в диапазоне длин волн от 290 до 400 нм, а уровень интенсивности излучения должен быть достаточно низким, чтобы фотостабильность продукции не была сильно нарушена (для данных целей пригодной является ксеноновая лампа). Поэтому в течение одного цикла испытаний доза UV излучения не должна превышать 0,2 Дж/см².

Примечание — UV спектрофотометр используют для измерения свойств поглощения солнцезащитной продукции, нанесенной на испытательные пластины. Спектрорадиометр используют для измерения распределения спектральной энергии и интенсивности UV излучения источника или UV спектрофотометра во время измерения поглощения солнцезащитной продукции, нанесенной на испытательные пластины.

4.2 Калибровка UV спектрофотометра

UV спектрофотометр необходимо проверять через постоянные интервалы времени (рекомендуемая периодичность проверки — каждый месяц) путем измерения эталонных материалов.

Проверку проводят согласно приложению А, контролируя:

- динамический диапазон UV спектрофотометра;
- линейность UV спектрофотометра;
- точность длины волны.

4.3 Калибровка источника UV излучения

Спектральная плотность интенсивности падающего излучения на плоскости экспонирования источника UV излучения, который используется для облучения (с учетом любой фотонестабильности), должна быть по своему значению как можно ближе к интенсивности излучения на уровне земли при стандартном положении солнца в зените [5], как определено в соответствии с [6] или [7]. Интенсивность UV излучения должна находиться в следующих допустимых пределах (измеренных на расстоянии от образца).

Таблица 1 — Технические характеристики источника UV излучения

Характеристики источника УФ излучения, измеряемые спектрорадиометром	
Общая интенсивность UV излучения (290 нм — 400 нм)	40 Вт/м ² — 200 Вт/м ²
Соотношение интенсивности UVA ^a и UVB ^b излучения	8:22
^a 320 нм — 400 нм. ^b 290 нм — 320 нм.	

Источник UV излучения должен поддерживать температуру испытуемых образцов в пределах от 25 °С до 35 °С. Важно, чтобы была измерена температура самого образца, а не температура окружающей среды. Для поддержания температуры испытуемых образцов, меньшей или равной 35 °С, следует применять систему фильтров, которая значительно уменьшает ИК-излучение, для достижения указанного температурного диапазона. Для поддержания температуры испытуемых пластин с нанесенной продукцией ниже 35 °С должны применяться охлаждающие лотки или вентиляторы, а для поддержания температуры образцов, равной или превышающей 25° С, используют нагревающие устройства.

4.4 Контроль источника UV излучения

UV излучение источника, воздействующего на испытуемые образцы, должно проверяться на соответствие установленным допустимым пределам квалифицированным специалистом не реже, чем через каждые 18 мес, или после 3000 ч работы лампы. Проверка должна проводиться при помощи спектра-

диометра, откалиброванного посредством стандартного источника света, имеющего прослеживаемость к национальному или международному калибровочному эталону. В дополнение к проверке с помощью спектрорадиометра следует проверять интенсивность источника UV излучения перед каждым использованием. Данная проверка может проводиться при помощи спектрорадиометра либо радиометра, чувствительного к UVA излучению, откалиброванного для такого же спектра источника UV излучения, какой используется при проведении испытания на стадии экспонирования, применяя калибровочный коэффициент для корректировки расхождений показаний UVA радиометра и образцового спектрорадиометра.

4.5 Калибровка UVA радиометра, используемого для контроля облучения испытуемого образца

UVA радиометр (в случае его использования) должен быть соответствующим образом откалиброван при помощи спектрорадиометра, применяемого для измерения излучения источника (как при ежегодной калибровке имитатора солнечного излучения). Калибровка должна проводиться в диапазоне UVA излучения (от 320 до 400 нм) и на том же уровне, как при экспонировании испытательных пластин. После калибровки с использованием спектрорадиометра UVA радиометр может использоваться для определения доз UV излучения, которыми будут воздействовать во время ежедневных процедур облучения. В приложении В пошагово изложена процедура калибровки.

4.6 Подложка/пластина

Подложка/пластина — это материал, на который наносят солнцезащитную продукцию. В данном методе применяют PMMA пластины, одна сторона которых является шероховатой, имеющиеся в продаже. Для данного метода испытаний были утверждены конкретные пластины; технические характеристики и подготовка данных пластин [9] описаны в приложении D. Размер пластин должен быть выбран таким образом, чтобы площадь нанесения продукции была не менее 16 см².

5 Метод испытания

5.1 Описание методики проведения испытания

5.1.1 Проводят калибровку и проверку испытательного оборудования, в том числе UV спектрофотометра, используемого для измерения коэффициента пропускания/поглощения, и UVA радиометра (или спектрорадиометра), используемого для измерения UV излучения источника, а также проверяют пропускающую способность испытательных пластин, как описано в приложении D.

5.1.2 Проводят пробные измерения пластины, обработанной глицерином, для контрольной «холодной пробы», результаты которых будут использоваться при последующих измерениях поглощения.

5.1.3 До измерения интенсивности UV излучения проводят *in vitro* определение поглощения солнцезащитной продукции, нанесенной на PMMA пластину. Получают исходный спектр UV поглощения со значениями $A_0(\lambda)$.

5.1.4 Проводят аналитическое уравнивание исходного спектра UV поглощения, используя коэффициент «С» (см. вычисления в 5.7.2) для получения солнцезащитного фактора продукции (SPF), рассчитанного методом *in vitro* (не UV дозы), равного SPF, рассчитанному методом *in vivo*. Исходный UVAPF₀ рассчитывают, используя $A_0(\lambda)$ и С.

5.1.5 Однократная доза UV излучения, D, вычисляется как $1,2 \times \text{UVAPF}_0$, Дж/см².

5.1.6 Воздействуют рассчитанной дозой (D) UV излучения на тот же образец, что и в 5.1.3.

5.1.7 Измеряют *in vitro* поглощение испытуемой солнцезащитной продукции после воздействия UV излучением. Получают второй UV спектр со значениями $A(\lambda)$.

5.1.8 Проводят аналитическое уравнивание второго спектра поглощения (после воздействия UV излучением) путем умножения на коэффициент «С», предварительно определенный в 5.1.4. Полученная в результате кривая поглощения представляет собой окончательные скорректированные значения поглощения.

Примечание — Для вычислений должны использоваться значения поглощения UV излучения.

5.2 Калибровка оборудования и проверка пластин для испытаний

Процедуры, описанные в приложении А, проводят для проверки точности установки длины волны, линейности и пределов диапазона поглощения UV спектрофотометра/спектрорадиометра, применяемого для проведения испытаний. Также должна проводиться оценка показателей PMMA пластин в соответствии с приложением D.

5.3 Расчет коэффициента поглощения пластины сравнения

Сначала необходимо определить поглощение UV излучения «холостой» РРМА пластиной. Данную пластину подготавливают, распределяя несколько микролитров глицерина по ее шероховатой стороне. Количество глицерина должно быть таким, чтобы глицерин полностью покрывал поверхность пластины (приблизительно 15 мкл для пластины размером 50×50 мм). Следует избегать избыточного нанесения глицерина. Измеряют поглощение этой «холостой» пластины и используют его в качестве базового значения в дальнейших испытаниях.

Примечание — Многие спектрофотометры имеют функции «базовое значение» и автоматически учитывают данное базовое значение в расчетах при последующих измерениях поглощения.

5.4 Приготовление образцов

Солнцезащитную продукцию определенной массы наносят на шероховатую сторону ранее не использовавшейся РММА пластины (пластину располагают шероховатой стороной вверх), при расходе — 1,3 мг/см². Для обеспечения точности и воспроизводимости дозы площадь поверхности нанесения должна быть не менее 16 см². Масса дозы может быть определена по разности масс пипетки до и после нанесения продукции; или масса дозы может быть рассчитана исходя из определенного объема испытуемой продукции и ее плотности. При возможности для данной цели должны быть использованы автоматические пипетки вытеснительного типа.

Солнцезащитную продукцию наносят большим количеством мелких капель приблизительно одинакового объема, которые распределяют равномерно по всей поверхности пластины. Не рекомендуется применять резиновый напальчник для нанесения продукции на пластину. Кончик пальца, которым наносят продукцию на пластину, окунают в испытуемую продукцию, затем удаляют ее избыток, аккуратно вытирая палец, перед тем как нанести продукцию на пластину. Кончик пальца, используемый для нанесения, необходимо очищать перед нанесением продукции другого наименования.

После нанесения солнцезащитной продукции на поверхность пластины ее сразу же необходимо распределить кончиком пальца непосредственно по всей поверхности легкими мазками (не используя резиновый напальчник). Продукцию распределяют в два этапа. Сначала продукцию распределяют по всей поверхности как можно быстрее (менее чем за 30 с) небольшими круговыми движениями с минимальным давлением. Затем продукцию втирают в поверхность пластины чередующимися горизонтальными и вертикальными мазками с умеренно повышенным давлением. Второй этап должен занять от 20 до 30 с.

Подготовленный образец должен сохнуть не менее 30 мин в темноте при температуре, при которой будет проводиться UV облучение (т. е. если воздействие источника UV излучения будет осуществляться при 35 °С, то температура сушки также должна составлять 35 °С; или если воздействие источника UV излучения будет при 25 °С, то температура сушки также должна составлять 25 °С).

5.5 Измерение поглощения пластины с нанесенной продукцией

Пластину с нанесенной продукцией помещают на оптическом пути источника излучения UV спектрофотометра, поглощение UV излучения образца определяется для каждой длины волны в диапазоне от 290 до 400 нм с шагом 1 нм. Поглощение каждой пластины может определяться один или несколько раз (при необходимости), в последнем случае за результат определения принимают среднее арифметическое значение всех измерений.

5.6 Количество определений

Для получения достоверных результатов, характеризующих защитные свойства испытуемой продукции, испытанию подвергают не менее четырех пластин с нанесенной солнцезащитной продукцией. Дополнительные пластины с продукцией следует использовать, если 95 %-ный доверительный интервал (CI) превышает 17 % от среднего значения величины UVAPF, до тех пор, пока 95 %-ный CI не станет меньше 17 % от среднего значения UVAPF. Методика расчета изложена в приложении F.

5.7 Определение исходного значения SPF ($SPF_{in vitro}$), значения «С», исходного значения UVAPF ($UVAPF_0$) и дозы UV-излучения

5.7.1 Определение $SPF_{in vitro}$

Спектр имитатора солнечного UV излучения (UV-SSR), $I(\lambda)$ (см. приложение С), умножают на соответствующее значение чувствительности спектра эритемного действия, $E(\lambda)$ (см. приложение С), при данной длине волны для получения при данной длине волны эффективной энергии, которая вызывает солнечный ожог.

Полученную интенсивность излучения, вызывающую солнечный ожог, интегрируют в диапазоне длин волн от 290 до 400 нм. Коэффициент пропускания солнцезащитной продукции для каждой длины волны умножают на эффективную эритемную энергию при данной длине волны и интегрируют в том же диапазоне, чтобы получить эффективную энергию, которая при прохождении через испытуемую продукцию будет приводить к солнечному ожогу. Отношение этих двух интегралов будет являться значением SPF, рассчитанным методом *in vitro*.

SPF_{*in vitro*} вычисляют по формуле (1)

$$\text{SPF}_{in\ vitro} = \frac{\int_{\lambda=290}^{\lambda=400} E(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_{\lambda=290}^{\lambda=400} E(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot 10^{-A_0(\lambda)} \cdot d\lambda}, \quad (1)$$

где $E(\lambda)$ — спектр эритемного действия [1] (см. приложение С);

$I(\lambda)$ — спектральная плотность интенсивности падающего излучения UV источника (SSR для определения SPF) (см. приложение С);

$A_0(\lambda)$ — среднее значение поглощения монохроматического излучения слоем испытуемой продукции, определенное до воздействия на нее UV излучением;

$d\lambda$ — шаг длины волны (1 нм).

Примечание — Данное рассчитанное значение SPF не может быть использовано в качестве результата SPF_{*in vitro*}.

5.7.2 Определение значения «С»

Умножают значения исходной кривой поглощения на скалярную величину «С», если значение SPF, рассчитанное методом *in vitro*, не равно SPF, рассчитанному методом *in vivo*. Это достигается в процессе повторяющихся вычислений. Значения исходного поглощения, умноженные на величину «С», составляют скорректированную кривую поглощения солнцезащитной продукции, которая используется для определения значения исходного UVAPF₀ и дозы облучения. Формула (2) приведена для вычисления скорректированного SPF *in vitro* (SPF_{*in vitro,adj*}) и определения поправочного коэффициента «С»:

$$\text{SPF}_{in\ vitro,adj} = \text{SPF}_{in\ vitro} = \frac{\int_{\lambda=290}^{\lambda=400} E(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_{\lambda=290}^{\lambda=400} E(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot 10^{-A_0(\lambda)C} \cdot d\lambda}, \quad (2)$$

где $E(\lambda)$, $I(\lambda)$, $A_0(\lambda)$ и $d\lambda$ — см. пояснения к формуле (1).

Данные вычисления основаны на законе Ламберта-Бера $E = E_0 \cdot e^{-cd}$, применимого только к идеальным растворам. Несмотря на то, что солнцезащитная продукция, распределенная тонкой пленкой, не проявляет свойств идеального раствора, было доказано, что в данном конкретном случае можно использовать для вычислений формулу (2) [10], [11].

Для корректной интерпретации величина «С», как правило, находится в пределах от 0,8 до 1,6. Если «С» находится за пределами данного диапазона, должны быть подготовлены новые образцы для проверки исходных эмпирических данных. Величина «С» для эталонной продукции S2 также должна находиться в пределах от 0,8 до 1,6 или методика проведения испытания должна быть изменена для получения корректного значения.

5.7.3 Определение исходного UVAPF перед началом воздействия UV излучением (UVAPF₀)

Исходное значение UVAPF₀ вычисляют с целью определения дозы воздействия UV излучения. Расчеты аналогичны расчетам при определении исходного SPF_{*in vitro*}. Интенсивность спектра источника UVA излучения, $I(\lambda)$ (см. приложение С), для каждой длины волны умножают на значение чувствительности спектра при определении стойкого потемнения пигмента, $P(\lambda)$, чтобы получить энергию, вызывающую потемнение пигмента при данной длине волны. Полученная в результате интенсивность излучения, вызывающая потемнение пигмента, интегрируется в диапазоне длин волн от 320 до 400 нм. Значения исходного поглощения тестируемой продукции при каждой длине волны используют для вычисления эффективной интенсивности для каждой длины волны, чтобы получить результирующую энергию, вызывающую потемнение пигмента, пропускаемую через испытуемую продукцию, согласно формуле (3). Отношение этих двух интегралов представляет собой исходное значение UVAPF₀ *in vitro*:

$$UVAPF_0 = \frac{\int_{\lambda=320}^{\lambda=400} P(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_{\lambda=320}^{\lambda=400} P(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot 10^{-A_0(\lambda)C} \cdot d\lambda}, \quad (3)$$

где $P(\lambda)$ — спектр действия PPD (см. приложение С);

$I(\lambda)$ — спектральная плотность интенсивности падающего излучения источника UVA излучения (UVA от 320 до 400 нм для определения PPD) (см. приложение С);

$A_0(\lambda)$ — среднее поглощение монохроматического излучения слоем испытуемой продукции до воздействия на нее UV излучением;

C — поправочный коэффициент, определенный ранее по формуле (2);

$d\lambda$ — шаг длины волны (1 нм).

5.7.4 Определение дозы воздействия UV излучением

Доза воздействия UV излучением, D , это — значение $UVAPF_0$, умноженное на коэффициент 1,2, в Дж/см²:

$$D = UVAPF_0 \cdot 1,2. \quad (4)$$

Образец обрабатывают полным спектром UV излучения, но доза определяется только UVA частью спектра.

Примечание — Коэффициент 1,2 Дж/см² получен по результатам круговых межлабораторных испытаний, проведенных ISO TC 217 [8].

5.8 Воздействие UV излучением

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Персонал, работающий с данной системой облучения, должен быть соответствующим образом защищен от воздействия UV излучения (очки, перчатки и т. д.).

Подвергают воздействию UV излучения испытуемые пластины. Во время воздействия температура образцов должна поддерживаться в диапазоне от 25 °С до 35 °С и равняться температуре, при которой проводился процесс сушки. PMMA пластины должны быть установлены поверх не отражающей UV излучение подложки, которая должна находиться позади каждой пластины, чтобы снизить обратное экспонирование. Необходимо убедиться, что источник UV излучения не отключается при размещении образцов под лампой (в случае отключения, при перезапуске, обеспечивают такое же испускаемое излучение, какое было до выключения лампы).

5.9 Измерение окончательного откорректированного спектра поглощения

После UV воздействия повторно измеряют поглощение испытуемых образцов, измерение проводят в тех же местах, в каких проводились измерения перед воздействием UV излучением (см. 5.5). Окончательные значения поглощения должны равняться значениям поглощения, полученным после UV воздействия, умноженным на коэффициент «С», определенный в 5.7.2.

$$A_f(\lambda) = A_e(\lambda)C,$$

где A_e — среднее монохроматическое поглощение излучения слоем испытуемой продукции после UV воздействия;

A_f — окончательное среднее монохроматическое поглощение испытуемой продукции.

5.10 Вычисление значения UVAPF пластин после UV облучения образца

UVAPF вычисляют по формуле (5) для каждой отдельной пластины, используя результат однократного испытания пластины или среднее значение нескольких результатов испытаний данной пластины.

$$UVAPF = \frac{\int_{\lambda=320}^{\lambda=400} P(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_{\lambda=320}^{\lambda=400} P(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot 10^{-A_e(\lambda)C} \cdot d\lambda}, \quad (5)$$

где $P(\lambda)$ — спектр действия PPD (см. приложение С);

$I(\lambda)$ — спектральная плотность интенсивности падающего излучения источника UVA излучения (UVA от 320 до 400 нм для определения PPD) (см. приложение С);

$A_e(\lambda)$ — среднее поглощение монохроматического излучения слоем испытуемой продукции после воздействия на нее UV излучением;

C — поправочный коэффициент, определенный ранее по формуле (2);

$d\lambda$ — шаг длины волны (1 нм).

Другие показатели, характеризующие солнцезащитные свойства продукции, также могут быть вычислены с помощью окончательной кривой поглощения (см. 5.9).

6 Обработка результатов испытаний с помощью электронных таблиц

6.1 Вычисления, приведенные в 5.1.4—5.1.8, могут выполняться автоматически при помощи электронных таблиц, описанных в настоящем стандарте, посредством следующих операций.

6.2 Вводят наименование продукции, дату, данные, идентифицирующие оператора и SPF *in vivo* испытуемой продукции, тип спектрального анализатора, тип источника UV излучения, исходную интенсивность излучения источника UVA излучения, а также поправочный коэффициент интенсивности излучения «У» (см. приложение В) в соответствующие ячейки электронной таблицы на вкладке «Начинайте здесь».

6.3 Измеряют и вводят полученные значения поглощения до воздействия UV излучением первых четырех пластин с нанесенной продукцией в соответствующие ячейки электронной таблицы на вкладках «Пластина # 0». Нажимают на кнопку «ОК, данные введены, переход к следующему этапу» после каждого ввода.

6.4 Интенсивность UV излучения во время воздействия и время воздействия записывают на вкладке «Результаты #» для каждой отдельной пластины.

6.5 Воздействуют излучением на пластину с нанесенной солнцезащитной продукцией в течение заданного времени для получения соответствующей дозы UV излучения для каждой пластины.

6.6 Измеряют поглощение каждой из пластин. Измерения, проводимые после воздействия UV излучением, должны выполняться в том же месте (или местах), где проводились измерения поглощения до воздействия UV излучением.

6.7 Вводят результаты испытаний после воздействия UV излучением для каждой пластины в соответствующие ячейки таблицы на вкладке «Пластина # UV». Нажимают на кнопку «ОК, данные введены, переход к следующему этапу».

6.8 На вкладке таблицы «РЕЗУЛЬТАТЫ (Пластина #)» будут показаны данные результатов для каждой отдельной пластины.

6.9 Когда введение всех данных для первых четырех пластин будет завершено, появится вкладка таблицы «Отчет», в которой будут представлены обобщенные результаты для испытуемого образца. Если значение UVAPF при 95 % CI составляет менее 17 % от среднего значения UVAPF, никаких дополнительных пластин не требуется, а окончательные результаты будут представлены в графической форме и в виде таблиц. В противном случае должны быть последовательно добавлены дополнительные образцы, как описано выше. Появятся дополнительные листы для ввода данных дополнительных пластин, которые заполняются, как указано выше, пока не будет обеспечено соответствие критерию испытания.

7 Эталонная солнцезащитная продукция S2

Контроль метода проводят посредством эталонной солнцезащитной продукции. Для этой цели должна быть использована эталонная солнцезащитная продукция S2, описанная в приложении Е.

Результаты испытаний UVAPF эталонной продукции S2 должны находиться в пределах диапазона, указанного ниже (таблица 2), определенного при проведении *in vivo* испытаний; в противном случае испытание считается недействительным и его следует повторить. SPF, равный 16, должен использоваться в качестве значения SPF *in vivo* для эталонной продукции S2 при дальнейших вычислениях.

Периодичность испытаний эталонной продукции S2 устанавливается в соответствии с внутренними документами пользователя и/или ISO/IEC 17025.

Таблица 2 — Предельные значения результатов испытания UVAPF

Параметр	Нижний предел	Верхний предел
UVAPF	10,7	14,7

8 Протокол испытаний

Протокол испытания по определению спектра поглощения солнцезащитной продукции должен содержать следующую информацию:

- а) описание используемого оборудования, его изготовителя и модель прибора со сводными данными о системе калибровки, приведенными в настоящем межгосударственном стандарте в соответствии с форматом, указанным в А.6;
- б) калибровочный коэффициент «У», используемый для корректировки результатов измерения источника излучения UVA радиометра стандартным спектрометрическим прибором (4.5 и В.3.10);
- с) сведения об изготовителе пластин и номере (коде) партии;
- д) среднее значение поглощения UV излучения для каждой длины волны в заданном диапазоне длин волн (шаг длины волны 1 нм) испытуемого образца (может быть предусмотрена графа для значения поглощения до и после воздействия UV излучением);
- е) указание измеренного методом *in vivo* солнцезащитного фактора (SPF), используемого для вычислений;
- ф) коэффициент «С»;
- г) интенсивность UVA излучения (Вт/м²) и среднюю дозу UVA излучения, используемую для облучения испытуемого образца;
- х) исходные данные об эталонной солнцезащитной продукции S2 с указанием даты проведения ее испытания;
- и) идентификационные данные испытуемой продукции;
- ж) информацию о лице, проводившем испытание;
- к) могут быть представлены результаты дополнительных вычислений, полученных на основании значений поглощения [см. 8d)].

**Приложение А
(обязательное)**

Калибровка UV спектрометра и испытание на пропускание пластины

А.1 Общие положения

В данном приложении установлены требования к точности длины волны, линейности и динамическому диапазону UV-спектрофотометра. Для большей ясности и в целях стандартизации формата протокола электронные таблицы рассматриваются как часть настоящего стандарта.

А.2 Точность длины волны

А.2.1 Гольмиево-оксидный фильтр

Толщина фильтра не должна превышать 3 мм, содержание оксида гольмия должно быть в количестве, достаточном для обеспечения абсолютной калибровки длины волны с использованием пика поглощения при длине волны, равной 361 нм.

А.2.2 Метод

А.2.2.1 Помещают гольмиево-оксидный фильтр на пути образца и измеряют поглощение излучения в диапазоне от 290 до 430 нм. Проводят измерения относительно воздуха на оптическом пути «холостого» образца. Измерение повторяют трижды. Накапливают данные и значения поглощения в закладке «Точность длины волны с использованием гольмиевого фильтра» в приведенной ниже электронной таблице «UVSpectcalib.xls» в колонках В—D. Нажимают на кнопку с назначенным макросом в ячейке «P28», чтобы активировать функцию проверки пика. Результаты автоматически отобразятся в сводном листе калибровки системы, приведенном в настоящем стандарте (см. рисунок А.2), и будут аналогичны результатам, показанным на рисунке А.1.

А.2.2.2 Отклонения длины волны от стандартного значения в UV диапазоне прибора не должны превышать 1 нм. Пример спектра калибровки показан на графике ниже. Отчетная длина волны пика должна быть 360, 361 или 362, либо прибор должен быть откалиброван для получения одного из данных значений длин волн.

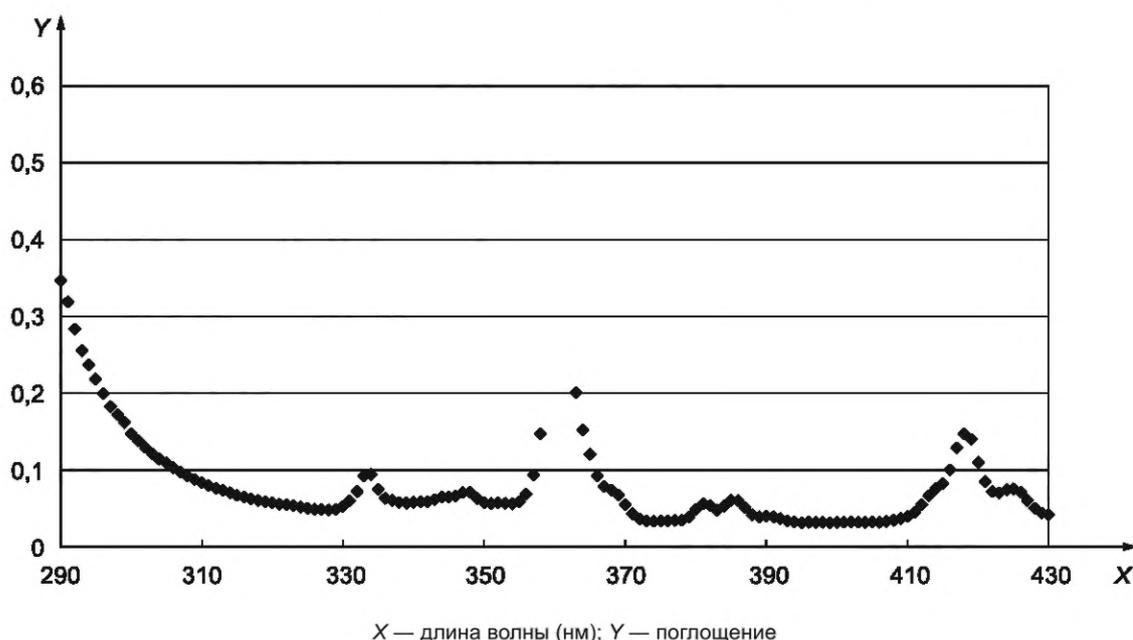


Рисунок А.1 — При установке гольмиево-оксидного фильтра

А.3 Линейность

А.3.1 Стандартные пластины

Пластины вырезают из большого листа UV стабилизированного полиметилметакрилата (PMMA) (обеспечивающего одинаковые оптические свойства для каждой пластины), полученного стандартным методом литья. Пластины изготавливают таким образом, чтобы соответствовать спектрам поглощения наиболее распространенной солнцезащитной продукции. Процесс литья позволяет обеспечивать достаточно однородное распределение UV поглощающего материала по отношению к пленке испытываемой эмульсии, наносимой вручную.

Благодаря стабильному и стандартизованному поглощению, а также свойствам диффузного рассеяния данные пластины очень удобны в качестве «стандартных эмульсий», используемых для проверки и сравнения приборов, используемых для определения методом *in vitro* степени UV защиты, для внутри- и межлабораторных целей.

А.3.2 Оценка линейности

Выбирают две прозрачные UV стабилизированные PMMA стандартные пластины. Пик поглощения этих стандартных пластин при длине волны 340 нм должен быть в пределах 1,1 и 1,5 единиц поглощения (AU).

Обозначают первую пластину как Слайд А и помещают ее на оптическом пути в UV спектрофотометра. Проводят измерения относительно воздуха на незаполненном оптическом пути. Проводят измерения в двух повторностях (от 290 до 380 нм) и вводят данные в таблицу на вкладке «Испытание на линейность», ячейки В8:С98.

Обозначают вторую пластину как Слайд В и помещают ее на оптическом пути UV спектрофотометра. Проводят измерение относительно воздуха на незаполненном оптическом пути. Проводят измерение в двух повторностях и вводят данные в таблицу на вкладке «Испытание на линейность», ячейки D8:E98. Совмещают оба слайда (А и В) верхними шероховатыми сторонами друг к другу и измеряют общее поглощение (при длине волн от 290 до 380 нм). Измерение проводят относительно воздуха на незаполненном оптическом пути. Проводят измерение в четырех повторностях и вводят данные в таблицу на вкладке «Испытание на линейность», ячейки F8:I98. Результаты автоматически появятся в сводном листе калибровки системы, приведенном в настоящем стандарте (см. рисунок А.2).

А.4 Определение предельного динамического диапазона поглощения

Электронная таблица также позволяет вычислить максимальный предельный диапазон поглощения UV спектрофотометра, основанный на отклонении результатов измерений двух пластин. Если отклонение превышает 0,1 AU, определяется предельный динамический диапазон, и результаты автоматически появляются в сводном листе калибровки системы, приведенном в настоящем стандарте (см. рисунок А.2). Минимальный диапазон составляет 2,2 AU.

А.5 Характеристика испытательных PMMA пластин

А.5.1 Основные положения

Пластины из PMMA, используемые в качестве подложки при испытаниях солнцезащитной продукции, должны отвечать минимальным требованиям пропускания.


А.5.2 Метод

Устанавливают базовую линию UV спектрофотометра с пустыми ячейками (без образца). Наносят кончиком пальца приблизительно 15 мг глицерина или модифицированного раствора глицерина на шероховатую поверхность PMMA пластины. Удаляют излишки глицерина на пластине кончиком пальца. Устанавливают подготовленную пластину в позицию для измерений и измеряют поглощение (или % пропускания) пластины. Записывают и вводят данные в таблицу на вкладке «Пропускание пластины» в соответствующем столбце В для значений поглощения или столбце С для значений % пропускания. Пластина должна иметь пропускание > 60 % при 290 нм, > 69 % при 300 нм и > 81 % при 320 нм. Результаты автоматически отображаются в сводном листе калибровки системы, приведенном в настоящем стандарте, как показано на рисунке А.2.

А.6 Запись результатов

Результаты калибровки должны записываться в формате, указанном в электронной таблице «Сводные результаты».

Прибор:	0			Проверен (кем):	0
Дата	Март 31,2011			Подпись:	0
Испытание на пропускание пластины		Изготовитель пластины:	0	Партия №	0
нм	Предельные значения		Выдержали испытание		
290	> 60 %	65,5 %			
300	> 69 %	70,9 %			
320	> 81 %	82,1 %			
Точность длины волны спектрофотометра					
		Пик 1			
Стандартная длина волны		361			
Измеренная длина волны		361			
Значение пика		0,433			
Предел: ±1		ФАКТИЧЕСКИЙ			

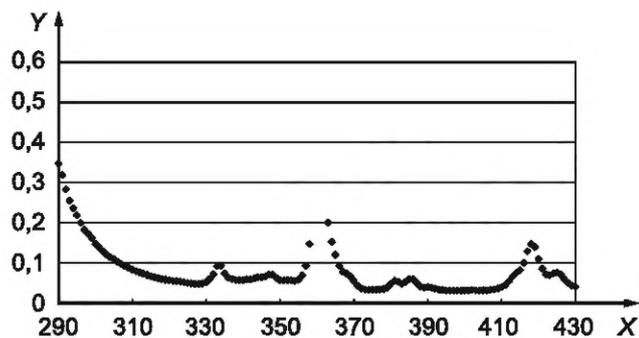

X — длина волны (нм); Y — поглощение

Рисунок А.2 — Сводный лист калибровки системы (1 из 2)

Наблюдения при использовании гольмиево-оксидного фильтра

Испытание линейности спектрофотометра			
			Предел
Предельный динамический диапазон	2,41	Выдержал испытание	2,2
Предел линейности	92,50	Выдержал испытание	85
<p>а) Корреляция калибровочных PMMA пластин по схеме «одна против двух»</p>		<p>б) Определение динамического диапазона</p>	
<p>X — среднее поглощение одной пластины; Y — поглощение двух пластин (расположенных друг около друга)</p>		<p>X — длина волны (нм); Y — поглощение Примечание — calc. = рассчитанный, obs. = наблюдаемый</p>	

Рисунок А.2 — Сводный лист калибровки системы (2 из 2)

Приложение В
(обязательное)

Процедура калибровки радиометра

В.1 Цель процедуры калибровки

Целью процедуры является калибровка радиометра, используемого для измерения источника UV излучения, с целью воздействия точными дозами излучения при проверке фотостабильности солнцезащитной продукции методом *in vitro*.

В.2 Краткое описание процедуры

Измерение интенсивности излучения спектрометрического датчика UVA радиометра сначала проводится в UV диапазоне источника излучения (290 нм — 400 нм). Перекрестно калиброванный датчик UVA радиометра помещают в ту же позицию экспонирования, что и спектрометрический датчик, и проводят измерение интенсивности излучения на плоскости экспонирования. Используя данные об интенсивности излучения спектрометрического датчика, энергию на каждой длине волны с интервалом 1 нм интегрируют в диапазоне от 320 до 400 нм, чтобы получить интенсивность UVA излучения спектрометрического датчика. Интенсивность UVA излучения спектрометрического датчика делят на значение интенсивности излучения, измеренное с помощью UVA радиометра, для получения коэффициента калибровки Y , который применяется для умножения всех последующих результатов измерений источника UVA излучения, используемого в данной процедуре, UVA радиометром.

В.3 Поэтапная процедура

В.3.1 Необходимо использовать спектрометрический датчик с действующей калибровкой, имеющий прослеживаемость со стандартным источником излучения в диапазоне 290 нм — 400 нм.

В.3.2 Устанавливают базовую оптику спектрометрического датчика в соответствующее положение в плоскости экспонирования испытуемых PMMA пластин.

В.3.3 Включают источник UV излучения и дают ему прогреться в течение не менее 20 мин.

В.3.4 Сканируют спектральную плотность интенсивности излучения источника с помощью спектрометрического датчика в диапазоне 290 нм — 400 нм с последовательным увеличением длины волны на 1 нм.

В.3.5 Интегрируют спектральную плотность интенсивности излучения в диапазоне от 320 нм до 400 нм для того, чтобы определить общую интенсивность UVA излучения источника излучения спектрометрического датчика в плоскости экспонирования образцов PMMA пластин. Его обозначают I_{UVA_spec} .

В.3.6 Отводят датчик спектрометрического датчика от источника излучения.

В.3.7 Помещают UVA радиометр, подлежащий калибровке, в то же положение, что и спектрометрический датчик, так, чтобы калибруемая контрольная матрица радиометра находилась в том же положении, что и базовая оптика спектрометрического датчика, облучаемая источником UV излучения.

В.3.8 Измеряют интенсивность излучения источника UVA радиометром. Его обозначают I_{UVA_rad} .

В.3.9 Вычисляют коэффициент калибровки следующим образом:

$$Y = I_{UVA_spec} / I_{UVA_rad}$$

В.3.10 Последующие результаты измерения источника UV излучения с помощью UVA радиометра умножают на коэффициент Y для получения скорректированной интенсивности UVA излучения.

Скорректированная интенсивность UVA излучения = $I_{UVA_rad} \cdot Y$.

В.3.11 Поправочный коэффициент калибровки Y можно ввести непосредственно в электронную таблицу испытания методом *in vitro* настоящего стандарта. Исходное значение радиометра (без учета поправочного коэффициента) также вводят в эту таблицу для вычисления скорректированной интенсивности UV излучения.

Приложение С
(обязательное)

Значения, используемые для вычислений: спектры действия PPD, спектры эритемного действия, спектральная интенсивность излучения UVA и UV-SSR

Таблица С.1 — Спектры действия PPD, спектры эритемного действия, спектральная интенсивность излучения UVA и UV-SSR

Длина волны, нм	Спектр действия PPD	Спектр эритемного действия	Источник UV-SSR, Вт/м ² /нм	Источник UVA излучения, Вт/м ² /нм
290	—	1,0000E+00	8,741E-06	—
291	—	1,0000E+00	1,450E-05	—
292	—	1,0000E+00	2,659E-05	—
293	—	1,0000E+00	4,574E-05	—
294	—	1,0000E+00	1,006E-04	—
295	—	1,0000E+00	2,589E-04	—
296	—	1,0000E+00	7,035E-04	—
297	—	1,0000E+00	1,678E-03	—
298	—	1,0000E+00	3,727E-03	—
299	—	8,0538E-01	7,938E-03	—
300	—	6,4863E-01	1,478E-02	—
301	—	5,2240E-01	2,514E-02	—
302	—	4,2073E-01	4,176E-02	—
303	—	3,3884E-01	6,223E-02	—
304	—	2,7290E-01	8,690E-02	—
305	—	2,1979E-01	1,216E-01	—
306	—	1,7701E-01	1,615E-01	—
307	—	1,4256E-01	1,989E-01	—
308	—	1,1482E-01	2,483E-01	—
309	—	9,2470E-02	2,894E-01	—
310	—	7,4473E-02	3,358E-01	—
311	—	5,9979E-02	3,872E-01	—
312	—	4,8306E-02	4,311E-01	—
313	—	3,8905E-02	4,884E-01	—
314	—	3,1333E-02	5,121E-01	—
315	—	2,5235E-02	5,567E-01	—
316	—	2,0324E-02	5,957E-01	—
317	—	1,6368E-02	6,256E-01	—
318	—	1,3183E-02	6,565E-01	—
319	—	1,0617E-02	6,879E-01	—

Продолжение таблицы С.1

Длина волны, нм	Спектр действия PPD	Спектр эритемного действия	Источник UV-SSR, Вт/м ² /нм	Источник UVA излучения, Вт/м ² /нм
320	1,000E+00	8,5507E-03	7,236E-01	4,843E-06
321	9,750E-01	6,8865E-03	7,371E-01	8,466E-06
322	9,500E-01	5,5463E-03	7,677E-01	1,356E-05
323	9,250E-01	4,4668E-03	7,955E-01	2,074E-05
324	9,000E-01	3,5975E-03	7,987E-01	3,032E-05
325	8,750E-01	2,8973E-03	8,290E-01	4,294E-05
326	8,500E-01	2,3335E-03	8,435E-01	5,738E-05
327	8,250E-01	1,8793E-03	8,559E-01	7,601E-05
328	8,000E-01	1,5136E-03	8,791E-01	9,845E-05
329	7,750E-01	1,4125E-03	8,951E-01	1,215E-04
330	7,500E-01	1,3646E-03	9,010E-01	1,506E-04
331	7,250E-01	1,3183E-03	9,161E-01	1,811E-04
332	7,000E-01	1,2735E-03	9,434E-01	2,132E-04
333	6,750E-01	1,2303E-03	9,444E-01	2,444E-04
334	6,500E-01	1,1885E-03	9,432E-01	2,833E-04
335	6,250E-01	1,1482E-03	9,571E-01	3,186E-04
336	6,000E-01	1,1092E-03	9,663E-01	3,589E-04
337	5,750E-01	1,0715E-03	9,771E-01	3,980E-04
338	5,500E-01	1,0351E-03	9,770E-01	4,387E-04
339	5,250E-01	1,0000E-03	9,967E-01	4,778E-04
340	5,000E-01	9,6605E-04	9,939E-01	5,198E-04
341	4,938E-01	9,3325E-04	1,007E+00	5,608E-04
342	4,876E-01	9,0157E-04	1,012E+00	5,998E-04
343	4,814E-01	8,7096E-04	1,011E+00	6,384E-04
344	4,752E-01	8,4140E-04	1,021E+00	6,739E-04
345	4,690E-01	8,1283E-04	1,025E+00	7,123E-04
346	4,628E-01	7,8524E-04	1,033E+00	7,468E-04
347	4,566E-01	7,5858E-04	1,034E+00	7,784E-04
348	4,504E-01	7,3282E-04	1,040E+00	8,180E-04
349	4,442E-01	7,0795E-04	1,027E+00	8,427E-04
350	4,380E-01	6,8391E-04	1,045E+00	8,754E-04
351	4,318E-01	6,6069E-04	1,042E+00	9,044E-04
352	4,256E-01	6,3826E-04	1,040E+00	9,288E-04
353	4,194E-01	6,1660E-04	1,039E+00	9,486E-04
354	4,132E-01	5,9566E-04	1,043E+00	9,733E-04

Продолжение таблицы С.1

Длина волны, нм	Спектр действия PPD	Спектр эритемного действия	Источник UV-SSR, Вт/м ² /нм	Источник UVA излучения, Вт/м ² /нм
355	4,070E-01	5,7544E-04	1,046E+00	9,863E-04
356	4,008E-01	5,5590E-04	1,035E+00	1,009E-03
357	3,946E-01	5,3703E-04	1,039E+00	1,028E-03
358	3,884E-01	5,1880E-04	1,027E+00	1,045E-03
359	3,822E-01	5,0119E-04	1,035E+00	1,062E-03
360	3,760E-01	4,8417E-04	1,037E+00	1,078E-03
361	3,698E-01	4,6774E-04	1,025E+00	1,086E-03
362	3,636E-01	4,5186E-04	1,023E+00	1,098E-03
363	3,574E-01	4,3652E-04	1,016E+00	1,095E-03
364	3,512E-01	4,2170E-04	9,984E-01	1,100E-03
365	3,450E-01	4,0738E-04	9,960E-01	1,100E-03
366	3,388E-01	3,9355E-04	9,674E-01	1,093E-03
367	3,326E-01	3,8019E-04	9,648E-01	1,087E-03
368	3,264E-01	3,6728E-04	9,389E-01	1,082E-03
369	3,202E-01	3,5481E-04	9,191E-01	1,071E-03
370	3,140E-01	3,4277E-04	8,977E-01	1,048E-03
371	3,078E-01	3,3113E-04	8,725E-01	1,026E-03
372	3,016E-01	3,1989E-04	8,473E-01	9,953E-04
373	2,954E-01	3,0903E-04	8,123E-01	9,703E-04
374	2,892E-01	2,9854E-04	7,840E-01	9,367E-04
375	2,830E-01	2,8840E-04	7,416E-01	9,057E-04
376	2,768E-01	2,7861E-04	7,148E-01	8,757E-04
377	2,706E-01	2,6915E-04	6,687E-01	8,428E-04
378	2,644E-01	2,6002E-04	6,280E-01	8,058E-04
379	2,582E-01	2,5119E-04	5,863E-01	7,613E-04
380	2,520E-01	2,4266E-04	5,341E-01	7,105E-04
381	2,458E-01	2,3442E-04	4,925E-01	6,655E-04
382	2,396E-01	2,2646E-04	4,482E-01	6,115E-04
383	2,334E-01	2,1878E-04	3,932E-01	5,561E-04
384	2,272E-01	2,1135E-04	3,428E-01	4,990E-04
385	2,210E-01	2,0417E-04	2,985E-01	4,434E-04
386	2,148E-01	1,9724E-04	2,567E-01	3,876E-04
387	2,086E-01	1,9055E-04	2,148E-01	3,363E-04
388	2,024E-01	1,8408E-04	1,800E-01	2,868E-04
389	1,962E-01	1,7783E-04	1,486E-01	2,408E-04

Окончание таблицы С.1

Длина волны, нм	Спектр действия PPD	Спектр эритемного действия	Источник UV-SSR, Вт/м ² /нм	Источник UVA излучения, Вт/м ² /нм
390	1,900E-01	1,7179E-04	1,193E-01	2,012E-04
391	1,838E-01	1,6596E-04	9,403E-02	1,640E-04
392	1,776E-01	1,6032E-04	7,273E-02	1,311E-04
393	1,714E-01	1,5488E-04	5,532E-02	1,028E-04
394	1,652E-01	1,4962E-04	4,010E-02	7,897E-05
395	1,590E-01	1,4454E-04	2,885E-02	5,975E-05
396	1,528E-01	1,3964E-04	2,068E-02	4,455E-05
397	1,466E-01	1,3490E-04	1,400E-02	3,259E-05
398	1,404E-01	1,3032E-04	9,510E-03	2,302E-05
399	1,342E-01	1,2589E-04	6,194E-03	1,581E-05
400	1,280E-01	1,2162E-04	4,172E-03	1,045E-05

Стандартная суммарная интенсивность солнечного UV излучения составляет от 51,4 до 63,7 Вт/м² [6], [7], соотношение интенсивности излучения UVA к интенсивности излучения UVB — от 16,9 до 17,5.

Приложение D
(обязательное)

Показатели поверхности испытательных PMMA пластин

D.1 Тип испытательной пластины

PMMA пластины с шероховатой поверхностью, полученной в процессе литья, со следующими показателями (диапазоном верхних и нижних предельных значений) были выбраны для данного *in vitro* метода испытания в результате круговых межлабораторных испытаний.

D.2 Профиль поверхности подложки

Измеряют характеристики профиля поверхности подложки [9] площадью не менее 10 мм × 5 мм с интервалами в 15 мкм. Бесконтактный топографический анализ поверхности может быть проведен с помощью лабораторного устройства, состоящего из оптического датчика, контроллера движения, стола поступательного перемещения x—y и снабженного микро топографическим программным обеспечением. Рекомендуется использовать датчик, в основу которого положен принцип хроматической аберрации дневного света, который обеспечивает высокое разрешение: 10 нм по вертикали и 1 мкм по горизонтали.

Параметры профиля поверхности должны быть рассчитаны по среднему значению различных проанализированных характеристик (R_a , R_v , R_{dq} , A_1 , SS_c , V_w).

D.3 Параметры профиля пластины

PMMA пластины можно подготовить в процессе литья, чтобы они имели параметры поверхности, удовлетворяющие требованиям при измерении соответствующими приборами [9]:

Т а б л и ц а D.1 — Заданные значения, верхние и нижние предельные значения

Показатель	R_a	R_v	R_{dq}	A_1	SS_c	V_w
Заданное значение	4,853	13,042	11,122	239,750	0,033	1,044E-06
Верхнее предельное значение	5,170	13,669	12,411	284,256	0,046	1,663E-06
Нижнее предельное значение	4,535	12,414	9,833	195,244	0,020	4,248E-07

D.4 Оптические характеристики пластины

D.4.1 Требования к коэффициенту пропускания (см. A.5)

Коэффициент пропускания представительных образцов от каждой партии PMMA пластин определяют, чтобы обеспечить их соответствие техническим требованиям. Профилированную поверхность испытуемой пластины необходимо обработать чистым глицерином или раствором модифицированного глицерина, приведенными в таблице D.2.

Т а б л и ц а D.2 — Раствор модифицированного глицерина

Ингредиент	%
Глицерин BP/USP/JP	90,0
Раствор лаурилсульфата натрия (водный раствор с массовой долей 1 %)	10,0

D.4.2 Метод

D.4.2.1 Подготавливают стандартную PMMA пластину, нанося приблизительно 15 мг чистого глицерина или раствора модифицированного глицерина в виде тонкой непрерывной пленки на шероховатую сторону пластины. Слайд должен быть прозрачным после обработки. Удаляют излишек глицерина кончиком пальца.

D.4.2.2 Помещают пластину на оптическом пути UV спектрофотометра. Измеряют коэффициент пропускания (от 290 до 400 нм) относительно воздуха, используемого в качестве стандартного оптического пути.

D.4.3 Минимальные значения пропускания

Предельные значения пропускания обработанной пластиной:

290 нм: > 60% T.

300 нм: > 69% T.

320 нм: > 81% T.

**Приложение Е
(обязательное)**

Эталонная UVA солнцезащитная продукция S2

Е.1 Среднее значение UVAPF и его допустимые предельные значения для эталонной солнцезащитной продукции S2

Среднее и допустимые предельные значения защитного фактора эталонной солнцезащитной продукции S2, используемой для контроля данного метода испытаний, приведены в таблице Е.1.

Т а б л и ц а Е.1 — Средний UVAPF и его допустимые предельные значения для эталонной солнцезащитной продукции S2

Эталонная солнцезащитная продукция	Среднее значение	Среднее значение	Допустимые предельные значения	
			Нижнее предельное значение	Верхнее предельное значение
Состав	SPF	UVAPF		
S2	16,0	12,7	10,7	14,7

Е.2 Рецептúra и приготовление эталонной продукции S2

Рецептура и процедура приготовления, приведенные ниже, характеризуют количественный состав и процесс смешения ингредиентов эталонной солнцезащитной продукции S2, используемой для контроля метода испытания.

Т а б л и ц а Е.2 — Состав эталонной продукции S2

Ингредиенты	Масс. % от общей массы
Фаза 1 (водная)	
Вода	62,43
Пропиленгликоль	1,00
Ксантановая камедь	0,60
Карбомер, например Carbopol Ultrez 10 ^a	0,15
Двунариевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты	0,08
Фаза 2 (масляная)	
Октокрилен	3,00
Бутил метоксидибензоилметан	5,00
Этилгексил метоксициннамат	3,00
Бис-этилгексилоксифенол	2,00
Метоксифенил триазин	
Цетиловый спирт	1,00
Стеарет-21	2,50
Стеарет-2	3,00
Дикаприлил карбонат	6,50
Децил кокоат	6,50
Феноксизтанол (и)	1,00
Метилпарабен (и)	
Этилпарабен (и)	

Окончание таблицы Е.2

Ингредиенты	Масс. % от общей массы
Бутилпарабен (и)	
Пропилпарабен (и)	
Фаза 3	
Циклопентасилоксан	2,00
Триэтаноламин	0,23
^a Carbopol Ultrez 10 — пример подходящего продукта, имеющегося в продаже. Данная информация приводится для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает, что ISO рекомендует именно этот продукт.	

Е.3 Приготовление продукции

Процесс приготовления должен включать следующие пять этапов:

- Е.3.1 Нагревают до 75 °С отдельно друг от друга смешанные ингредиенты фазы 1 и фазы 2.
- Е.3.2 Добавляют медленно масляную фазу 2 в водную фазу 1, перемешивая фазу 1.
- Е.3.3 Охлаждают смесь до 40 °С, не прекращая перемешивание.
- Е.3.4 Добавляют ингредиенты фазы 3 в смесь фаз 1 и 2, не прекращая перемешивание.
- Е.3.5 Возмещают потерю воды и доводят смесь до однородного состояния.

Е.4 Органолептические и физико-химические показатели

Солнцезащитная продукция S2 должна иметь следующие показатели:

- Е.4.1 Цвет: от белого до бледно-желтого.
- Е.4.2. рН: 6,5 ± 0,5.
- Е.4.3 Плотность: 0,96 г/см³ — 1 г/см³.
- Е.4.4 Вязкость: 7000 — 12000 (вязкость измеряют, используя вискозиметр Брукфильда типа DV-II со шпинделем В¹⁾), при 20 об/мин в течение 60 с.

Е.5 Хранение и срок годности

Срок годности эталонной продукции S2 — 12 мес с даты изготовления, ее следует хранить при 20 °С в стеклянном сосуде или плотно закупоренном пакете в защищенном от света месте.

Е.6 Аналитические данные**Е.6.1 Основные положения**

Методика проверки эталонной солнцезащитной продукции S2 описана ниже.

Е.6.2 Сущность метода

Отбирают пробу продукции гравиметрическим методом и растворяют в этаноле (в котором растворимы анализируемые ингредиенты). Фильтруют и анализируют раствор при помощи хроматографа, используя микропористую силикагелевую колонку, смесь воды и этанола в качестве подвижной фазы. Концентрации анализируемых ингредиентов в пробе определяют относительно смеси растворов внешних стандартов анализируемых ингредиентов.

Е.6.3 Реактивы

Для определений используют следующие химические продукты и реактивы.

- Е.6.3.1 Абсолютированный этанол (для ВЭЖХ).
- Е.6.3.2 Вода высокой степени чистоты (для ВЭЖХ).
- Е.6.3.3 Фосфорная кислота, 85 %, аналитической степени чистоты.
- Е.6.3.4 Этилгексил метоксициннамат.
- Е.6.3.5 Бутил метоксидибензоилметан.
- Е.6.3.6 Октокрилен.
- Е.6.3.7 Бис-этилгексилоксифенол-метоксифенил триазин.

Е.7 Аппаратура (жидкостный хроматограф высокого давления)

Аппаратура, необходимая для проведения аналитических измерений активно действующих ингредиентов эталонной солнцезащитной продукции S2, включает следующее:

- Е.7.1 Инжектор, обеспечивающий впрыскивание пробы объемом 10,0 мкл.

¹⁾ Вискозиметр Брукфильда типа DV-II со шпинделем В является примером продукта, имеющегося в продаже. Эта информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой указанного продукта со стороны ISO.

Е.7.2 **Колонка**, например, серии Waters Symmetry Shield C18¹⁾, 5 мкм, длиной 150 мм, внутренним диаметром 4,6 мм и скоростью потока 1,2 мл/мин²⁾.

Е.7.3 **Элюент А**, вода, подкисленная H₃PO₄.

Е.7.4 **Элюент В**, абсолютированный этанол (для ВЭЖХ).

Е.7.5 **УФ детектор**, длина волны 312 нм.

Е.7.6 **Данные**, т. е. количественно определенные площади пиков.

Е.8 Методика

Для определения активно действующих ингредиентов эталонной солнцезащитной продукции S2 выполняют следующие операции.

Е.8.1 Используя аналитические весы, взвешивают с точностью до 0,1 мг в мерной колбе вместимостью 25 мл приблизительно 50 мг эталонной продукции.

Е.8.2 Доводят объем этанолом до метки.

Е.8.3 Перемешивают при помощи вихревой мешалки и в случае, если продукция не растворяется, гомогенизируют в ультразвуковой бане до получения однородной консистенции.

Е.8.4 Фильтруют через дисковый фильтр из поливинилиденфторида с размером отверстий 0,45 мкм.

Е.8.5 Анализируют раствор пробы и смешанный рабочий раствор стандартов методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Е.9 Контроль качества

Для проверки качества аналитического метода выполняют следующее.

Е.9.1 Анализируют пробу подвижной фазы для ВЭЖХ и плацебо (при наличии), приготовленного в соответствии с Е.8, методом обращенно-фазовой ВЭЖХ, чтобы подтвердить отсутствие мешающих хроматографических пиков.

Е.9.2 Вводят рабочий раствор стандартов три раза в хроматограф и вычисляют коэффициент вариации площадей пиков анализируемых ингредиентов.

Е.10 Вычисления

Процентное содержание анализируемого ингредиента вычисляют по следующей формуле:

$$\frac{M \cdot h \cdot 2,5}{P \cdot H}$$

где M — масса анализируемого ингредиента, мг;

P — масса пробы, мг;

h — площадь пика анализируемого ингредиента на хроматограмме пробы;

H — площадь пика анализируемого ингредиента на хроматограмме раствора стандартов.

Е.11 Критерии приемки

Результаты аналитических определений являются приемлемыми при следующих условиях:

- стандартный коэффициент вариации $\leq 2,5$ %;
- выход составляет 95 % — 105 % от количества, указанного в рецептуре;
- на хроматограмме пробы плацебо или подвижной фазы отсутствуют мешающие пики.

¹⁾ Waters Symmetry Shield C18 является примером продукта, имеющегося в продаже. Эта информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой указанного продукта со стороны ISO.

²⁾ Градиент колонки должен быть следующим: 37 % А и 63 % В в течение 0—12 мин, 100 % В в течение 12—22 мин, 100 % В в течение 22—25 мин, 37 % А и 63 % В в течение 25—26 мин и 37 % и 63 % В в течение 26—30 мин.

Приложение F
(справочное)

Статистические данные и вычисления

F.1 Определение защитного фактора от ультрафиолетового излучения спектра A отдельной пластины (UVAPF_i)

UVAPF_i каждой пластины вычисляют при помощи электронной таблицы:

$$UVAPF_i = \frac{\int_{\lambda=320}^{\lambda=400} P(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_{\lambda=320}^{\lambda=400} P(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot 10^{-A_0(\lambda)C} \cdot d\lambda}. \quad (F.1)$$

F.2 Определение защитного фактора от ультрафиолетового излучения спектра A солнцезащитной продукции

UVAPF солнцезащитной продукции представляет собой среднее арифметическое значений UVAPF_i общего количества (*n*) пластин, выраженное с точностью до первого десятичного знака:

$$UVAPF = \frac{\sum UVAPF_i}{n}. \quad (F.2)$$

Стандартное отклонение определяют по формуле (F.3):

$$s = \sqrt{\frac{\sum (UVAPF_i)^2 - \left[\sum (UVAPF_i) \right]^2 / n}{(n-1)}}. \quad (F.3)$$

F.3 Доверительный интервал 95 %

Доверительный интервал 95 % (95 % CI) для среднего значения UVAPF определяют по формуле (F.4):

$$95 \% \text{ CI} = \text{от } (UVAPF - c) \text{ до } (UVAPF + c), \quad (F.4)$$

c вычисляют как: $c = (\text{значение } t) \cdot SEM = (\text{значение } t) \cdot s / \sqrt{n}$

$$c = t \cdot s / \sqrt{n}; \quad (F.5)$$

$$CI [\%] = 100 \cdot c / UVAPF, \quad (F.6)$$

где SEM — стандартная ошибка среднего значения;

n — общее количество волонтеров, подвергнутых испытанию;

t — значение *t* от двухстороннего *t*-распределения Стьюдента из таблицы F.1, при уровне вероятности $p = 0,05$ и степенях свободы $\nu = (n - 1)$.

Т а б л и ц а F.1 — Таблица двухстороннего *t*-распределения Стьюдента

<i>n</i>	4	5	6	7	8	9	10
значение <i>t</i>	3,182	2,776	2,571	2,447	2,365	2,306	2,262

П р и м е ч а н и е — В случае вычислений с использованием крупноформатных электронных таблиц значение *t* можно смоделировать следующим образом: $t = 2,03 + 12,7/n^{1,75}$ (для $n \geq 4$).

F.4 Экспериментальная методика расчета

F.4.1 Порядок выполнения испытания

Испытание по определению UVAPF начинают, проводя испытание солнцезащитной продукции на исходном наборе, состоящем из *n'* пластин (должно быть использовано не менее четырех пластин). Значения UVAPF_i продукции для каждой пластины вычисляют по формуле (F.1).

Используя значения UVAPF_i, вычисляют условное среднее значение UVAPF для исходного набора из *n'* пластин (UVAPF_{n'}) по формуле (F.2) при доверительном интервале 95 % (95 % CI_{n'}), используя формулы (F.4), (F.5), (F.6) и *t*-таблицы Стьюдента (таблица F.1):

$$UVAPF_{n'} = \sum UVAPF_i / n'; \quad (F.7)$$

$$95 \% \text{ CI}_{n'} = \text{от } UVAPF_{n'} - c_{n'} \text{ до } UVAPF_{n'} + c_{n'} \quad (F.8)$$

$c_{n'}$ вычисляют как

$$c_{n'} = t_{n'} \cdot s_{n'} / \sqrt{n}, \quad (\text{F.9})$$

где $s_{n'}$ — стандартное отклонение первых n' пластин, вычисленное по формуле (F.3):

$$s_{n'} = \sqrt{\frac{\sum (\text{UVAPF}_i)^2 - \left[\sum (\text{UVAPF}_i) / n' \right]^2}{(n' - 1)}}, \quad (\text{F.10})$$

$$CI_{n'} [\%] = 100 \cdot c_{n'} / \text{UVAPF}_{n'}. \quad (\text{F.11})$$

Если вычисленный условный $CI_{n'} [\%]$ больше 17 % от условного среднего значения $\text{UVAPF}_{n'}$, продолжают испытание солнцезащитной продукции на дополнительных пластинах до тех пор, пока условный $CI_{n'} [\%]$ не будет менее 17 % от условного среднего значения $\text{UVAPF}_{n'}$. Если соответствие критерию не достигнуто после испытания 10 подходящих пластин, повторяют все испытание.

F.4.2 Предполагаемое количество пластин, n^*

Если $CI_{n'} [\%]$ при условном $\text{UVAPF}_{n'}$ превышает 0,17 $\text{UVAPF}_{n'}$, то в этом случае предполагаемое вероятное общее число пластин, n^* , необходимое для обеспечения соответствия статистическому критерию, можно вычислить по следующей формуле, причем результат округляют до ближайшего целого числа:

$$n^* = (t_{n'} \cdot s_{n'} / C_n)^2, \quad (\text{F.12})$$

где $t_{n'}$ — t -статистика из t -таблицы Стьюдента или формулы (F.7), для n' результатов;

$s_{n'}$ — наилучшее значение стандартного отклонения совокупности (т. е. от n' результатов);

$CI_{n'}$ — 17 % от среднего значения $\text{UVAPF}_{n'}$, представляет собой требуемый доверительный интервал.

Пример: Если n^* вычисляют после того, как получены результаты оценки 10 субъектов, то:

$$n^* = (2,262 \cdot s_{n'} / 0,17 \cdot \text{UVAPF}_{n'})^2, \quad (\text{F.13})$$

т. е.

$$n^* = (13,30 s_{n'} / \text{UVAPF}_{n'})^2. \quad (\text{F.14})$$

Библиография

- [1] ISO 17166 «Erythema reference action spectrum and standard erythema dose»
(Стандартный спектр действия эритемы и стандартная эритемная доза)
- [2] McKinlay, AF. And Diffey, BL. A reference action spectrum for ultraviolet induced erythema in human skin. CIE J (1987) 6: pp. 17—22
- [3] Chardon, A., Moyal, D., Hourseau, C., PPD-Action Spectrum Persistent Pigment Darkening Response as a Method for Evaluation of Ultraviolet A Protection Assays in Sunscreens — Development, Evaluation, and Regulatory Aspects (1997), pp. 559—582
- [4] Moyal, D., Chardon, A., Kollias, N., UVA protection efficacy of sunscreens can be determined by the persistent pigment darkening (PPD) method (part 2), *Photodermatol Photoimmunol Photomed* (2000) 16: pp. 250—255
- [5] Bernhard, G., Mayer, B., Seckmeyer, G., Moise, A., Measurement of spectral solar irradiance in tropical Australia, *J. Geophys Res*, (1997) 102: pp. 8719—8730
- [6] COLIPA (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association), SPF Test Method (1994)
- [7] DIN 67501 Experimental *in vivo* evaluation of the protection from erythema of external sunscreen products for the human skin¹⁾
(Экспериментальная *in vivo* оценка защиты от эритемы наружных UVA солнцезащитных средств для кожи человека)
- [8] ISO/TC 217/HU 7 *In vitro* UVA Ring Test Report, 2009²⁾
(Протокол кругового испытания UVA *In vitro*)
- [9] Pissavini, M., Marguerie, S., Dehais, A., Ferrero, L., and Zastrow, L., Characterizing Roughness: A New Substrate to Measure SPF Cosmet. Toiletries (2009) 9: pp. 56—62
- [10] Matts, P.J., et al., COLIPA *in vitro* UVA method: a standard and reproducible measure of sunscreen UVA protection, *Int. J. Cosmet Sci.*, (2010): pp. 35—46
- [11] COLIPA (European Cosmetics Association) method for the *in vitro* determination of UVA protection provided by sunscreen products (2009)
- [12] ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
(Общие требования к оснащению испытательных и калибровочных лабораторий)

¹⁾ Отменен.

²⁾ В процессе подготовки.

УДК 665.584.2(083.74)(476)

МКС 71.100.70

IDT

Ключевые слова: косметическая солнцезащитная продукция, метод определения *in vitro* величины защитного фактора от ультрафиолетового излучения спектра А

Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Л.С. Лысенко
Компьютерная верстка Е.О. Асташина

Сдано в набор 29.01.2024. Подписано в печать 15.02.2024. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,64.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru